DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

2025 – 2026

Gestión de la Información

CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SSFM

DIGSA

DIGSA	PROCESO	Gestión de la información PROGI – Grupo Gestión de la información - GRUGI	
	Catálogo	de Dispositivos Médicos SSFM DIGSA	
	Código	MDN-COGFM-PROGI-DIGSA-GI-95.1-1	
	Vigente	Diciembre de 2025	Versión: 1

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de los cambios
1	Diciembre 2025	Versión Inicial. El documento pertenece a la Caracterización Proceso Gestión de la Información MDN-COGFM-PROGI-CA.95.1-1. Nota PROASIG: 1.Este documento fue revisado y liberado por PROASIG. 2.La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN

Aprobó:	CR. John Jairo Villabón Ramos Subdirector Técnico y Gestión DIGSA (E)	
Revisó:	OPS. Yuly Mareela Torres Rodríguez Proceso PROGI Gestor de Calidad	MY. Jorge Fernando Rojas Coordinador Grupo Gestión de la Información (E) – DIGSA
	CT. Diana Carolina Gómez Oviedo Grupo Gestión de la Información Líder Área Coordinación y Suministro de la Información	SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión PROASIG Líder del Sistema Integrado de Gestión
	PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Alta Dirección	
Elaboró:	OPS. Mery Elsy Castañeda Urbano Grupo Gestión de la Información – GRUGI Área Administración Datos y Registros – ARADR	

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN 4
1.1. Agradecimientos 5
2. OBJETIVOS 6
3. ALCANCE 6
4. APLICACIÓN 7
5. FUNDAMENTO NORMATIVO 7
6. DEFINICIONES 8
7. ACRÓNIMOS 10
8. POLITICA DE OPERACIÓN 10
9. MARCO CONCEPTUAL 11
9.1. Actividades 13
9.2. Levantamiento de la data y clasificación de los Dispositivos Médicos DIGSA 14
9.2.1. Tipo de material 14
9.2.2. Grupo de artículo 14
9.2.3. Subgrupo de artículo 14
9.2.4. Depuración de materiales 19
9.3. Catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM 19
9.4. Uso de Marcas Comerciales en la Contratación Estatal 1094
10. BIBLIOGRAFÍA 1096
11. ANEXOS 1098

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Dispositivos Médicos - Insumos Médico Quirúrgico 14
Tabla 2. Dispositivos Médicos - Instrumental Quirúrgico y Odontológico 16
Tabla 3. Dispositivos Médicos - Material de Osteosíntesis 18
Tabla 4. Desarrollo Estructural del Catálogo de Dispositivos Médicos SSFM 23

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Aplicación de Políticas para el Estándar Semántico para Dispositivos Médicos 12
Imagen 2. Ciclo de vida Catálogo de Dispositivos Médicos SSFM 20
Imagen 3. Médico Quirúrgico (Ejemplo) 21
Imagen 4. Ficha Catálogo Dispositivos Médicos DIGSA 22
Imagen 5. Muestra - Estructura del Catálogo de Dispositivos Médicos SSFM 1094

1. PRESENTACIÓN

Los dispositivos médicos han sido considerados de gran importancia para la atención sanitaria y la mejora de la salud de la población mundial. En Colombia, mediante el Decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano" se establece el marco normativo para este tipo de tecnologías en salud.

Según el Decreto 4725 de 2005, expedido por el Ministerio de la Protección Social de Colombia, "Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:

- ✓ Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.
- ✓ Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia.
- ✓ Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico.
- ✓ Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido.
- ✓ Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos," (Ministerio de la Protección Social, 2005).

Dicho lo anterior, los dispositivos médicos entonces deben operar a través de otros mecanismos, como la mecánica, la física o la ingeniería. Esto es importante para definir claramente la categoría de los dispositivos médicos y diferenciarlos de los medicamentos. (Ministerio de la Protección Social, 2005).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente citadas, y que la disponibilidad de datos a nivel mundial se ha incrementado de una manera vertiginosa, se observa cada vez más la exigencia en la calidad del dato, tomando mayor importancia en los procesos de toma de decisiones de las diferentes empresas, tanto públicas como privadas. Dado esto, la Dirección General de Sanidad Militar (en adelante DIGSA) inicia un proceso de actualización en mejora de la calidad de los datos maestros logísticos utilizados en los procesos administrativos y asistenciales de la misma, así como las Direcciones de Sanidad de Ejército Nacional, Armada Nacional y de la Jefatura Salud de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Con la depuración, configuración, y actualización de los datos, se elabora el presente catálogo, para que sirva como una herramienta de trabajo en los procesos de preparación del Plan Anual de Adquisiciones, estructuración, celebración de contratos y cargue en el Sistema de Información Logística (en adelante SILOG) para plan de compras, manejo de inventarios y entrega de dispositivos médicos a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (en adelante SSFM); por ello, es importante socializar el catálogo, el cual estará disponible en los sitios dispuestos por la DIGSA como material de consulta para los actores interesados del SSFM, a fin de adelantar procesos administrativos y asistenciales.

Para el presente catalogo toma como guía la Resolución 1405 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, "Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación de los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro", esto teniendo en cuenta que, un conjunto ordenado o clasificado de datos con características comunes, determina el grupo de valores permitidos que puede tomar un elemento de dato y así pueda transmitir información valiosa para la institución; con el objetivo de esquematizar una metodología con el uso del registro médico electrónico.

"La información contenida en los registros médicos electrónicos necesita para su correcta representación una relación directa con terminología controlada, independientemente de su nivel de utilización, la terminología debe identificar y brindar soluciones para los obstáculos que surjan desde el contenido del vocabulario, las características de los conceptos contenidos, multi-jerarquías, definiciones y posibilidad de actualización a lo largo del tiempo. El desarrollo y mantenimiento de estos vocabularios no es tarea fácil y requiere de desarrollos en particular para la creación y su posterior mantenimiento" (Mochón A., y otros, s.f.).

La gestión de la calidad de los datos es una tarea compleja que requiere una serie de estrategias y técnicas, que comprende desde unos requisitos claros de calidad de los datos, implementación de controles y monitoreo continuo de la calidad. Para esto se debe contar con un equipo interdisciplinario, que involucre a profesionales de la salud, administradores, analistas de datos y especialistas en tecnologías de la información, que garanticen la integridad, precisión, consistencia, veracidad y puntualidad de los datos, para la toma de decisiones.

El Sistema de Información SILOG es una herramienta especializada en la gestión de inventarios y de datos maestros que permiten la actualización en tiempo real, guarda trazabilidad de la información y permite auditoria para verificar cambios en los datos. Se debe actualizar el procedimiento de solicitud de creación de datos maestros logísticos, el cual deberá ser avalado por la DIGSA antes de ser enviado al SILOG para su creación.

Por su parte, el Sistema de Información en Salud para las Fuerzas Militares (en adelante SALUD.SIS), es una herramienta tecnológica desarrollada por la Dirección General de Sanidad Militar, diseñada para gestionar de manera integral los servicios de salud del SSFM. Este sistema está orientado a mejorar la accesibilidad, eficiencia y oportunidad en la atención médica de los más de 670.000 usuarios afiliados, incluyendo personal militar activo, retirado y sus beneficiarios.

Es por esto que, se requiere de datos actualizados y unificados en el catálogo, los cuales serán homologados en SALUD.SIS para ser formulados por el personal de sanidad a los usuarios del SSFM, lo que aporta a la estandarización entre los sistemas SILOG y SALUD.SIS, así como al control y conocimiento del uso final del dispositivo, al permitir realizar la trazabilidad del dato en el sistema de información por paciente y la entrega final de los insumos, información esencial para identificar de forma más detallada el gasto a nivel de Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

También se tomó la Directiva Permanente No. 0121001353602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-ARSAP-23.1 del 10 de febrero de 2021 (Anexo 1) donde se actualiza el contenido de los botiquines M1, M3, M4 y M5, determinando la lista de insumos, medicamentos y dispositivos médicos según el perfil de habilidades y competencias de los responsables de su uso, los cuales fueron identificados adjudicándose un código interno para poder realizar seguimiento, costeo de compra y dotación de los botiquines en las tres Fuerzas Ejército Nacional de Colombia, Armada Nacional de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana, como en la Jefatura (en adelante JEFSA) y Direcciones de Sanidad (en adelante DISAN) de dichas Fuerzas.

Con el presente catálogo se contribuye a la implementación del Modelo de Gobierno de Datos en la Dirección General de Sanidad Militar, avanzando en la estandarización de dispositivos médicos, identificación de datos maestros y definición de metadatos. Este esfuerzo fortalece la toma de decisiones basada en información confiable, al tiempo que mitiga la materialización de riesgos reputacionales y económicos, consolidando una gestión más eficiente y transparente en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

1.1. Agradecimientos

La elaboración de este Catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM fue posible gracias al compromiso y la colaboración de un equipo excepcional, conformado por profesionales, tecnólogos y técnicos de la DIGSA. A través de la Subdirección de Salud, la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Subdirección Técnica y de Gestión, brindaron orientación y acompañamiento durante todo el proceso. Extendemos nuestro agradecimiento a la DISAN EJC, DISAN ARC y JEFSA por su valioso apoyo en la recopilación y verificación de la información técnica de los materiales. Asimismo, reconocemos el esfuerzo incansable de todos los técnicos, tecnólogos y profesionales del área

de la salud, así como del personal administrativo, logístico y financiero involucrado, cuya dedicación y conocimientos fueron fundamentales para la elaboración de este catálogo.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Elaborar un catálogo único de dispositivos médicos para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, optimizando la gestión de la cadena de abastecimiento logrando la mejora de los registros en los sistemas de información que con lleve a la toma de decisiones efectiva a través de socialización en los niveles asistencial y administrativo.

2.2. Objetivos Específicos

1. Realizar por parte de la DIGSA un diagnóstico inicial de los dispositivos médicos existentes en el SSFM y así poder identificar duplicidades, errores en la creación de estos.

2. Clasificar por parte de la DIGSA los dispositivos médicos según su tipo, uso y nivel de complejidad, para facilitar la búsqueda y gestión.
3. Validar por parte de la DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN la información técnica con la áreas clínicas y logísticas para mejorar la precisión y consistencia de la información consignada en el catálogo.

4. Diseñar por parte de la DIGSA, JEFSA y DISAN el formato y estructura del catálogo.

5. Parametrizar y estandarizar por parte de la DIGSA los dispositivos médicos en los sistemas de información SALUD.SIS y SILOG del SSFM.

6. Socializar por parte de la DIGSA el catálogo único de dispositivos médicos a todo personal asistencial y administrativo del SSFM.

7. Brindar por parte de la DIGSA la información estandarizada que facilite los procesos de elaboración de Plan Anual de Adquisiciones y estructuración de procesos contractuales a partir del uso del Catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM 2025.

8. Realizar por parte de la DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN la actualización del catálogo de datos maestros de los dispositivos médicos (materiales y equipos biomédicos) para generar información útil, razonable y con calidad, en pro de la toma de decisiones de manera estratégica.

9. Disponer por parte de la DIGSA de una herramienta para visualizar el catálogo a fin de que sirva de consulta para los actores interesados.

10. Capacitar e implementar por parte de la DIGSA sobre la funcionalidad del catálogo y la herramienta de visualización.

3. ALCANCE

Inicia con el catálogo de dispositivos médicos del SSFFM aprobado y actualizado hasta la evaluación de la utilización por parte de los responsables de los procesos logísticos, administrativos y asistenciales.

4. APLICACIÓN

Aplicación: DIGSA, DISAN/JEFSA, ESM, SSFM.

5. FUNDAMENTO NORMATIVO

Proveedor	Entrada - insumo
Ley 100 de 1993	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Ley 1438 de 2011	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 112, Articulación del Sistema de Información.
Decreto Ley 4107 de 2011	Artículo 25, donde se señala que el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, debe desarrollar los lineamientos de identificación y clasificación de los dispositivos médicos para facilitar la vigilancia sanitaria y epidemiológica.
Decreto Ley 019 de 2012	Artículo 117, modificatorio del artículo 91 de la Ley 1438 del 2011, señala que el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá la norma que permita la codificación de insumos y dispositivos médicos.
Decreto 4725 de 2005	Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
Resolución 2535 de 2013	Donde se reglamenta el artículo 117 del Decreto Ley 019 de 2012- Modificatorio del artículo 91 de la Ley 1438 de 2011 en aras de determinar las etapas de estandarización semántica como parte integral del proceso de codificación de los insumos y dispositivos médicos, determina sus objetivos para el SGSSS: • Identificación y clasificación del dispositivo médico. • Manejo, suministro, adquisición y uso de los dispositivos médicos. • Gestión del gasto. • Intercambio de información. • Trazabilidad. • Regulación de precios.
Resolución EB132.R8 de 2013	Normalización y compatibilidad en materia de Cibersalud. Se recomienda a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: Resolución WHA58.28 sobre Cibersalud; Reconociendo que las tecnologías de la información y la comunicación han sido integradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Resolución 200 de 2021	Por la cual se establecen disposiciones para el uso y manejo de pruebas de laboratorio, utilizadas en el punto de atención al paciente (point – of – care testing) dentro de la prestación integral de servicios de salud.
Resolución 866 de 2021	Por la cual se reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica en el país y se dictan otras disposiciones.

Resolución 214 de 2022	Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida bucal y los establecimientos que los fabrican, reparan, dispensan y adaptan y se adoptan las guías de verificación.
Resolución 1405/2022	Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la Codificación para los dispositivos médicos de uso humano y de reactivos diagnósticos in vitro.
Resolución 184 de 2024	Por la cual se adopta las políticas de los dispositivos médicos.
Acuerdo No. 002	Por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial
Acuerdo No. 072 de 2019	Por el cual se dictan políticas generales y lineamientos para la organización del Sistema Integral de información en Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional-SISMIPOL.
Circular No. 0123001818402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARGRI-86.13 de fecha 21-FEB/23	Por la cual la Dirección General de Sanidad Militar emitió los Lineamientos Técnicos Relacionados Con La Prescripción, Entrega, Entrenamiento Y Seguimiento De Los Productos De Apoyo En Salud -PAS Para El Posicionamiento y La Movilidad.
Directiva Permanente No. 0121001353602 del 10 de febrero de 2021	Estandarización técnica de Botiquines M1-M3-M4 y M5.

6. DEFINICIONES

Proceso:	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Fuente Norma ISO 9000:2015.
Calidad del dato:	Característica de un sistema de información, que garantiza la exactitud, completitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad de sus datos, necesaria para lograr un alto nivel de procesamiento y análisis para una toma de decisiones efectiva a nivel de los actores involucrados.
Catálogo:	Conjunto ordenado o clasificado de datos con características comunes, que determina el grupo de valores permitidos que puede tomar un elemento de dato.
Clasificación:	Lista de todos los conceptos pertenecientes a grupos bien definidos (enfermedades, animales, plantas,) reunidos según criterios que les permiten ser ordenados sistemáticamente, estableciendo entre ellos una jerarquía basada en relaciones naturales o lógicas. (Ministerio de Salud y Protección Social. Estándares Semánticos. Proceso Misional de Datos referidos a las Tecnologías en Salud 2013)

Consumible:	Material fungible uso único o durante un periodo limitado, tras el cual debe desecharse o sustituirse (Organización Mundial de la Salud 2012. Un resultado del Proyecto sobre Dispositivos Médicos Prioritarios)
Dispositivo médico:	Es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso. (Fuente: Recomendaciones para el uso seguro de dispositivos médicos - Invima)
Elemento de dato:	Identifica o define una estructura de información de importancia para la entidad u organización que lo utilice en los procesos de intercambio de información asociados a la Interoperabilidad de datos de la Historia Clínica. Los elementos de dato constituyen el insumo básico para la implementación técnica, a partir de la cual se realiza el intercambio de información de acuerdo con los requerimientos funcionales definidos dentro del proceso o servicio identificado. (Fuente: ABECÉ Interoperabilidad de Datos de la Historia Clínica en Colombia Términos y siglas, MinSalud)
Estándar de datos:	Son el conjunto de elementos de datos comunes e interoperable que debe desarrollarse en cualquier nivel de atención de salud, que apoya en primera instancia la gestión y el control como marco del nivel local o institucional, territorial y nacional, y que permite la interoperabilidad entre agentes del Estado Colombiano, sobre la base de estándares obligatorios de intercambio de datos.
Estándar semántico:	Es la herramienta que permite denominar un dispositivo médico y reactivo de diagnóstico invitro de manera uniforme, facilitando su identificación, clasificación, trazabilidad e intercambio de información entre actores y agentes que están involucrados en su uso, comercialización, distribución, inspección, vigilancia y control. (Fuente: manual de usuario para el estándar semántico y codificación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro 2014 – Invima).
Grupo de artículo	Agrupador más pequeño, permite la posibilidad de unificar los materiales con las mismas propiedades o función.
Seguridad:	Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. (Fuente: ABC de Dispositivos Médicos 2013 – Invima)
Sistema:	Un sistema consta de interacción múltiple y dispositivos médicos interdependientes que forman un todo integrado para llevar a cabo un propósito específico, es decir todos los componentes para llevar a cabo ese propósito. (Fuente: GMDN Term Development Team).
Tipo de material	Define a los dispositivos médicos que tienen los mismos atributos básicos, que se utilizan en la atención médica.
Trazabilidad:	Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. (ISO 9000/2005). Es la capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento a través de etapas especiadas de la cadena de abastecimiento extendida y de trazar hacia atrás el historial, la aplicación o la localización que está en 6 consideración. (Organización Internacional. Red Global GS1. Identificador único de dispositivos médicos UDI-DI).

Unidad mínima de consumo:	Relacionada con la unidad mínima de consumo en el paciente o usuario final. (Fuente: manual de usuario para el estándar semántico y codificación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro 2014 – Invima).

7. ACRÓNIMOS

BBP:	Business Blueprint – Plano de Negocios – Hoja de Ruta.
BI:	Business Inteligence – Inteligencia de Negocios.
DM:	Dispositivo Médico.
DIGSA:	Dirección General de Sanidad Militar.
DISAN:	Dirección de Sanidad.
ERP:	Siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, que se traduce como "planificación de recursos empresariales".
GS1:	Estándar de Imagen del Producto.
INVIMA:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
ISO:	Organización Internacional de Normalización.
JEFSA:	Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial.
LMS:	Learning Management System
MSPS:	Ministerio de Salud y Protección Social.
OMS:	Organización Mundial de la Salud.
OPS:	Organización Panamericana de la Salud.
SSFM:	Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
SILOG:	Sistema de Información Logística.
SALUD.SIS:	Sistema de Información en Salud para las Fuerzas Militares.
UDI-DI:	Código (identificador) único de Dispositivos Médicos.

8. POLITICA DE OPERACIÓN

La elaboración e implementación de un catálogo de dispositivos médicos constituye una herramienta estratégica para fortalecer la gestión tecnológica en salud, garantizar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones clínicas, administrativas y regulatorias, por lo anterior se debe precisar el marco normativo que defina las directrices y normas generales que deben cumplirse para asegurar que dicho catálogo cumpla con los objetivos planteados: estandarización, interoperabilidad, seguridad del paciente y eficiencia en el uso de recursos.

- ✓ En este orden de ideas la DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN deben hacer actualizaciones, que incorporen la nueva normatividad emitida por el MSPS, el INVIMA y el Ministerio de Defensa Nacional en lo relacionado al manejo, compra y utilización de los DM en el SSFM.

- ✓ Para dar cumplimiento al alcance del catálogo, la DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN deben seguir estrictamente los lineamientos establecidos para la creación de los datos en el sistema SILOG, para su utilización en los diferentes procesos logísticos y asistenciales, cumplir con la actualización anual del catálogo y las capacitaciones programadas para la socialización y manejo del catálogo.

- ✓ La DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN deben cumplir con los requisitos establecidos de clasificación, registro y homologación de la información consignada en las herramientas informáticas.

- ✓ La DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN deben cumplir con la arquitectura del catálogo (digital y/o físico, incluyendo los campos obligatorios)

- ✓ La DIGSA gestionará la integración del catálogo en los sistemas de información SALUD.SIS y SILOG

- ✓ La DIGSA gestionará la implementación de criterios de búsqueda, filtros y categorías para facilitar el uso del Catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM.

- ✓ La DIGSA, en conjunto con la JEFSA y las DISAN realizarán monitoreo y actualización periódica, para incorporar nuevos dispositivos de acuerdo con la evolución tecnológica y regulatoria, con mecanismos de retroalimentación y mejora continua.

- ✓ La DIGSA, en conjunto con la JEFSA y las DISAN deben dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la gestión documental, registro en las fuentes de información utilizadas, documentación de los procesos de inclusión, modificación y exclusión de los dispositivos médicos.

9. MARCO CONCEPTUAL

El catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM es un documento y herramienta que recopila, organiza y estandariza información clave relacionada con los datos sobre los dispositivos médicos utilizados en la atención de salud y servicios médicos proporcionados a los miembros de las Fuerzas Militares y sus beneficiarios, facilitando la gestión en la cadena de suministro y el uso adecuado del mismo.

Un catálogo de datos maestros logísticos es un documento que organiza y clasifica la información esencial relacionada con los recursos logísticos en el ámbito de la salud militar. Este catálogo puede incluir datos sobre insumos médicos, equipos y cualquier otro elemento relevante para la gestión y operación de los servicios de salud en la sanidad militar.

Los datos maestros son fundamentales para asegurar la coherencia, precisión y disponibilidad de la información, lo que permite una mejor planificación, ejecución y control de las actividades logísticas. Además, un catálogo bien estructurado facilita la toma de decisiones, la optimización de recursos y el cumplimiento de normativas en el sector Defensa y Salud.

Según la Organización mundial de la salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los dispositivos médicos (DM) son un componente fundamental de los sistemas de salud; son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz. Las etapas que implican la fabricación, regulación, planificación, evaluación, adquisición y gestión de los dispositivos médicos son complejas, pero indispensables para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que son utilizados (Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, s.f.).

El Decreto No. 4725 de 2005 consigna que un dispositivo médico para uso humano es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso (Ministerio de la Protección Social, 2005).

La gestión de los dispositivos médicos contempla la determinación de las necesidades en el área donde se prestan los servicios de salud, definir las especificaciones técnicas para la adquisición de los dispositivos, tener un inventario completo de los activos (dispositivos y suministros), desarrollar un programa de mantenimiento basado en la reducción de riesgos y funcionamiento seguro, que garantice la disponibilidad de dispositivos de alta calidad; además contar con una auditoria de seguimiento de la eficacia clínica de los dispositivos, actualizaciones y mejoras y por último, retirada del servicio.

Lo anterior debe ir de la mano de políticas y estrategias sobre dispositivos médicos, acorde a la estructura política del país, para que se puedan establecer las condiciones adecuadas en materia farmacéutica, dispositivos, tecnologías, insumos y equipamiento en salud, que nos lleven a tener una información oportuna y de calidad que apoye al sistema de salud permitiendo regular los costos y tarifas, al tiempo que permite fortalecer la vigilancia y control para cumplir con los atributos de calidad.

La siguiente ilustración muestra los ámbitos de aplicación de las políticas sobre los dispositivos médicos en Colombia, teniendo en cuenta el ciclo de vida de esta.

Imagen 1. Aplicación de Políticas para el Estándar Semántico para Dispositivos Médicos

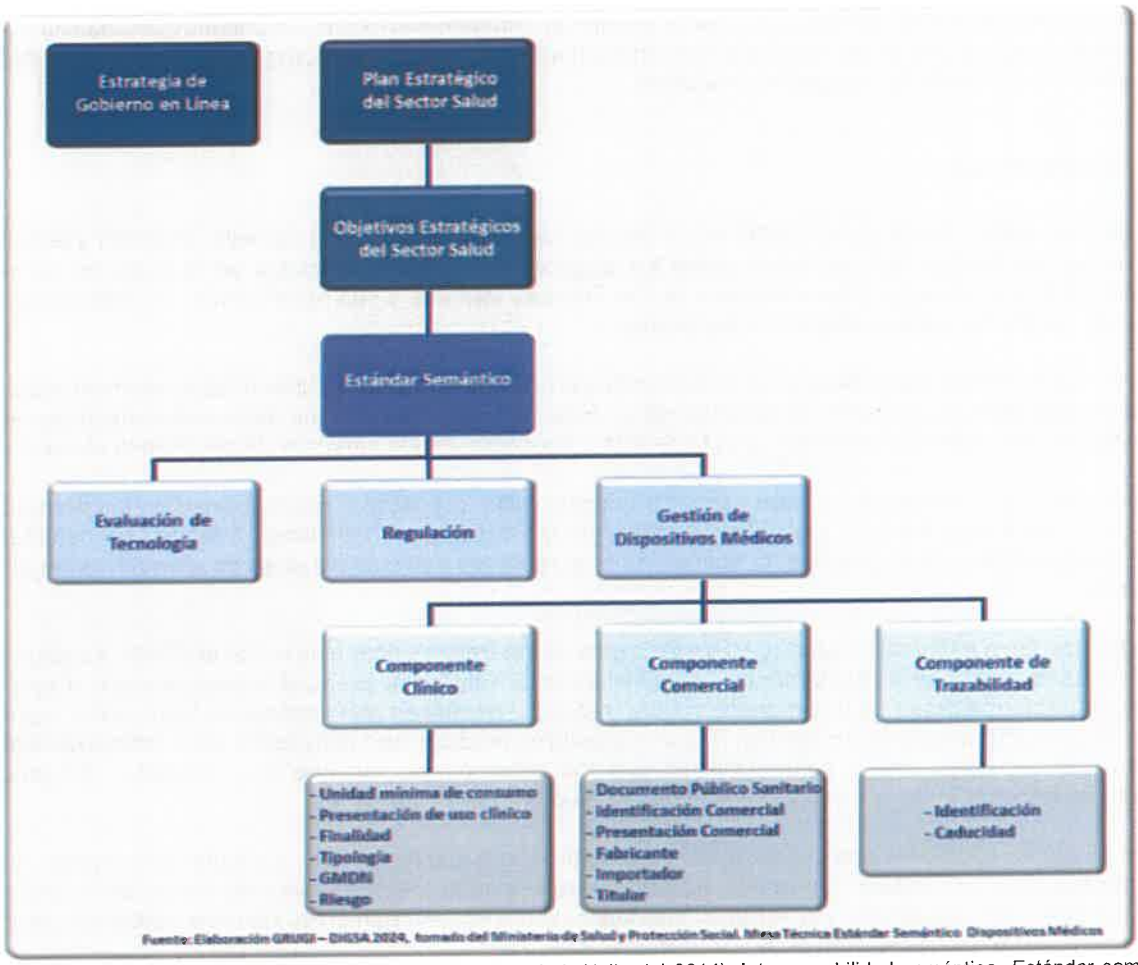

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud. (Julio del 2014). Interoperabilidad semántica- Estándar semántico para los dispositivos médicos. I Fase: etapa Diseño. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/diseno-estandares-semanticos.pdf.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) tiene el Estándar Semántico y codificación, como uno de sus objetivos estratégicos, para llegar a tener una identificación y clasificación de los Dispositivos Médicos; con acceso a éstos con criterios de calidad, seguridad, eficacia, suficiencia, equidad y oportunidad, y también tener estrategias para identificar y evaluar necesidades, adquisición, inventarios, puesta en marcha, mantenimiento y retirada del servicio.

Para llegar a la definición del Estándar Semántico el MSPS diseñó una hoja de ruta que incluyó las siguientes fases:

Fase I. Análisis y diseño: Donde una mesa técnica de trabajo revisó normatividad mundial sobre dispositivos médicos, directrices de la OMS, información que debe llevar un dispositivo, su clasificación, uso y desecho; con este documento se reunió la segunda mesa técnica para adoptar el Estándar Semántico de los dispositivos Médicos; en ésta se definieron las tipologías: Consumibles, Reactivos de Diagnóstico In Vitro, Equipo Biomédico, Dispositivos Médicos Sobre Medida.

La tipología en la clasificación de los dispositivos médicos se refiere a la categorización de estos dispositivos en grupos o clases según criterios específicos, como su función, riesgo asociado, tecnología utilizada o el propósito clínico. Esta clasificación es fundamental para regular y supervisar la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos.

Fase II. Implementación: Para la implementación del Estándar Semántico, la Resolución 1405 de 2022 estableció un horizonte de cuatro (4) años, durante los cuales los participantes del proceso como son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), fabricantes, proveedores (titulares de los registros sanitarios), instituciones prestadoras de servicios de salud, prestadores independientes, entre otros, recibirán capacitación sobre el tema, después se da tiempo al INVIMA para actualizar la información y colocarla a disposición de los usuarios en las herramientas para tal fin, en el MSPS.

En el marco de la optimización de los recursos y la mejora en la atención médica brindada a los integrantes del SSFM, se ha identificado la necesidad de contar con un catálogo actualizado y uniforme de dispositivos médicos.

Esto permitirá un control adecuado que facilitará la adquisición, mantenimiento y uso de los equipos, y garantizará la calidad y seguridad en la atención, por lo anterior la DIGSA desarrolló una serie de actividades para esta tarea:

9.1. Actividades

- ✓ **Levantamiento de data:** Se listó los materiales por la transacción ZMM201 del sistema SILOG, la cual fue tomada como información inicial para su depuración y actualización.
- ✓ **Clasificación**: Se separaron los materiales por tipo de material y grupo de artículo.
- ✓ El tipo de material se refiere al clasificador mayor de los materiales que los agrupa por los mismos o similares atributos (ZMQX – Médico quirúrgicos) y el grupo de artículo un agrupador más pequeño de los ZMQX que agrupa los materiales de iguales o similares características por ejemplo los materiales de rehabilitación.
- ✓ **Depuración de materiales:** Se realizaron mesas de trabajo con personal especializado para cada grupo, dicho personal fue designado por la Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Sanidad Ejercito, Dirección de Sanidad Armada y Jefatura Salud FAC, como consta en actas de reunión.
- ✓ **Catálogo:** Corresponde a fichas técnicas en las cuales se realiza la descripción del material según lo indica la normatividad (Imagen 1. Aplicación de Políticas para el Estándar Semántico para Dispositivos Médicos)
- ✓ **Herramienta de visualización:** Con soporte en la hoja de cálculo interna, la cual contiene los dispositivos médicos con sus especificaciones técnicas, por parte de la DIGSA se proyecta la elaboración de herramienta de visualización la cual se suministrará a la DIGSA- JEFSA y DISAN EJC- DISAN ARC para consulta y aplicación en los procesos logísticos administrativos y de salud.
- ✓ **Capacitación:** Se programará socialización y capacitación para consulta y manejo del catálogo y la herramienta de visualización, así como para modificación y creación de nuevos dispositivos médicos según los procedimientos logísticos del sistema SILOG como plan de compras, contratación y manejo de almacenes entre otros.

9.2. Levantamiento de la data y clasificación de los Dispositivos Médicos DIGSA

Como se explicó anteriormente los Dispositivos Médicos están clasificados por tipologías. Para la clasificación de éstos la DIGSA tomó la normatividad vigente que soporto la implementación del sistema de información SILOG, plasmada en el documento Business Blueprint (BBP) "PROCESO DATOS MAESTROS MATERIALES Y SERVICIOS" con fecha 27 abril del 2009 (Anexo 2) y es la siguiente:

9.2.1. Tipo de material

Define a los dispositivos médicos que tienen los mismos atributos básicos, que se utilizan en la atención médica y la salud como medios diagnósticos, de tratamiento, de prevención, rehabilitación, bioseguridad, etc, y su agrupación ayuda a su gestión logística y de salud.

- ✓ Código ZMQX - MÉDICO QUIRÚRGICOS.
- ✓ Código ZMQI - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO (No tiene subgrupo de material).
- ✓ Código ZOST - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS.
- ✓ Código ZBIO - REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMÉDIO.

9.2.2. Grupo de artículo

Este agrupador más pequeño, permite la posibilidad de unificar los materiales con las mismas propiedades o función, este es el equivalente a la tipología consumible, consignada en la Resolución N° 184 de 2024 del Ministerio de Salud.

9.2.3. Subgrupo de artículo

Este agrupador aún más pequeño, permite la posibilidad de unificar los materiales con las mismas propiedades o función, este es el equivalente a la Subtipología consumible, consignada en la resolución N° 184 de 2024 del Ministerio de Salud.

Los puntos anteriores se relacionan en las siguientes Tablas de Dispositivos Médicos – Médico Quirúrgicos:

Tabla 1. Dispositivos Médicos - Insumos Médico Quirúrgico

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
MÉDICO-QUIRÚRGICO	ZMQX	ELEMENTOS DE PROTESIS Y REHABILITACIÓN	ZMQX-001	LINEA BLANDA	ZMQX-001-1
				ORTESIS	ZMQX-001-2
				PROTESIS	ZMQX-001-3
				CALZADO ORTOPEDICO	ZMQX-001-4
				SOLUCIONES TECNICAS DE MOVILIDAD	ZMQX-001-5
				BUCAL FIJA	ZMQX-001-6
				BUCAL REMOVIBLE	ZMQX-001-7
				AUDITIVO - AURICULARES	ZMQX-001-8
				AUDITIVO - INTRAAURICULARES	ZMQX-001-9
				AUDITIVO - INTRACRANEALES	ZMQX-001-10
				AUDITIVO - OSTEOINTEGRADOS	ZMQX-001-11
				MEDIAS DE COMPRESION	ZMQX-001-12
				MATERIAL PARA TERAPIAS	ZMQX-001-13

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
				VISUAL Y OCULAR - PROTESIS OCULARES	ZMQX-001-14
				VISUAL Y OCULAR - LENTES OFTALMICOS	ZMQX-001-15
				VISUAL Y OCULAR - LENTES DE CONTACTO	ZMQX-001-16
				VISUAL Y OCULAR - MONTURAS	ZMQX-001-17
		MÉDICO-QUIRÚRGICOS GENERALES	ZMQX-002	GRUPO ADMINISTRACIÓN	ZMQX-002-1
				GRUPO RECOLECCION DE SANGRE Y SUS COMPONENTES	ZMQX-002-2
				GRUPO ADMINISTRACION DE OXIGENO Y TERAPIA RESPIRATORIA	ZMQX-002-3
				GRUPO SUTURAS E INSUMOS PARA SINTESIS	ZMQX-002-4
				GRUPO INSUMOS DE CURACION	ZMQX-002-5
				GRUPO TUBOS Y SONDAS	ZMQX-002-6
				GRUPO DRENAJES DE LIQUIDOS, SANGRE Y FLUIDOS	ZMQX-002-7
				GRUPO ANTICONCEPCION MASCULINA Y FEMENINA	ZMQX-002-8
				GRUPO ELEMENTOS Y BARRERAS DE PROTECCION	ZMQX-002-9
				GRUPO INSUMOS DE CORTE, DISECCION Y COAGULACION	ZMQX-002-10
				GRUPO INSUMOS DE DESINFECCION Y OTROS	ZMQX-002-11
				TIPOLOGIA BORDERLINE	ZMQX-002-12
	ZMQX	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ZMQX-003	CIRUGIA ORAL	ZMQX-003-1
				ENDODONCIA	ZMQX-003-2
				HIGIENE ORAL	ZMQX-003-3
				LABORATORIO	ZMQX-003-4
				ODONTOLOGIA GENERAL	ZMQX-003-5
				ODONTOPEDIATRIA	ZMQX-003-6
				ORTODONCIA	ZMQX-003-7
				PERIODONCIA	ZMQX-003-8
				REHABILITACION ORAL	ZMQX-003-9
		MATERIAL DE CIRUGÍA	ZMQX-005	INSUMOS PARA ESTERILIZACION	ZMQX-005-01
				COTONOIDES	ZMQX-005-02
				HEMOSTATICOS	ZMQX-005-03
				INSUMOS ELECTROBISTURI	ZMQX-005-04
				MASCARAS, CANULAS, BALON REUSABLE	ZMQX-005-05
				VARIOS	ZMQX-005-06
				TIPOLOGIA BORDERLINE	ZMQX-005-06
		ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA	ZMQX-006	BATAS - VESTIDO QUIRURGICO	ZMQX-006-01
				CAMPOS - COMPRESAS - ENVOLVEDERAS	ZMQX-006-02
				GORROS - POLAINAS - TAPABOCAS	ZMQX-006-03
				KITS - PAQUETES DE ROPA	ZMQX-006-04

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
				SABANAS - FUNDAS - MANTAS, ROLLOS DE TELA	ZMQX-006-05
				PAÑALES	ZMQX-006-06
		MATERIAL DE CURACION	ZMQX-007	ADHESIVOS	ZMQX-007-01
				APLICADORES - BAJALENGUAS - GASAS	ZMQX-007-02
				APOSITOS - FACTOR DE CRECIMIENTO - MECHA DE ALGINATO	ZMQX-007-03
				BASES O BARRERAS PROTECTORAS - BOLSAS OSTOMIAS Y OTRAS	ZMQX-007-04
				CINTAS - DISPENSADOR - PELICULAS PROTECTORAS	ZMQX-007-05
				GELES - PASTA PROTECTORA - ADHESIVOS - REMOVEDORES - UNGUENTOS	ZMQX-007-06
				VENDAS	ZMQX-007-07
				TIPOLOGIA BORDERLINE	ZMQX-007-08
		MATERIAL DE IMAGENOLOGÍA	ZMQX-009	CASSETES - CHASIS	ZMQX-009-01
				ELEMENTOS PLOMADOS	ZMQX-009-02
				FIJADORES - REMOVEDORES	ZMQX-009-03
				KIT DE LIMPIEZA RODILLOS - LIMPIADOR DE PANTALLA	ZMQX-009-04
				PANTALLA DE FOSFORO - PELICULAS	ZMQX-009-05
				VARIOS - CAJA ACRILICA - OTROS	ZMQX-009-06
		MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	ZMQX-012	COAGULACION	ZMQX-012-01
				COLORANTES	ZMQX-012-02
				CONTROL DE CALIDAD MOLECULAR	ZMQX-012-03
				CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	ZMQX-012-04
				HEMATOLOGIA	ZMQX-012-05
				INMUNOLOGIA	ZMQX-012-06
				INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	ZMQX-012-07
				MICROBIOLOGIA	ZMQX-012-08
				MICROSCOPIA	ZMQX-012-09
				MOLECULAR	ZMQX-012-10
				PRUEBAS ESPECIALES	ZMQX-012-11
				QUIMICA	ZMQX-012-12
				SERVICIO TRANSFUCIONAL	ZMQX-012-13

Fuente: Elaboración propia GRUGI - 2025

Tabla 2. Dispositivos Médicos - Instrumental Quirúrgico y Odontológico

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ZMQI	CLAMPS	ZMQI-001	CLAMPS	ZMQI-001-01
			ZMQI-002	CURETAS	ZMQI-002-01

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
		CURETAS - CUCHARIILAS		CUCHARILLAS	ZMQI-002-02
		ESPÉCULOS - ANOSCOPIOS	ZMQI-003	ESPÉCULOS	ZMQI-003-01
				ANOSCOPIOS	ZMQI-003-02
		INSTRUMENTOS DE CORTE ÓSEO	ZMQI-004	INSTRUMENTO DE CORTE ÓSEO	ZMQI-004-01
				CINCELES	ZMQI-004-02
				CIZALLAS	ZMQI-004-03
				COSTÓTOMOS	ZMQI-004-04
				MARTILLOS	ZMQI-004-05
				SIERRAS	ZMQI-004-06
		INSTRUMENTOS DE CORTE Y PUNCIÓN	ZMQI-005	TIJERAS	ZMQI-005-01
				FRESAS	ZMQI-005-02
				INICIADORES	ZMQI-005-03
				MAGOS DE BISTURÍ	ZMQI-005-04
				PERFORADORES	ZMQI-005-05
				PUNZÓN	ZMQI-005-06
				TREPANADOR	ZMQI-005-07
				CUCHILLETE	ZMQI-005-08
		INSTRUEMNTOS DE DISECCIÓN ÓSEA	ZMQI-006	DISECTORES	ZMQI-006-01
				ELEVADORES	ZMQI-006-02
				ENUCLEADORES	ZMQI-006-03
				LIMAS	ZMQI-006-04
				PERIOSTOTOMOS	ZMQI-006-05
				RASPAS	ZMQI-006-06
				RUGINAS	ZMQI-006-07
		INSTRUMENTOS DE EXPANSIÓN Y SEPARACIÓN	ZMQI-007	DISECTORES	ZMQI-007-01
				ESPÁTULAS	ZMQI-007-02
				GANCHOS	ZMQI-007-03
				RETRACTORES	ZMQI-007-04
				SEPARADORES	ZMQI-007-05
				VALVAS	ZMQI-007-06
		INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PARA MEDICIÓN	ZMQI-008	COMPÁS	ZMQI-008-01
				MEDIDORES	ZMQI-008-02
				REGLAS	ZMQI-008-03
		INSTRUMENTOS SUCCIÓN - IRRIGACIÓN - EXPANSIÓN	ZMQI-009	CÁNULAS	ZMQI-009-01
				CONECTORES	ZMQI-009-02
				CONDUCTORES	ZMQI-009-03
				DILATADORES	ZMQI-009-04
				PALPADORES	ZMQI-009-05
				SONDAS	ZMQI-009-06
		INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PARA SUTURAS	ZMQI-010	PORTAAGUJAS	ZMQI-010-01
		MISCELANEOS Y VARIOS	ZMQI-011	ALICATES	ZMQI-011-01
				CONDENSADORES	ZMQI-011-02
				ESTR	ZMQI-011-03
				LLAVE DE TUBO	ZMQI-011-04
				ALLEN	ZMQI-011-05
				FIJA	ZMQI-011-06
				PERFORADORES	ZMQI-011-07
				MAN "T"	ZMQI-011-08
				TIRAB	ZMQI-011-09
		PINZAS DE DISECCIÓN	ZMQI-012	PINZAS DE DISECCIÓN	ZMQI-012-01
		PINZAS HEMOSTÁTICAS	ZMQI-013	PINZAS HEMOSTÁTICAS	ZMQI-013-01
				DE AGARRE Y TRACCIÓN	ZMQI-013-02
			ZMQI-014	PINZAS SACABOCADOS	ZMQI-014-01

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
		PINZAS SACABOCADOS Y BIOPSIAS		PINZAS PARA BIOPSIAS	ZMQI-014-02
		RECIPIENTES DE ACERO INOXIDABLE	ZMQI-015	BANDEJAS	ZMQX-015-01
				CONTENEDORES	ZMQX-015-02
				CUBETAS	ZMQX-015-03
				RIÑONERAS	ZMQX-015-04
				VASOS	ZMQX-015-05
		INSTRUMENTOS ESPECÍFICO ODONTOLOGÍA	ZMQI-016	CIRUGÍA ORAL	ZMQX-016-01
				ENDODONCIA	ZMQX-016-02
				LABORATORIO	ZMQX-016-03
				ODONTOLOGÍA GENERAL	ZMQX-016-04
				ODONTOPEDIATRÍA	ZMQX-016-05
				ORTODONCIA	ZMQX-016-06
				PERIODONCIA	ZMQX-016-07
				REHABILITACIÓN ORAL	ZMQX-016-08
		INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO	ZMQI-017	PARA ESPECIALIZADES QUIRÚRGICAS	ZMQI-018-01

Fuente: Elaboración propia GRUGI - 2025
Nota: Este Grupo no tiene subgrupos desagregados para la primera versión del catálogo.

Tabla 3. Dispositivos Médicos - Material de Osteosíntesis

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	ZOST	GRUPO BIOMATERIALES	ZOST-001	SUSTITUTOS Y MATRICES OSEAS,	ZOST-001-1
				INJERTOS PARCHES Y MEMBRANAS	ZOST-001-2
		GUPO PLACAS	ZOST-002	PLACAS ESTANDAR	ZOST-002-1
				PLACAS PEDIATRICAS	ZOST-002-2
				PLACAS ANATOMICAS ESPECIALES	ZOST-002-3
		GRUPO TORNILLOS	ZOST-003	CORTICAL	ZOST-003-1
				TORNILLO CANULADO	ZOST-003-2
				BLOQUEO	ZOST-003-3
				INTERFERENCIA	ZOST-003-4
				MALEOLAR	ZOST-003-5
				DHS/DCS	ZOST-003-6
				ESPONJOSA	ZOST-003-7
		GRUPO REEMPLAZOS ARTICULARES	ZOST-004	ATM	ZOST-004-1
				CODO	ZOST-004-2
				HOMBRO	ZOST-004-3
				MUÑECA	ZOST-004-4
				CADERA	ZOST-004-5
				RODILLA	ZOST-004-6
				TOBILLO	ZOST-004-7
		GRUPO DE COLUMNA	ZOST-005	PLACAS	ZOST-005-1
				TORNILLOS	ZOST-005-2
				GANCHOS	ZOST-005-3
				BARRAS	ZOST-005-4
				IMPLANTES	ZOST-005-5
		GRUPO ARTOSCOPIA	ZOST-006	SUTURA ANCLAJE	ZOST-006-1
				CUCHILLAS SHAVER	ZOST-006-2
				ARPONES	ZOST-006-3
				CAUTERIOS	ZOST-006-4
			ZOST-007	HUMERO	ZOST-007-1

TIPO DE MATERIAL	SIGLA TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTÍCULO	SIGLA DE GRUPO DE ARTÍCULO	SUBGRUPO DE ARTÍCULOS	SIGLA DE SUB-GRUPO DE ARTÍCULO
		GRUPO CLAVOS ENDOMEDULARES		FEMUR	ZOST-007-2
				TIBIA	ZOST-007-3
				PERNOS DE BLOQUEO	ZOST-007-4
				TAPONES	ZOST-007-5
		GRUPO CLAVOS AGUJAS	ZOST-008	CLAVOS KIRSHNNER	ZOST-008-1
				CLAVOS STEINMAN	ZOST-008-2
				CLAVOS SHANZ	ZOST-008-3
				AGUJAS GUIA	ZOST-008-4
		GRUPO CERCLAJE	ZOST-009	ALAMBRES	ZOST-009-1
				CABLES	ZOST-009-1
		GRUPO FIJADOR EXTERNO	ZOST-010	PLANARES	ZOST-010-1
				CIRCULARES	ZOST-010-2
				HIBRIDOS	ZOST-010-3
				PEDIATRICOS	ZOST-010-4
				ROTULAS	ZOST-010-5
				BARRAS	ZOST-010-6
		GRUPO DE CORTE PERFORACION	ZOST-011	BROCAS	ZOST-011-1
				TARRAJAS	ZOST-011-2
				FRESAS	ZOST-011-3
				GRAPAS	ZOST-011-4
				HOJAS DE SIERRA	ZOST-011-5
		GRUPO VARIOS Y ACCESORIOS	ZOST-012	ARANDELAS	ZOST-012-1
				TUERCAS	ZOST-012-2
				TAPONES DE BLOQUEO	ZOST-012-3
				CLAVIJAS	ZOST-012-4

Fuente: Elaboración propia GRUGI - 2025
Nota: Este Grupo no tiene subgrupos desagregados para la primera versión del catálogo.

9.2.4. Depuración de materiales

Se realiza citación a través de la DIGSA a personal de las Direcciones de Sanidad de Ejército, Armada y Jefatura de Salud – JEFSA. Lo anterior con el fin de tener un grupo específico de expertos trabajando en tiempo real para la catalogación, especificación técnica y utilidad en cada fuerza de los diferentes insumos.

9.3. Catálogo de Dispositivos Médicos del SSFM

Para la elaboración de este catálogo se hizo una revisión de la normativa existente a nivel nacional, como se detalla en el fundamento normativo, detallado anteriormente, con relación al estándar semántico, la cual fue plasmada en las resoluciones 1405 del 2022, donde se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación de los dispositivos de uso humano y reactivos diagnósticos y la resolución 184 del 2024 donde se adopta la política de dispositivos médicos.

También se realizaron mesas de trabajo con personal médico del servicio de rehabilitación, enfermería, instrumentación quirúrgica, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, en las cuales se actualizó la información de los datos consignados en el Sistema de Información SILOG y éstos son los que forman parte del presente catálogo.

A fin de garantizar la calidad de los datos registrados y la gobernanza de los mismo, el catálogo debe ser actualizado una vez al año, por la DIGSA en conjunto con la JEFSA y las DISAN, tanto para crear como para bloquear materiales por cambio de tecnología.

La apropiación de un catálogo de materiales logísticos en una entidad de salud es un proceso estratégico que contribuye significativamente a la gestión eficiente de los recursos y a la mejora en la atención al paciente; este

Catálogo de Dispositivos Médicos representa un compromiso institucional clave, ya que este documento es el resultado de un trabajo conjunto entre diversas áreas asistenciales, técnicas y administrativas.

La correcta implementación, mantenimiento y mejora continua son fundamentales para garantizar la utilidad y vigencia en el tiempo. Este proceso implica no solo el uso activo del catálogo, sino también la actualización periódica, integración en los sistemas de información y adaptación a los cambios normativos y operativos del entorno institucional.

El ciclo de vida de un catálogo de dispositivos médicos se refiere a las etapas que atraviesa el catálogo desde su concepción y desarrollo hasta su evaluación y posible actualización o retiro. Este ciclo es crucial para asegurar que los consumibles, como equipos, materiales y productos necesarios para la atención médica, sean gestionados de manera eficiente y cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

A continuación, se describen las principales etapas del ciclo de vida de un catálogo de consumibles en salud y los pasos para llevar a cabo este proceso y su importancia:

Imagen 2. Ciclo de vida Catálogo de Dispositivos Médicos SSFM

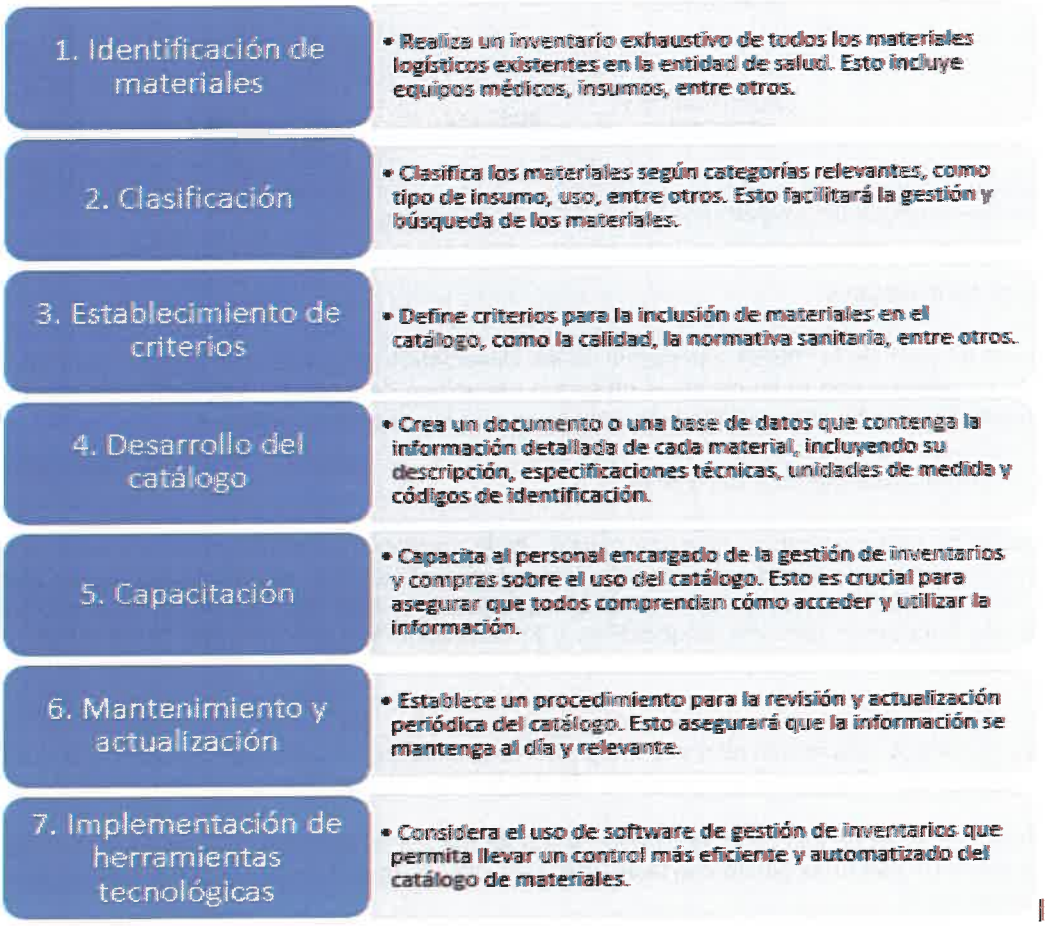

Fuente: Elaboración propia GRUGI – 2025

Numeral 1 y 2: En el desarrollo del presente catálogo en los puntos 9.1 y 9.2 se describieron las actividades iniciales del ciclo de vida del catálogo como son la identificación de los materiales y la clasificación de estos.

Numeral 3: En el punto tres, establecimiento de criterios para la inclusión de materiales en el catálogo la DIGSA tomó los datos maestros logísticos de sanidad configurados en el Sistema de Información SILOG, de acuerdo con la normativa vigente en el año 2009 por el MSPS y las necesidades propias del SSFM, como reza en el documento Proceso Datos Maestros (Ver Anexo N° 2). En este documento se describe el procedimiento para la creación del dato maestro, la información científica, logística y financiera que debe llevar el dato para ser creado en la herramienta informática del SILOG y la actualización de éstos. De acuerdo con la normativa vigente como son la Resolución 1405 del 2022, por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación de los dispositivos Médicos de uso humano reactivos de diagnóstico in vitro (Ver Anexo N° 3) y la Resolución 184 de 2024 por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos (Ver Anexo N° 4).

Para la creación del dato maestro se adicionará una validación previa de la información científica que se enviará al SILOG para la creación del material, la cual debe ser verificada por el personal de salud que conozca y use el dispositivo médico a crear, que no esté en el catálogo y siguiendo la siguiente estructura:

- ✓ Nombre en genérico, seguido de características como el material de elaboración, funcionabilidad y uso de este, presentación, unidad mínima de consumo.

  Ejemplo: Materia Médico Quirúrgico

Imagen 3. Médico Quirúrgico (Ejemplo)

Fuente: Elaboración propia GRUGI – 2025

- ✓ También se debe diligenciar la ficha que se diseñó para cada material o consumible que se vaya a crear:

Imagen 4. Ficha Catálogo Dispositivos Médicos DIGSA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	FICHA CATÁLOGO DISPOSITIVOS MÉDICOS DIGSA		
	CÓDIGO INTERNO		
	CÓDIGO UNSPSC		
TIPO DE MATERIAL			
GRUPO DE ARTÍCULO			
SUB-GRUPO DE ARTÍCULO			
UNIDAD DE MEDIDA		RUBRO	
NOMBRE DEL MATERIAL			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			

Fuente: Elaboración propia GRUGI – 2025

- ✓ Después de la validación de la información del material y del diligenciamiento de la ficha se debe enviar la información al SILOG según la normativa que tenga establecido y así continuar con la calidad y gobernanza de los datos y la información.

Numeral 4: En el punto cuatro encontrarán el desarrollo del catálogo, donde se relaciona el listado de los dispositivos médicos, consumibles y/o materiales, así:

Tabla 4. Desarrollo Estructural del Catálogo de Dispositivos Médicos SSFM

MATERIAL DE REHABILITACION V1 LINEA BLANDA								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2587506	42271906	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	ADHESIVO DE TRAQUEOSTOMIA	EL ADHESIVO PARA TRAQUEOSTOMIA ES UN PRODUCTO DISEÑADO PARA ASEGURAR DE MANERA SEGURA Y COMODA LA CANULA TRAQUEAL-ELABORADO EN MATERIAL ADHESIVO POLIURETANO O ACRILICO HIPOALERGENICO GRADO MEDICO-LIBRE DE LATEX-RESISTENTE A LA HUMEDAD-ELASTICO Y DE ADHERENCIA PROLONGADA-FACIL DE APLICAR Y RETIRAR-USO-FIJACION DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMIA EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS-ADECUADO PARA PIEL SENSIBLE-GARANTIZA UN SELLADO HERMETICO Y SEGURO EVITANDO DESPLAZAMIENTOS O PERDIDAS DEL TUBO-USO EN PROGRAMAS DE REHABILITACION-PRESENTACION-ROLLOS O LAMINAS PRE-CORTADAS EN DIFERENTES TAMAÑOS-ENVASES INDIVIDUALES O EN BLISTER.
2583588	42241802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRAGUERO INGUINAL ELABORADO EN MATERIAL ELASTICO SOPORTES ANATOMICOS	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL ELASTICO SOPORTES ANATOMICOS SUAVES TRANSPIRABLES AJUSTABLES CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE A NIVEL INGUINAL Y UNA FAJA CIRCULAR-USO PARA EVITAR EVENTRACIONES DE LAS HERNIAS-BAJO FORMULA MEDICA-ANEXAR MANUAL DE USO Y CUIDADOS PARA EL ASEO

2500176	42241802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A.02.02.01.003.005	CABESTRILLO ADULTO	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA DRILLY/O GABARDINA LIGERO 60-80% ALGODON-QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO ENVOLVENTE QUE APOYA ANTEBRAZO Y LA MUÑECA CORREA CON HEBILLA DESLIZANTE O CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE A LA ALTURA ADECUADA-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2503301	9100	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A.02.02.01.003.005	CABESTRILLO PEDIATRICO	CABESTRILLO ELABORADO EN TELA DRILLY/O GABARDINA LIGERO 60-80% ALGODON-QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO ENVOLVENTE QUE APOYA ANTEBRAZO Y LA MUÑECA CORREA CON HEBILLA DESLIZANTE O CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE- AJUSTABLE A LA ALTURA ADECUADA-DISEÑO PEDIATRICO-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583580	42251701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CINTURON PELVICO PARA HKAFOS EN MATERIAL TERMOPLASTICO	CINTURON PELVICO PARA HKAFOS EN MATERIAL TERMOPLASTICO GRADO MEDICO SOBRE MEDIDAS-FORRADO CON CAUCHO-ESPUMA-REATA Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583962	42241805	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CODERA SENCILLA EN NEOPRENO PERFORADO	ORTESIS DE CODO ELABORADA EN NEOPRENO PERFORADO GRADO MEDICO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL-DISEÑO ERGONOMICO-COSTURAS REFORZADAS-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2584539	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ABDUTOR DE CADERA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	COJIN ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DISEÑO ANATOMICO CON CANALES LATERALES QUE PERMITA POSICIONAR LAS PIERNAS-FORRO IMPERMEABLE Y CORREAS DE SUJECION CON CIERRE DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE QUE PERMITA MANTENER LA CADERA EN ABDUCCION-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583617	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ANTIESCARAS DE CAPA SUPERIOR	3 CAPAS DE DIFERENTES MATERIALES QUE BRINDAN COMODIDAD Y ALIVIO, CAPA INFERIOR EN ESPUMA CON MEMORIA DE 2 PULGADAS DE ALTO, CAPA IA CON GEL DE 0,6 PULGADAS DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR ELABORADAS EN BOLITAS DE GEL TECNICAMENTE SELLADAS, DIMENSIONES 40 X 40 X m., INCLUYE FORRO CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLISANTE Y CORREAS DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582476	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ANTIESCARAS BAJO PERFIL	COJIN DE FLOTACIÓN SECA-SISTEMA INFLABLE CON BOMBA-ELABORADO EN GOMA DE NEOPRENO RESISTENTE AL FUEGO-CELDAS DE 5 A 6 cm DE ALTURA-CON VALVULAS PARA ABRIR Y CERRAR EL FLUJO DE AIRE DEL COJIN Y VALVULA DE CONTROL PARA REGULAR LA DISTRIBUCION DE AIRE EN EL COJIN-INCLUYE FUNDA TRANSPIRABLE-ELASTICA REMOVIBLE DE FACIL LAVADO-VALVULA REGULADORA-BOMBA DE INFLADO Y KIT DE REPARACION-DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN LAS NECESIDADES DE CADA USUARIO-BAJO FORMULA MEDICA- AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2505906	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN DOBLE DENSIDAD/BARRA PREISQUIAL	COJIN EN ESPUMA GEL CON BARRA PREISQUIAL BASE MOLDEADA DE ALTA DENSIDAD DE LA ESPUMA ESTANTE LATERAL Y/O PREISQUIAL CONTORNEADO-CON CAMARAS EN GEL EN ZONAS DE PRESION-TAMAÑO AJUSTABLE AL TAMAÑO DE LA SILLA-BAJO FORMULA MEDICA-SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2584538	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	COJIN DE FLOTACIÓN SECA-SISTEMA INFLABLE CON BOMBA-ELABORADO EN GOMA DE NEOPRENO RESISTENTE AL FUEGO-CELDAS DE 10 cm DE ALTURA-CON VALVULAS PARA ABRIR Y CERRAR EL FLUJO DE AIRE DEL COJIN Y VALVULA DE CONTROL PARA REGULAR LA DISTRIBUCION DE AIRE EN EL COJIN-INCLUYE FUNDA TRANSPIRABLE-ELASTICA REMOVIBLE DE FACIL LAVADO-VALVULA REGULADORA-BOMBA DE INFLADO Y KIT DE REPARACION-DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN LAS NECESIDADES DE CADA USUARIO-BAJO FORMULA MEDICA- AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582516	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN DE ALIVIO DE PRESION DE MEDIANA DENSIDAD	COJIN ELABORADO EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD-CONTORNEADO LATERAL Y PREISQUIAL MEDIDAS DE 40X40 cm SOPORTA PESO HASTA DE 80 kg-FORRO IMPERMEABLE CON CIERRE DE CREMALLERA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583618	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN DE ALIVIO DE PRESION EN SILICONA ELABORADO EN MATERIAL VISCOELASTICO-CUADRADO	COJIN PARA ALIVIO DE PRESION-EN MATERIAL VISCOELASTICO-CUADRADO EN GEL DE SILICONA BLANDO DE FLOTACION LIQUIDA CON UNA FUNDA EXTERIOR REMOVIBLE-LAVABLE-ANTIDESLIZANTE-PESO MAXIMO DE SOPORTE DE 113 kg-AJUSTABLE A LA MEDIDA DE LA SILLA DE RUEDAS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2584530	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN DE COXIS ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD INYECTADA CON ORIFICIO CENTRAL	COJIN DE COXIS ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD INYECTADA CON ORIFICIO CENTRAL-RECUBIERTO DE FORRO REMOVIBLE DE FACIL LAVADO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2504590	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN DE POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD PELVICA-BASE FIRME DE ESPUMA CON HONDONADA PELVICA	COJIN DE POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD PELVICA-BASE FIRME DE ESPUMA CON HONDONADA PELVICA (BARRA PREISQUIAL)-CON CUÑAS LATERALES-OPTIMA ESTABILIDAD LATERAL Y ANTEROPOSTERIOR.
2582470	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ANTIESCARAS DE PRESION ALTERNA	COJIN ANTIESCARAS DE PRESION ALTERNA ELABORADO EN POLIVINILO, SOPORTE MAXIMO DE 113 kg PESO DEL COJIN 0,9 lb DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS 16 X 16"-18 X 16"-18 X 18"-DEBIDO A SUS CELDAS DE AIRE INTERCONECTADAS DISTRIBUYE EL PESO UNIFORMEMENTE-ESTE COJIN DE ASIENTO NEUMATICO UTILIZA UN CICLO CONSTANTE DE BAJA PRESION DE AIRE ALTERNA QUE FLUYE A TRAVES DE LAS CELDAS DE AIRE DEL COJIN-INCLUYE FORRO ESTANDAR-BOMBA PARA INFLAR-AL MOMENTO DE LA ENTREGA ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583619	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD-INSERTO DE GEL-MEDIO PERFIL	COJIN ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD-CONTORNEADO-CAVIDAD ISQUIATICA PROFUNDA-CON INSERTO DE FLUIDO-LIVIANO-ALTURA ENTRE 5 A 6 cm-FORRO IMPERMEABLE CON CIERRE DE CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE-QUE SE ADAPTE A LA SILLA DE RUEDAS-PESO MAXIMO 5 LIBRAS-DE FACIL TTRANSPORTE-USO-ALIVIO DE PRESION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2503754	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COLCHON ANTIESCARAS TIPO HOSPITALARIO-EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TROQUELADA	COLCHON ANTIESCARAS TIPO HOSPITALARIO-EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TROQUELADA-CALIBRE 8 - 12-DENSIDAD 30-32 kg/m3-FORRO ANTIFLUIDO ENTERO POR AMBAS CARAS Y CREMALLERA LATERAL O FRONTAL. CONTROLA Y EVITA LA APARICION DE ESCARAS MEJORANDO LA CIRCULACION SANGUINEA Y PERMITIENDO EL FLUJO DE AIRE EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL COLCHON-COMPATIBLE CON CAMAS HOSPITALARIAS ELECTRICAS O MANUALES-DISEÑADO PARA BRINDAR COMODIDAD-SEGURIDAD Y SOPORTE A PACIENTES DURANTE INSTANCIAS PROLOINGADAS EN CAMA-DE FACIL LIMPIEZA Y ALTA DURABILIDAD-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583620	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE DE 4 MODULOS CON SISTEMA DE FLOTACION SECA ELABORADO EN NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE DE 4 MODULOS CON SISTEMA DE FLOTACION SECA ELABORADO EN NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD-CELDAS INDEPENDIENTES DE 10 cm DE ALTURA-4 SECCIONES-SOPORTE DE PESO HASTA 135 kg INCLUYE PROTECTOR LAVABLE-BOMBA PARA INFLAR- DE FACIL LIMPIEZA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583621	42251617	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COLCHONETA ANTIESCARAS ELECTRICA	COLCHONETA ANTIESCARAS DE MOTOR-ELABORADA EN VINILO DURABLE Y RESISTENTE-DE FACIL LIMPIEZA-COMPRESOR QUE GENERE FLUJO DE AIRE CON PRESION VARIABLE SILENCIOSA QUE ALTERNADAMENTE INFLA Y DESINFLA LAS CELDAS DE AIRE-PESO MAXIMO DE SOPORTE HASTA 136 kg-PARA CAMA SENCILLA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2505745	42211610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	COLCHONETA ANTIESCARAS FABRICADA EN ESPUMA TROQUELADA EN FORMA DE PICOS	COLCHONETA ANTIESCARAS FABRICADA EN ESPUMA DE DENSIDAD 30-MATERIAL FLEXIBLE QUE PERMITE LA ADAPTACION A LOS MOVIMIENTOS DE CAMA HOSPITALARIA MEDIDAS-2.00 m DE LARGO X 0.90 m DE ANCHO X 0.13 m DE ALTO-SUPERFICIE CON SISTEMA ANTIESCARAS (TROQUELADA PARA EVITAR LAS ÚLCERAS POR PRESION)-FORRO EN MATERIAL IMPERMEABLE PARA BAÑO-SOPORTA PESO HASTA 80 kg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582559	42241803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-2	C/U	A-02-02-01-003-006	FAJA ABDOMINAL ELABORADA EN MATERIAL ACOLCHADO	FAJA ABDOMINAL- BLANDA QUE COADYUDA A LA PRESION QUE EJERCEN LOS MUSCULOS ABDOMINALES-FABRICADO CON ELASTICO LIBRE DE LATEX - REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X- CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE- COSTURA ESPECIAL ATRAUMATICA-DISPONIBILIDAD EN DIFERENTES TALLAS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2584537	42241811	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-2	C/U	A-02-02-01-003-006	FAJA DORSOLUMBAR-SEMIRIGIDA-CON MATERIAL DE SUSPENSION BLANDO	FAJA SEMIRIGIDA TORACOLUMBOSACRA-DISEÑO ANATOMICO-CON MATERIALDE SUSPENSION BLANDO-ELABORADA CON ELASTICO BLANCO DE DOBLE CAPA DE ALTA RESISTENCIA-INCLUIR DOS FERULAS MALEABLES REMOVIBLES DE 41 cm PARA LA PARTE POSTERIOR-CON CORREAS DE HOMBRO REMOVIBLES Y/O AJUSTABLES-FACIL CIERRE EN LA PARTE DE MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA DORSOLUMBAR-EN MATERIAL LAVABLE-ANTIALERGICO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2502660	42241811	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-2	C/U	A-02-02-01-003-006	FAJA TIPO CAMP-DISPOSITIVO DE INMOVILIZACION LUMBAR	LA ORTESIS BLANDA TIPO FAJA DEBE BRINDAR SOPORTE EN LA PARED ABDOMINAL CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-MANTENER LA POSICION POR MEDIO DE 4 FERULAS FIRMES Y MALEABLES- TENER EXCELENTE ADAPTACION ANATOMICA-BORDES SUAVES- ANTIALERGICO-BAJO FORMUILA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2503671	42295514	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	LAMINA GRANDE DE SILICONA 13 X 13 cm-ELABORADO EN GEL DE SILICONA-PARA PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.	LAMINA PEQUEÑA DE SILICONA 13 x 13cm-COMPOSICION-ELASTOMERO SOLIDO-INODORO-INCOLORO-INERTE Y ESTABLE A ALTAS TEMPERATURAS- QUE PROPORCIONA REFUERZO INTERNO- PARA CREAR LAMINAS DELGADAS Y DURADERAS-SON FINAS-AUTOADHESIVAS- POR UN LADO, SILICONA QUE SE PEGA A LA PIEL-REDUCE Y PREVIENE CICATRICES Y LA OTRA PARTE CUBIERTA POR UN TEJIDO SEDOSO-REDUCE LAS CICATRICES HIPERTROFICAS Y QUELOIDES-COMODAS-FACILES DE USAR- TRAMSPARENTES-SEMIPERMEABLES-DURADERAS Y LAVABLES-NO UTILIZAR EN HERIDAS ABIERTAS
2503672	42295514	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	LAMINA DE PEQUEÑA DE SILICONA 4 X 13 cm-ELABORADO EN GEL DE SILICONA-PARA PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS Y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.	LAMINA PEQUEÑA DE SILICONA 14 x 13 cm-COMPOSICION-ELASTOMERO SOLIDO-INODORO-INCOLORO-INERTE Y ESTABLE A ALTAS TEMPERATURAS- QUE PROPORCIONA REFUERZO INTERNO- PARA CREAR LAMINAS DELGADAS Y DURADERAS-SON FINAS-AUTOADHESIVAS- POR UN LADO SILICONA QUE SE PEGA A LA PIEL-REDUCE Y PREVIENE CICATRICES Y LA OTRA PARTE CUBIERTA POR UN TEJIDO SEDOSO-REDUCE LAS CICATRICES HIPERTROFICAS Y QUELOIDES-COMODAS-FACILES DE USAR- TRAMSPARENTES-SEMIPERMEABLES-DURADERAS Y LAVABLES-NO UTILIZAR EN HERIDAS ABIERTAS

2582709	42142120	ZMQX	ZMQX-001	MANGA ANTIEDEMA	C/U	A-02-02-01-003-006	MANGA DE COMPRESION PARA LINFEDEMA-VA DE LA MUÑECA HASTA EL HOMBRO-MANO LIBRE	MANGA DE COMPRESION PARA BRAZO GRADO MEDICO ENTRE 18 mm Hg Y 45 mm Hg-EN MATERIAL QUE LE PERMITA ESTIRARSE Y SER FLEXIBLE SIN PERDER SU FORMA-MEZCLA DE POLIMEROS DE DIFERENTES GRADOS DE FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA-FUNCIONAN EJERCIENDO PRESION PARA PROMOVER EL FLUJO DE LIQUIDOS HACIA AFUERA DE LA ZONA AFECTADA-AYUDAN A REDUCIR EL DOLOR Y LA INFLAMACION-DEBE CUBRIR TODA LA ZONA INFLAMADA-QUEDAR BIEN AJUSTADA SIN PARTES SUELATAS NI FLOJAS-NO CAUSAR DOLOR O MOLESTIAS COMO EL ENTUMECIMIENTO Y/U HORMIGUEO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2505823	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA A LA RODILLA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA. COMPRESION MEDIA ENTRE 15/22mmHg	MEDIA ANTIEMBOLICA A LA RODILLA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION MEDIA 15/ 22 mm Hg.
2582718	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA CON CINTURON-DE COMPRESION GRAUADA Y PROGRESIVA-PRESION MEDIA ENTRE 15/22mmHg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA CON CINTURON-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR-VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA-MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION MEDIA 15/ 22 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2582571	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION MEDIA ENTRE 15/22 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION MEDIA 15/ 22 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583647	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGESIVA-PRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION BAJA-8/15 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583513	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2503723	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA RODILLA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION EXTRA-FIRME ENTRE 30/40 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION EXTRA FIRME ENTRE 30/40 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583652	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583645	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2582710	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION MEDIA ENTRE 15/22 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION MEDIA ENTRE 15/22 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583646	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583643	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA CADERA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2504418	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION EXTRA-FIRME ENTRE 30/40 mm Hg	MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR- VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA- MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION EXTRA FIRME ENTRE 30/40 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582730	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION EXTRA-FIRME ENTRE 30/40 mm Hg	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR-VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA-MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION EXTRA FIRME ENTRE 30/40 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582497	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR-VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA-MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION BAJA ENTRE 8/15 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2582729	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION MEDIA ENTRE 15/20 mm Hg	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR-VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA-MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-CO MPRESION MEDIA ENTRE 15/20 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583511	42142802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA DE COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-PRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg	PANTY MEDIA ANTIEMBOLICA-INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR-VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)-HECHAS CON FIBRAS PARA FORMAR TEJIDOS ACTIVOS (MICROFIBRA)-ELASTANO-POLIAMIDA Y ALGODON ENTRE OTRAS-TECNOLOGIA DE PUNTA-MEDICAMENTE DISEÑADAS-FORMATO ANATOMICO Y TALON-ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS DEDOS-COMPRESION GRADUADA Y PROGRESIVA-COMPRESION FIRME ENTRE 20/30 mm Hg-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582557	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA CON EXTENSION AL HALLUX TIPO MORTON	PLANTILLA CON EXTENSION AL HALLUX TIPO MORTON EN FIBRA DE CARBONO DE RECUPERACION-UNA PIEZA INSERTO DE SOPORTE DE PIE MUY RIGIDO PARA DEDOS DE MORTON-ARTRITIS-HALLUX RIGIDOS-DOLOR DE DEDO GORDO Y ANTEPIE ROTO-PRESNETACION EN PAR-BAJO FORMULA MEDICA

2583558	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA ORTOPEDICAS CONVENSIONALES EN CUERO CON O SIN MODIFICACION-PLANTILLA-FORRADA EN BADANA NATURAL CON ADITAMENTOS-PAR	PLANTILLA ELABORADA SOBRE MEDIDAS-EN CUERO Y CORCHO-FORRADA EN BADANA NATURAL-CON ADITAMENTOS Y FORMA SEGUN ORDEN MEDICA- (ALMOHADILLA ESCAFOIDEA- REALCE INTERNO O EXTERNO-ARCO LONGITUDINAL-APOYO METATARSIANO-APOYO ESPOLON CALCANEO-BOTON METATARSIANO)-INDICADAS EN PIE PLANO O VALGO-EMPAQUE PAR-BAJO FORMULA MEDICA
2583559	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA EN MATERIAL TERMOPLASTICO U.C.B.L.-PAR	ORTESIS RIGIDA PLANTAR-ELABORADAS EN MATERIAL TERMOPLASTICO-BAJO MOLDE EN YESO-CUMPLIENDO CON REALCE O ADITAMENTO Y EVITANDO ZONAS DE PRESION-USO-CORREGIR-COMPENSAR Y ESTABILIZAR PATOLOGIAS CONGENITAS DE LOS PIES-ESPECIALMENTE EL PIE PLANO VALGO PRONUNCIADO DE RETROPIE DE NIÑOS EN CRECIMIENTO O EL VALGO CALCANEO Y EN ADULTOS PARA SOPORTE Y ALINEACION-EMPAQUE PAR-BAJO FORMULA MEDICA
2583983	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA EN PLASTAZOTE SOBREMEDIDA-PAR	PLANTILLA ELABORADA EN PLASTAZOTE-ESPUMA DE TERMOPLASTICO-POLIURETANO RETICULADO DE CELDA CERRADA EXPANDIDO POR NITROGENO-ESTA NUEVA ESPUMA HA SIDO PRODUCIDA PARA OBTENER UNA EXCELENTE ABSORCION DE IMPACTO-ASI COMO UNA RAPIDA Y MUY BUENA AMORTIGUACION-SIN FATIGA-SE REALIZAN BAJO MOLDE DE YESO A LA MEDIDA DEL USUARIO-PLANTILLA PARA PIE DE ALTO RIESGO-ARTITICO-ANESTESICO-DIABETICO-EMPAQUE PAR-BAJO FORMULA MEDICA
2582453	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA EN SILICONA SOBREMEDIDA CON BASE BLANDA-PAR	PLANTILLA ELABORADA EN 100% SILICONA INDEFORMABLE- BLANDA Y DE LARGA DURACION-DEBEN ABSORBER LOS IMPACTOS AL CAMINAR-CON RANURAS VERTICALES QUE DISIPAN LA ENERGIA GENERADA POR EL IMPACTO-CON OJIVA EN EL TALON Y ZONA METATARSAL DE DIFERENTE DENSIDAD PARA ACENTUAR LA AMORTIGUACION DE ESTAS EN EL CALZADO-EMPAQUE PAR-BAJO FORMULA MEDICA

2582541	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCANEO EN GEL DE SILICONA-	PLANTILLA ELABORADA EN GEL DE SILICONA DE ALTA CALIDAD PARA PROPORCIONAR AMORTIGUACION Y SOPORTE ESPECIFICO EN LA ZONA AFECTADA-INDICADO EN PATOLOGIAS DE ESPOLON CALCANEO-BAJO FORMULA MEDICA
2583584	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA TIPO TULIS ALTO IMPACTO-TALONERA EN GEL DE SILICONA-CON PUNTO BLANDO EN GEL DE MENOR DENSIDAD-PAR	PLANTILLA TIPO TALONERA ELABORADA EN GEL DE SILICONA CON DISEÑO DE ACOSTILLAMIENTO REFORZADO EN CUADRICULA QUE ABSORBE LOS IMPACTOS-DISEÑO ERGONOMICO QUE SE ADAPTA AL TALON-PROPORCIONA SOPORTE ADICIONAL Y ESTABILIDAD AL CAMINAR-AMORTIGUACION QUE AYUDA A REDUCIR LA PRESION SOBRE LOS TALONES PREVINIENDO EL DOLOR Y LESIONES POR EL IMPACTO REPETITIVO-PERMITE ADAPTACION A CUALQUIER ZAPATO-USO-EN TALAGIAS-TENDINITIS DEL TENDON DE AQUILES-PARA PREVENIR Y ALIVIAR LA PRESION EN EL ESPOLON CALCANEO-PRESENTACION EN PAR-BAJO FORMULA MEDICA
2583585	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PLANTILLA TIPO TULIS BAJO IMPACTO-TALONERA EN GEL DE SILICONA-PERSONAS MENORES DE 80 kg-PAR	PLANTILLA TIPO TALONERA ELABORADA EN FORMA DE CUADRICULA-GEL DE SILICONA QUE ABSORBE LOS IMPACTOS-DISEÑO ERGONOMICO QUE SE ADAPTA AL TALON-PROPORCIONA SOPORTE ADICIONAL Y ESTABILIDAD AL CAMINAR-AMORTIGUACION QUE AYUDA A REDUCIR LA PRESION SOBRE LOS TALONES PREVINIENDO EL DOLOR Y LESIONES POR EL IMPACTO REPETITIVO-PERMITE ADAPTACION A CUALQUIER ZAPATO-USO-EN TALAGIAS-TENDINITIS DEL TENDON DE AQUILES-PARA PREVENIR Y ALIVIAR LA PRESION EN EL ESPOLON CALCANEO-PRESNTACION EN PAR-BAJO FORMULA MEDICA

2504405	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA GUANTE CON DEDOS BORDE SILICONADO 15-21mmHg	PRENDA GUANTE CON DEDOS, BORDE SILICONADO, GRADIENTE DE PRESION 15/21mmHg. ELABORADO EN HILO A BASE DE POLIAMIDA O ALGODON QUE SE TEJE ALREDEDOR DE UN NUCLEO ELASTICO DE LATEX O ELASTANO, QUE DAN LA EXTENSIBILIDAD Y FUERZA DEL HILO. FUNCIONALIDAD: MOVILIZACION DEL EDEMA, MEJORA EL DRENAJE LINFATICO, GRADIENTE DE COMPRESION DE DISTAL A PROXIMAL, ADAPTACION ANATOMICA, EFECTO MICRO-MASAJE, CONFORTABLE Y FACIL DE UTILIZAR, TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO.
2503806	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA COMPRESIVA ANTIEDEMA MMII	PRENDA COMPRESIVA ESTILO MANGA, PARA MMII, IDEALES PARA DRENAJE LINFATICO Y TRATAMIENTO DE COMPRESION NEUMATICA, SEGUN PRESCRIPCION MEDICA.
2583628	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA-FAJA-VENDA DE COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO PARA TORAX Y ESPALDA	PRENDA-FAJA-VENDA DE COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO DE MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO; DEBEN SER LIGERA, RESISTENTE, CON NIVEL DE COMPRESION PERMANENTE Y UNIFORME, SEGUN NECESIDAD DEL PACIENTE, HIPOALERGENICA, TRANSPIRABLE, QUE SE ADAPTE AL CUERPO, NO FORME PLIEGUES NI SE DESLICE. ELABORADA SOBRE MEDIDAS Y SEGUN ORDEN MEDICA.
2504406	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA GUANTE CON DEDOS, BORDE SILICONADO, GRADIENTE DE PRESION GRADIENTE DE PRESION 22-32MMHG	PRENDA GUANTE CON DEDOS, BORDE SILICONADO, GRADIENTE DE PRESION 22-32mmHg. ELABORADO EN HILO A BASE DE POLIAMIDA O ALGODON QUE SE TEJE ALREDEDOR DE UN NUCLEO ELASTICO DE LATEX O ELASTANO, QUE DAN LA EXTENSIBILIDAD Y FUERZA DEL HILO. FUNCIONALIDAD: MOVILIZACION DEL EDEMA, MEJORA EL DRENAJE LINFATICO, GRADIENTE DE COMPRESION DE DISTAL A PROXIMAL, ADAPTACION ANATOMICA, EFECTO MICRO-MASAJE, CONFORTABLE Y FACIL DE UTILIZAR, TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO.

2583626	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA DE COMPRESION TUBULAR PARA MMSS	PRENDA-FAJA-VENDA DE COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO PARA MIEMBROS SUPERIORES, COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO DE MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO; DEBEN SER LIGERA, RESISTENTE, CON NIVEL DE COMPRESION PERMANENTE Y UNIFORME, SEGUN NECESIDAD DEL PACIENTE, HIPOALERGENICA, TRANSPIRABLE, QUE SE ADAPTE AL CUERPO, NO FORME PLIEGUES NI SE DESLICE. ELABORADA SOBRE MEDIDAS Y SEGUN ORDEN MEDICA
2503806	42311504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-1	C/U	A-02-02-01-003-006	PRENDA DE COMPRESION TUBULAR PARA MMII	PRENDA-FAJA-VENDA DE COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO PARA MIEMBROS INFERIORES, COMPRESION TUBULAR, EN TEJIDO DE MEZCLA DE POLIAMIDA Y ELASTANO; DEBEN SER LIGERA, RESISTENTE, CON NIVEL DE COMPRESION PERMANENTE Y UNIFORME, SEGUN NECESIDAD DEL PACIENTE, HIPOALERGENICA, TRANSPIRABLE, QUE SE ADAPTE AL CUERPO, NO FORME PLIEGUES NI SE DESLICE. ELABORADA SOBRE MEDIDAS Y SEGUN ORDEN MEDICA
2583591	42241709	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	SANDALIA PARA YESO	CONFECCIONADOS SIN HORMA-DISEÑO AMPLIO Y AJUSTABLE QUE PERMITA ACOMODAR EL TAMAÑO Y LA FORMA DEL YESO-CON SUELA DURA QUE NO PERMITA QUEBRANTES DE LA MISMA-EL RESTO DEL ZAPATO ES CONFECCIONADO EN LONA CON LAS DIFERENTES MEDIDAS DEL PACIENTE Y CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS PARA FACIL AJUSTE Y MANEJO DEL PACIENTE-USO MINIMIZAR LA PRESION SOBRE LA ZONA AFECTADA-BAJO FORMULA MEDICA

2504501	42221518	ZMQX	ZMQX-001		RO	A-02-02-01-003-006	VENDAJE NEUROMUSCULAR 5 cm X 5 m- EN ROLLO-DIFERENTES COLORES	VENDAJE NEUROMUSCULAR 5 cm x 5 M-ESPARADRAPO ELASTICO TEJIDO DE ALGODON LIBRE DE LATEX Y LLEVA UN PEGAMENTO DE USO MEDICO QUE PERMITE ADHERIRSE A LA PIEL-ELASTICO EN SENTIDO LONGITUDINAL MIENTRAS QUE EN SENTIDO TRANSVERSAL ES RIGIDO-UNA VEZ COLOCADO EN LA PIEL NO SE DESPEGA POR EL SUDOR Y SOPORTAN SIN PROBLEMAS LA INMERSION EN EL AGUA-ROLLO-DIFERENTES COLORES
ORTESIS								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de art ículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2583589	42242106	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ALMOHADILLA DE FREDJKA ELABORADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	ORTESIS PEDIATRICA ELABORADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD-ACOLCHADA CON TELA DE ALGODON-CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-INDICADA EN CASO DE DISPLASIA DE CADERA-SU FUNCION ES MANTENER LAS CADERAS EN ABDUCCION Y FLEXION PARA QUE LA CABEZA FEMORAL SE MANTENGA FIJA EN EL ACETABULO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2502650	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ANILLO ANTIDEFORMANTE ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO-SOBREMEDIDAS-DISEÑO ANATOMICO-CORRIGEN LA CAIDA DE LA ULTIMA FALANGE DE LOS DEDOS POR LESION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2582484	42241700	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ANILLO SUBROTULIANO-FABRICADO EN NEOPRENO ACOLCHADO	ORTESIS-ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR- PROMUEVE LA RECUPERACION DEL TENDON PATELAR Y PREVIENE LA INFLAMACION DE ESTE- USO-PREVENCION DEPORTIVA, TENDINITIS PATELAR Y USO TERAPEUTICO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2505819	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	APARATO GENU VALGO CON TENSORES - PAR - ESTRUCTURA EN TERMOPLASTICO A 45° EN ABDUCCION Y 90° DE FLEXION	APARATO GENU VALGU CON TENSORES GRADUABLES EN ALUMINIO-PAR-PREVIA TOMA DE MOLDE DE YESO-LAS ORTESIS CORRECTORAS DE GENU VALGO SON PARA MIEMBRO INFERIOR QUE PREVIENEN O CORRIGEN LA PROGRESION DE UNA DEFORMIDAD, REALINEANDO LA DESVIACION LOGICA DEL EJE DE LA RODILLA EN EJE FRONTAL- SU FINALIDAD TERAPEUTICA ES CORREGIR Y REALINEAR LA DESVIACION EN VARO O VALGO DE MIEMBROS INFERIORES APROVECHANDO EL EFECTO CORRECTOR Y ALINEADOR DE LA ORTESIS EN AQUELLOS NIÑOS QUE TIENEN AUN CIERTO POTENCIALCRECIMIENTO OSEO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583561	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	APARATO TWISTER CON ZAPATOS-ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS SEGUN MEDIDAS INDIVIDUALES-PREVIO MOLDE EN YESO-ELABORADOS EN MATERIAL TERMOPLASTICO-BANDA PELVICA FORRADA EN BADANA-KIT DE GUAYAS EN ACERO-AJUSTE CON CORREAS CON CIERRES DE CONTACTO Y PROTECTORES-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2583590	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ARNES DE PAVLICK-CINTURON TORACICO CON TIRANTES Y HEBILLAS	ORTESIS QUE CONSTA DE UN CINTURON TORACICO COMPUESTO POR TIRANTES DE POLIESTER CON FORRO INTERNO SUAVE (AFELPADO-LAVABLE) CON TIRANTES EN POLIESTER ANTERIORES Y POSTERIORES Y HEBILLAS ANTERIORES Y POSTERIORES AJUSTABLES CON CIERRE DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE QUE PERMITEN DIFERENTES GRADOS DE FLEXION Y ABDUCCION DE CADERA BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582570	42241701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BOTA WALKER RIGIDA-ORTESIS FUNCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR PARA TOBILLO Y PIE RIGIDA	ORTESIS FUNCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR PARA TOBILLO Y PIE RIGIDA-ELABORADA CON UNA SUELA CURVA ANTIDESLIZANTE- EN FORMA DE BOTA CON UN BOTIN O FUNDA INTERNA-DE UNA SOLA PIEZA- DISEÑO LIGERO Y RESISTENTE-DE MATERIAL TRANSPIRABLE Y BARRAS ESTABILIZADORAS LATERALES SEMIRIGIDAS UNIDAS A UNA BASE PLASTICA-RESISTENTE-DISEÑO ANATOMICO DE FACIL COLOCACION Y AJUSTES CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-PARA DAR SEGURIDAD DURANTE LA MARCHA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583583	42241701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BOTA WALKER ARTICULADA ORTESIS FUNCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR PARA TOBILLO Y PIE ARTICULADA	ORTESIS FUNCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR PARA TOBILLO Y PIE RIGIDA-ELABORADA CON UNA SUELA CURVA ANTIDESLIZANTE- EN FORMA DE BOTA CON UN BOTIN O FUNDA INTERNA-DE UNA SOLA PIEZA- DISEÑO LIGERO Y RESISTENTE-DE MATERIAL TRANSPIRABLE Y BARRAS ESTABILIZADORAS LATERALES SEMIRIGIDAS UNIDAS A UNA BASE PLASTICA-RESISTENTE-ARTICULACIONES REGULATORIAS DE RANGO DE MOVIMIENTO DE FLEXO-EXTENSION-DISEÑO ANATOMICO DE FACIL COLOCACION Y AJUSTES CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-PARA DAR SEGURIDAD DURANTE LA MARCHA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2582875	13111303	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BOTON METATARSIANO	ORTESIS PARA EL ANTEPIE, FABRICADO EN SILICONA VISCOELASTICA QUE PERMITE ADHESION A LA PLANTILLA DEL ZAPATO-DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE BOTON SEGUN EL TAMAÑO DEL PIE-USO-PARA CASOS DE METATARSALGIA Y DE HIPERQUERATOSIS METATARSIANO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2502654	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE CORTO POST OPERATORIO DE RODILLA-ELABORADO EN POLIESTER ACOLCHADO	ORTESIS ELABORADA EN POLIESTER ACOLCHADO TRANSPIRABLE SUPERFICIE INTERNA ANTIDESLIZANTES CON CORREAS AJUSTABLES-CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE SOPORTES RIGIDOS MEDIALES Y LATERALES ARTICULADOS CON CUÑA DE GRADUACION CON TAPA PARA TOPE A LA EXTENSION DE 0° A 45° Y LA FLEXION DE 0° A 90° LONGITUD AJUSTABLE DESDE HASTA 51 cm-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583658	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE DE MUÑECA AMBIDIESTRO UNIVERSAL ELABORADA EN NEOPRENO	ORTESIS ELABORADA EN NEOPRENO CON BARRA EL ALUMINIO INTERCAMBIABLE PARA MANO DERECHA O IZQUIERDA QUE PERMITA INMOVILIZAR LA MUÑECA TRANSPIRABLE CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2502655	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE ELABORADA EN NEOPRENO TRANSPIRABLE	ORTESIS ELABORADA EN NEOPRENO HIPOALERGENICO Y TRANSPIRABLE CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO BANDA SUPERIOR E INFERIOR AJUSTABLES CON CIERRE DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-ARTICULACION METALICA LIBRE CON BARRAS LATERALES EN FORMA DE BISAGRA PARA ESTABILIDAD LATERAL Y MEDIAL DE RODILLA Y PATELA-BAJO FORMULA MEDICA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2502657	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE PARA CODO ARTICULADO FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE BIVALVADO CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN CAUCHO ESPUMA Y ORIFICIOS DE TRANSPIRACION CON ARTICULACION PARA FLEXION Y EXTENSION GRADUABLE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-BAJO FORMULA MEDICA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583985	42241700	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE POSTOPERATORIO DE RODILLA LARGO ELABORADO EN POLIESTER ACOLCHADO	ORTESIS ELABORADO EN POLIESTER ACOLCHADO-TRANSPIRABLE SUPERFICIE INTERNA ANTIDESLIZANTES CON CORREAS AJUSTABLES-CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-SOPORTES RIGIDOS MEDIALES Y LATERALES ARTICULADOS CON CUÑA DE GRADUACION CON TAPA PARA TOPE A LA EXTENSION DE 0° A 45° Y LA FLEXION DE 0° A 90° LONGITUD AJUSTABLE DESDE HASTA 61 cm-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582492	42241701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	BRACE DE TOBILLO RIGIDO ESTABILIZADORA DE CUELLO DE PIE EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS DE ESTRUCTURA PREVIO MATERIAL TERMOPLASTICO CON FORROS EN SU INTERIOR DE NEOPRENO RESPIRABLE CON CORREAS AJUSTABLES CON CIERRE DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE LIMITANDO LOS MOVIMIENTOS DE INVERSION Y EVERSION DE CUELLO DE PIE-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2502535	42241803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	COLLAR DE PHILADELPHIA ADULTO-EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	ORTESIS CERVICAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD RESPIRABLE ADAPTABLE A LA MEDIDA DEL PACIENTE-CON SOPORTE MENTONIANO-OCCIPITAL Y ESTERNAL-ORIFICIOS DE VENTILACION Y TABIQUES EN TERMOPLASTICO DE REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR-SISTEMA BIVALVO CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE BILATERAL-DISPONIBILIDAD EN TALLAS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE

								INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582670	42241803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	COLLAR DE THOMAS BLANDO ADULTO-CON DISEÑO ANATOMICO EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD	ORTESIS BLANDA CON DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA-EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD-CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO BUCLE-FORRO DE ALGODON HIPOALERGENICO Y TRANSPIRABLE-CON REPUESTO INTERCAMBIABLE-MANTIENE LA COLUMNA EN HIPEREXTENSION-ESTABILIZA LA ESPINA DORSAL CERVICAL-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2503291	42241803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	COLLAR DE THOMAS BLANDO PEDIATRICO-DISEÑO ANATOMICO-ESPUMA DE BAJA DENSIDAD	ORTESIS BLANDA PEDIATRICA-DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA-EN ESPUMA DE BAJA DENSIDAD FORRO DE ALGODON HIPOALERGENICO EN FORMA CIRCULAR-CON SISTEMA DE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-MEDIDAS CONTORNO DE CUELLO-43 cm-53 cm-ANCHO-7-5 cm Alto 3 cm-INTERCAMBIABLE-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2504046	42250000	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	COLLAR CERVICAL MULTITALLA DE UNA SOLA PIEZA PARA EMERGENCIAS	COLLAR CERVICAL MULTITALLA DE UNA SOLA PIEZA CON UNA ESTRUCTURA DE PLASTICO-PARA EMERGENCIAS-EN MATERIAL HIPOALERGENICO-TRANSPARENTE A RAYOS X-AJUSTE SIMETRICO DE CIERRE AUDIBLE Y TACTIL POR SEGURIDAD-CON ABERTURA TRAQUEAL-FACIL ACCESO AL PULSO CAROTIDEO-FACIL ACCESO A TECNICAS AVANZADAS DE VIA AEREA-COLOCACION FACIL Y RAPIDA-MENOR NECESIDAD DE ESPACIO-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2505144	42250000	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	COLLAR CERVICAL MULTITALLA DE UNA SOLA PIEZA PARA EMERGENCIAS-PEDIATRICO	COLLAR CERVICAL MULTITALLA DE UNA SOLA PIEZA CON UNA ESTRUCTURA DE PLASTICO-PARA EMERGENCIAS-EN MATERIAL HIPOALERGENICO-TRANSPARENTE A RAYOS X-AJUSTE SIMETRICO DE CIERRE AUDIBLE Y TACTIL POR SEGURIDAD-CON ABERURA TRAQUEAL, FACIL ACCESO AL PULSO CAROTIDEO, FACIL ACCESO A TECNICAS AVANZADAS DE VIA AEREA-COLOCACION FACIL Y RAPIDA-MENOR NECESIDAD DE ESPACIO-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583545	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CORSET DE TAYLOR-DORSO LUMBAR	ORTESIS FORMADA POR UNA ESTRUCTURA METALICA ACOLCHADA CON FAJA DE TELA AJUSTABLE Y CORREAS EN HOMBRO DE SUJECION QUE MANTIENE LAS CURVATURAS DORSO LUMBARES FISIOLOGICAS-PREVIENE DEFORMIDADES POSTURALES O LAS CIFOSIS PATOLOGICAS-PUEDEN SER FUNCIONALES O PARA HIPER EXTENSION DEL SEGMENTO DORSAL-USO-PARA PATOLOGIAS DE COLUMNA VERTEBRAL-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2503662	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3		A-02-02-01-003-006	CORSE LSO WILLIAMS	CORSE LSO WILLIAMS-ORTESIS LUMBOSACRA FORMADA POR UNA ESTRUCTURA METALICA-COMPUESTA POR UNA BANDA PELVICA Y OTRA TORACCICA-UNIDAS ENTRE SI POR 4 BANDAS VERTICALES-LAS BANDAS LATERALES ARTICULAN DE FORMA FLEXIBLE SOBRE LA BANDA PELVICA-EL CONJUNTO VA FORRADO CON UNA FUNDA DE TELA ALMOHADILLA EN SU PARTE INTERNA Y SE SUSTENTA POR MEDIO DE UN DELANTERO DE TELA-ORTESIS DE FLEXION-PREVIENE LA LORDOSIS EXCESIVA-PERMITE LA FLEXION- LIMITA LA FLEXION LATERAL-INDICADA PARA LA ESPONDILOLISTESIS-ESTENOSIS LUMBAR O ARTROPATIA FACETARIA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2587170	42241802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CORRECTOR DINAMICO PARA PECTUS CARINATUM-ELABORADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE	ORTESIS ELABORADA A LA MEDIDA DEL PACIENTE FABRICADO EN ALUMINIO-FAJA PARA MINIMIZAR ALERONES Y PLACA PARA MEDIR PRESION PSI CON SEGUIMIENTO Y TOMA DE MEDIDAS EN 3D-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582477	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA DE ABDUCCION TIPO MILGRAM EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS DE ABDUCCION TIPO MILGRAM SOBREMEDIDAS-ESTRUCTURA EN TERMOPLASTICO-CON FORRO INTERNO-BANDAS DE CIERRE CON CINTAS ADHESIVAS DE CONTACTO A NIVEL DE LA CINTURA Y PIERNAS PARA DAR ESTABILIDAD-OBJETIVO CORREGIR LAS ALTERACIONES ANATOMICAS Y FUNCIONALES QUE ESTAN PRESENTES EN LOS NIÑOS QUE PADECEN DE DESARROLLO DISPLASICO DE LA CADERA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583964	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA ANTIESPASTICA EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANA A LA MEDIDA DEL PACIENTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO PERFORADO Y PREFORMADO-CON FORRO INTERIOR DE RIZO ABSORBENTE-CORREAS DE SUJECION MUÑECA Y ANTEBRAZO CON PASADOR DE SEGURIDAD Y PULGAR-CORREAS DE SUJECION Y CONTROL DE LA FLEXION METACARPOFALANGICA E INTERFALANGICA-MANTIENE LAS ARTICULACIONES DE LA MUÑECA-MANO Y DEDOS EN LIGERA FLEXION-SEPARACION DE DEDOS EJERCIENDO MEDIANTE LAS CORREAS UNA FUERZA EXTENSORA INDIVIDUAL EN CADA DEDO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2582490	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS ANTIGENU VALGO O VARO BILATERAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS SEGUN MEDIDAS INDIVIDUALES PREVIO MOLDE EN YESO-ELABORADAS EN MATERIAL TERMOPLASTICO-CON CORREAS Y AJUSTES CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y PROTECTORES ACOLCHADAS-TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583601	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA CANALETA PARA DEDOS SOBREMEDIDAS	ORTESIS EN TERMOPLASTICO BAJO MOLDE TIPO CANALETA CON CORREAS DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583562	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA DE ATLANTA	ORTESIS COMPUESTA DE DOS MUSLERAS EN MATERIAL TERMOFORMADO-UNIDAS EN LA PARTE INTERNA POR DOS TUBOS ARTICULADOS A UNA BARRA TRANSVERSAL TELESCOPICA-A LOS LADOS LLEVA DOS ARTICULACIONES DE CADERA LIBRES UNIDAS A UN CINTURON PELVICO DE SOSTEN ACOLCHADO CON CORREA DE SUJECION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS PARA EL ASEO.
2502664	42241705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DENNIS BROWN CON ZAPATOS EN CUERO	FERULA CON ZAPATOS EN CUERO-CON BARRA DE ALUMINIO PARA GRADUACION BILATERAL-SUELA GRUESA Y RESISTENTE-LA BARRA SEPARADORA ES MOLDEABLE CONVEXAMENTE O CONCAVAMENTE PARA OBTENER PRONACION O SUPINACION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583598	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA DINAMICA DE PULGAR ELABORADA CON SOPORTES EN TERMOPLASTICO	FERULA ELABORADA CON SOPORTES EN TERMOPLASTICO- RESORTES DE CONTROL EN HILO CAUCHO Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2583595	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA DINAMICA PARA MANO - ANTEBRAZO MANO DEDOS SOBRE MEDIDAS EN TERMOPLASTICO- CON RESORTE EN ACERO O EN HILO CAUCHO	ORTESIS ANTEBRAZO MANO DEDOS SOBRE MEDIDAS EN TERMOPLASTICO- CON RESORTE EN ACERO O EN HILO CAUCHO Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-INDICADA PARA TRAUMATISMOS DE LA MANO- SU FUNCION ES SEGUN LA PATOLOGIA- EXTIENDE ACTIVAMENTE LAS PARTES AFECTADAS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2502665	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA ESTATICA PARA MANO-ANTEBRAZO-MANO DEDOS-SOBRE MEDIDAS-EN TERMOPLASTICO-CON RECUBRIMEINTO INTERNO	ORTESIS SOBRE MEDIDAS EN TERMOPLASTICO-CON RECUBRIMIENTO INTERNO-AJUSTABLE CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-CUMPLE LA FUNCION DE MANTENER LA MUÑECA EN POSICION ESTATICA- DE ACUERDO CON EL PROCESO LA ARTICULACION PUEDE SER COLOCADA EN FLEXION- EXTENSION O POSICION FUNCIONAL-CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583602	42241806	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA JOINT JACK ELABORADA EN ALUMINIO-	ORTESIS ELABORADA EN ALUMINIO-FORRADA CON ESPUMA SUAVE Y CONFORTABLE-DEBE ADAPTARSE A TODAS LAS POSICIONES DE LOS DEDOS-EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CONSTA DE UN TORNILLO Y UNA CORREA FIJADOS DE FORMA PERMANENTE Y SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER PARTE DEL PUENTE DE LA FERULA-LA TENSION DE LA CORREA PROGRESA APRETANDO EL TORNILLO-INDICADA PARA POST CIRUGIA DE CONTRACTURA DE DUPUYTREN-LIBERACION DEL DEDO EN GATILLO (TENOSINOVITIS ESTENOSANTE O STS)-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2583603	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA PARA DEDOS TIPO ZIMMER EN ALUMINIO MALEABLE	ORTESIS PARA DEDOS EN ALUMINIO MALEABLE-SEMIRIGIDA-CON INTERIOR RECUBIERTO EN ESPUMA SUAVE- DISEÑO ANATOMICO-SE ADAPTA A LA LESION DE LOS DEDOS DE LA MANO DANDO SOPORTE PARA ESTABILIZAR-INMOVILIZAR Y PROTEGER LOS DEDOS LESIONADOS-USO- ESGUINCE Y FRACTURA DE DEDOS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583963	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA DE FASCITIS PLANTAR	ORTESIS ELABORADA EN TERMOPLASTICO-CON REVESTIMIENTO EN MATERIAL ACOLCHADO (LAMINADOS EN POLIESTER) - BANDAS DE AJUSTE EN LA PIERNA Y PIE CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS A LA MEDIDA DEL PACIENTE-UTILIZADA PARA EL AMORTIGUAMIENTO DEL APOYO PLANTAR-ABSORBE EL IMPACTO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583604	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	FERULA STACK EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO LIGERO QUE GARANTICE UNA BUENA INMOVILIZACION-EN FORMA DE DEDAL PARA ALOJAR LA YEMA DEL DEDO-LA PARTE SUPERIOR DEBE DEJAR LIBRE LA ZONA DE LA UÑA Y LLEGAR HASTA LA ARTICULACION INTERFALANGICA DISTAL-INDICADA PARA TODO TIPO DE LESIONES O TRAUMATISMOS EN LA FALANGE DISTAL DE LOS DEDOS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583600	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	ZMQX-001-3	A-02-02-01-003-006	FERULA DE MANO TIPO CONO	ORTESIS TIPO CONO SOBREMEDIDAS-EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA DEFORMIDAD EN Z DE PULGAR-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2582495	42241804	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	ORTESIS CON CORREAS ACOLCHADAS EN OCHO PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA-HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS EN MATERIAL TRICAPA-EN EL SITIO DE LA LESION-SOPORTE CON INTERERIOR DE ALGODON A NIVEL DE LA COLUMNA DORSAL PARA MAYOR ESTABILIDAD- HEBILLAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE MANEJO DESLIZABLE-MANTIENE LA POSTURA IDONEA-FACIL DE UTILIZAR-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583976	42241803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DE COSTILLAS/COSTILLERO	ORTESIS COSTAL -ELABORADA EN MATERIAL ELASTICO RESISTENTE Y AFELPADO- CON CIERRES DE CONTACTO-DEBE SERVIR PARA CONTENCION- SOPORTE Y APOYO-PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA-REDUCE LAS MOLESTIAS EN LA RECUPERACION DE LESIONES COSTALES (CONTUSION O FRACTURAS)- OSEAS O MUSCULARES-INSERTO ELASTICO QUE CONTROLA LA PRESION-INDICADO EN FRACTURA DE COSTILLAS- DESGARRES MUSCULARES A NIVEL DEL TORAX-PARA DAMA DEBE SER ESCOTADO CON FORMA PARA LIBERAR EL PECHO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2582698	42241801	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	ORTESIS DE HOMBRO CON BANDA ANCHA Y SOPORTE EN BOLSA PARA EL BRAZO Y MUÑECA-BANDA ALREDEDOR DEL TRONCO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL HOMBRO-FABRICADO EN TELA ACOLCHADA-TRANSPIRABLE-REGULABLE EN ALTURA QUE MANTIENE EL BRAZO SUJETO Y EL HOMBRO INMOVILIZADO MEDIANTE CINTA AJUSTALE A LA CINTURA-USOS-DISLOCACION DE HOMBRE-REHABILITACION POSTOPERATORIA-INMOVILIZADOR AMBIDIESTRO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2583959	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVION	ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR ELABORADA EN POLIURETANO-CON FORMA ANATOMICA EN ABDUCCION DE 45 A 90 GRADOS-FORRADA-CONSTA DE DOS PIEZAS CABESTRILLO Y BANDA PECTORAL-CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-CON POSIBILIDAD DE FIJAR Y CAMBIAR LA ANGULACION TANTO DE LA ABDUCCION COMO DE LA ANTEVERSION-TAMAÑO UNIVERSAL-INDICADA EN POSTOPERATORIO O POSTRAUMA DE HOMBRO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582847	42241705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DE RODILLA	INMOVILIZADOR DE RODILLA-FABRICADO EN LAMINADOS DE ALGODON Y POLIESTER ACOLCHADO, FERULAS ANTERIORES Y POSTERIORES CON TRES PANELES MOVIBLES-PARA AJUSTE A VARIAS TALLAS-BANDAS SUPERIORES E INFERIORES CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS- PARA BLOQUEO DE LA FLEXION DE RODILLA- USO-POLITRAUMATISMOS DE RODILLA-BAJO FORMULA MEDICA
2500078	42241703	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	INMOVILIZADOR DEL TOBILLO	INMOVILIZADOR DEL TOBILLO- FABRICADO EN LAMINADOS DE ALGODON Y POLIESTER ACOLCHADO, CON DOS SOPORTES LATERALES Y CIERRE REGULABLE PARA AJUSTE A VARIAS TALLAS-BANDAS SUPERIORES E INFERIORES CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-PARA BLOQUEO DE LA FLEXION DEL TOBILLO-USO-TRAUMATISMOS DE TOBILLO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2583969	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	MUÑEQUERA SENCILLA EN NEOPRENO VENDAJE FLEXIBLE CON ORIFICIO EN EL PULGAR	ORTESIS EN NEOPRENO GRADO MEDICO TRANSPIRABLE-FLEXIBLE-CON ORIFICIO EN EL PULGAR QUE LE PERMITE SER AMBIDIESTRA-CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA-RETIENE EL CALOR-LO QUE PUEDE AYUDAR Y ACELERAR EL PROCESO DE RECUPERACION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582448	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR EN ABDUCCION ELABORADA EN NEOPRENO	ORTESIS ELABORADA EN NEOPRENO GRADO MEDICO-TRANSPIRABLE CON INTERIOR FORRADO EN FELPA PARA COMODIDAD DE USO-FERULA PALMAR EN ALUMINIO MOLDEADA ANATOMICAMENTE Y FERULA RIGIDA PARA EL DEDO PULGAR-DISEÑO AJUSTABLE-DISPONIBLE PARA MANO IZQUIERDA Y DERECHA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583549	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE BOSTON TORACOLUMBAR EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS TIPO CORSET TORACOLUMBAR ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO-FORRADO EN TELA SUAVE EN ZONAS DE PRESION-CORREAS DE SUJECION CON CIERRE DE CONTACTO ADHESIVOS-INDICADO PARA ESCOLIOSIS LUMBAR O DORSAL-CORRECCION PASIVA DEL RAQUIS A TRAVES DE COJINES DE PRESION BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2582467	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE ABDUCCION DE CADERA ADULTO CON ARTICULACION GRADUABLE	ORTESIS ELABORADA SOBRE MEDIDAS PREVIA TOMA DE MOLDE DE YESO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO COMPUESTA POR UNA BANDA PELVICA Y UNA MUSLERA (AMBAS BIVALDAS)-UNIDAS ENTRE SI POR UNA ARTICULACION REGULABLE EN FLEXO EXTENSION DE 0° A 90° Y EN ABDUCION EN LAS POSICIONES DE 0° - 15° Y 30°-SISTEMA DE SUJECION (AJUSTE) CON CORREAS DE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y PROTECTORES-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2503274	42241800	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS CORRECTOR DE POSTURA	ORTESIS CORRECTOR DE POSTURA-COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA-PROLONGA SOBRE LOS HOMBROS, REALIZANDO EL SOPORTE EN UN PUNTO CENTRAL EN LA ESPALDA. AJUSTE CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-AYUDA A PREVENIR LA MALA POSTURA-INMOVILIZA LA CLAVILCULA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583564	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS CORTA PARA PIE CAIDO O-T-P- (AFO) EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO-FORRADA-CON ALMOHADILLAS-SISTEMA DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-SEGUN MEDIDA DEL PACIENTE-E INDICACIONES DEL ESPECIALISTA-SOBRE MEDIDAS-ORTESIS DE TOBILLO PIE-PARA USO CON CALZADO CONVENCIONAL-COMPONENTE POSTERIOR MEDIA EN ESPIRAL-LAVABLE-TRANSPIRABLE-MATERIAL SEMIRIGIDO CON PLATINA QUE PERMITA AJUSTAR SEGUN TALLA DEL PACIENTE-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO

2587169	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS CRANEAL DINAMICA TIPO STARBAND CON BANDAS DE SUJECION	ORTESIS ULTRALIVIANA TIPO CASCO E HIPOALERGENICA FABRICADA CON FIBRAS DE COPOLIMEROS Y MATERIAL TERMOPLASTICO-EN SU INTERIOR LLEVA UNA ESPUMA HIPOALERGENICA-TERMOFORMADA QUE SE VA MODIFICANDO PROGRESIVAMENTE DE ACUERDO A LA MONITORIZACION DE LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS-ESTA RIGUROSAMENTE FABRICADA SOBRE MEDIDAS TOMADAS DE LA CABEZA DEL PACIENTE MEDIANTE ESCANER DIGITAL EN 3D-PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES DE CRANEO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583980	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE JEWETT-DE EXTENSION DORSAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS TIPO CORSET DE TRONCO DE EXTENSION DORSAL-FABRICADO BAJO MOLDE DE YESO- EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON PUNTOS DE APOYO REGULABLES-CON RECUBRIMIENTO INTERNO-CON SISTEMA DE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y/O CORREAS DE SUJECION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583548	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE MILWAUKEE (CTLSO) ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS CERVICO-TORACO-LUMBAR (CTLSO) ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO COMPUESTA POR UN ANILLO PELVICO-BARRA ANTERIOR Y BARRA POSTERIOR ACOLCHADAS-CORREDERAS AJUSTABLES A LA CURVA ESCOLITICA-ANILLO CERVICAL Y SOPORTE MENTONIANO-FORRADO EN LOS PUNTOS DE PRESION PARA EVITAR ULCERACION-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2582449	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE SEDESTACION-SOBREMEDIDAS	ASIENTO DE SOPORTE ELABORADO SOBRE MEDIDAS O BAJO MOLDE DE YESO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON CUBIERTA INTERIOR EN PLASTAZOTE Y EXCUSA EN

								PUNTOS DE APOYO-SOPORTE CEFALICO AJUSTABLE EN ALTURA-CON ARNES Y CORREAS DE SUJECION-CON SOPORTE DE MADERA VISAGRADO EN V PARA LOGRAR UN POSICIONAMIENTO DE BASCULACION-SOPORTADA CON CILINDRO-APOYA PIES REMOVIBLE-USO POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE PEDIATRICO Y ADULTO JOVEN CON PATOLOGIA NEUROLOGICA Y-O OSTEOMUSCULAR PARA PREVENIR DEFORMIDAD DE COLUMNA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583553	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE TRONCO L- S- O- EN MATERIAL TERMOPLASTICO-	ORTESIS TIPO CORSE SACROLUMBAR EN MATERIAL TERMOPLASTICO-ELABORADA BAJO MOLDE YESO-AJUSTABLE CON CORREAS DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-RECUBRIMIENTO INTERNO-DE APERTURA ANTERIOR O LATERAL-BIVALVA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583547	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE TRONCO TIPO KNIGHT TAYLOR-ELABORADO SOBRE MEDIDAS-	ORTESIS DE TRONCO TIPO CORSE CON INMOVILIZADOR METALICO DE COLUMNA DORSOLUMBOSACRA-FORRADO EN LOS PUNTOS DE PRESION-GRADUABLE-AJUSTADO CON CORREAS EN REATA Y CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-MANTIENE LA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR EN POSICION FUNCIONAL-MANTIENE LAS CURVATURAS DORSOLUMBARES FISIOLOGICAS-PREVIENE DEFORMIDADES POSTURALES O LAS CIFOSIS PATOLOGICAS-ELABORADO SOBRE MEDIDAS-BAJO FORMULA MEDICA

2584535	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE TRONCO T-L-S-O-BIVALVO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO-	ORTESIS TORACO-LUMBOSACRO TIPO CORSE EN MATERIAL TERMOPLASTICO-SOBRE MEDIDAS PREVIA TOMA DE MOLDE-CON RECUBRIMIENTO INTERNO CON CORREAS EN REATA Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-DE APERTURA ANTERIOR O LATERAL BIVALBA (DOS PIEZAS)-AJUSTABLES-USO EN ESCOLIOSIS-FRACTURCOMPRESION TORACICA ALTA-TRAUMATISMOS Y LESIONES DE COLUMNA CERVICALBAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583551	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DE TRONCO T-L-S-O-MAS EXTENSION CERVICAL-EN MATERIAL EN TERMOPLASTICO-BIVALVADO	ORTESIS ESPINAL INTEGRAL QUE SE EXTIENDE DESDE LA PELVIS HASTA LA COLUMNA CERVICAL-TIPO CORSET CON UN COMPONENTE CERVICAL AJUSTABLE CON UNA BARBILLA QUE AYUDA A MANTENER LA ALINEACION ADECUADA DE LA CABEZA Y EL CUELLO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO-SOBRE MEDIDAS PREVIA TOMA DE MOLDE-CON RECUBRIMIENTO INTERNO CON CORREAS EN REATA Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-DE APERTURA ANTERIOR O LATERAL BIVALBA (DOS PIEZAS)-AJUSTABLES-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DEL MISMO
2583552	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CORSE T. L. S. O. UNIVALBO	ORTESIS TIPO CORSE TORACO-LUMBOSACRO (T.L.S.O)-EN TERMOPLASTICO UNIVALBO (DE UNA SOLA PIEZA) CON UNA ABERTURA EN LA PARTE DELANTERA O TRASERA-CON RECUBRIMIENTO INTERNO-ELABORADO BAJO MOLDE DE YESO-CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS LATERALES-BRINDA SOPORTE A LA COLUMNA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE

2583546	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DORSOLUMBAR SOBRE MEDIDAS-ACOLCHADO	ORTESIS DORSOLUMBAR SOBRE MEDIDAS-ACOLCHADO CON CORREAS DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-ELABORADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE BAJO MOLDE DE YESO-USO- PARA CORRECCION DE LESIONES Y DEFORMIDADES DE COLUMNA- BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583546	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS DORSOLUMBAR KNIGHT SOBREMEDIDAS	ORTESIS PASIVA TIPO CORSET DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO DE CUERO Y CORREAS AJUSTABLES-COMPUESTA POR BASE O ESTRUCTURA RIGIDA POR LA PARTE LUMBAR BAJA-POR LA PARTE ANTERIOR TRAE UNA FAJA TRANSVERSAL AJUSTABLE-OBJETIVO LA INMOVILIZACION DE LA FLEXO EXTENSION Y LA ROTACION DE LA ZONA MEDIA Y BAJA DE LA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR, Y ADEMAS BRINDA SOPORTE Y EVITA DOLOR-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS DE ESTE
2583575	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS LARGA TIPO KAFO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE BLOQUEO EN RODILLA CON ANILLO Y ESTRIBO METALICO PARA ADAPTACION A CALZADO	ORTESIS LARGA-RODILLA TOBILLO PIE-ELABORADAS BAJO MOLDE DE YESO (MEDIDAS INDIVIDUALES)- EN MATERAL TERMOPLASTICO-FORRO INTERNO Y CIERRES DE CONTACTO ADHESIVO- CON SISTEMA DE BLOQUEO EN RODILLA O CADERA CON ANILLO Y ESTRIBO METALICO PARA ADAPTACION A CALZADO-INDICADA EN. SECUELAS DE POLIOMIELITIS-PARALISIS CEREBRAL-SECUELASDE TRAUMATISMOS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

2583977	42241902	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS MUSLERA ELABORADA EN NEOPRENO	ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO (MUSLERA EN NEOPRENO) 3 mm-DISEÑO ANATOMICO-AJUSTE PRECISO-FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y AUMENTA EL CALOR LOCAL MEJORANDO LA CIRCULACION Y LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR-CONFECCIONADA EN FORMA CONICA QUE SE ADAPTA A LAS DIFERENTES CIRCUNFERENCIAS DEL MUSLO-INDICADO PARA LA PREVENCION DE DESGARROS MUSCULARES- PRINCIPALMENTE EN CUADRICEPS Y ABDUCTORES-PROMUEVE LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA-FACIL COLOCACION Y RETIRO-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
2582487	42241805	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	CODERA PARA EPICONDILITIS EN NEOPRENO	CODERA DE CODO DE TENISTA EN FORMA CIRCULAR PARA HACER PRESION EN EL VIENTRE MUSCULAR DE LOS EXTENSORES DE DEDOS Y MUÑECA-BANDA NEOPRENO PERFORADO-DISTAL AL CODO CON REFUERZOS CIRCULARES Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
2502663	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN EN TERMOPLASTICO	ORTESIS EN MATERIAL TERMOPLASTICO - DISEÑO ANATOMICO-CON FORRO INTERIOR ACOLCHADO Y TIRAS EN AIRPRENO QUE ASEGURAN UN AJUSTE COMODO Y ANATOMICO- PROTEGE-INMOVILIZA Y LIMITA EL MOVIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL DEDO PULGAR-MANTIENE EL PULGAR EN ABDUCCION-DISPONIBLE PARA MANO IZQUIERDA Y DERECHA-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

2583556	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS PERRICONE EN MATERIAL TERMOPLASTICO SEMIRIGIDO-ACOLCHADO	ORTESIS COMPUESTA POR DOS VALVAS UNA ANTERIOR Y OTRA POSTERIOR EN MATERIAL TERMOPLASTICO SEMIRIGIDO ACOLCHADO-CON VASTAGO PARA APOYO ESTERNAL-PARA EL TRATAMIENTO DE LA CIFOSIS-BAJO FORMULA MEDICA-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
2583572	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO AFO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ARTICULACION (LIBRE O DE BLOQUEO) BAJO FORMULA MEDICA	OTP EN MATERIAL TERMOPLASTICO-ORTESIS TOBILLO PIE CON SISTEMA DE ARTICULACION-LIBRE O DE BLOQUEO- EN TOBILLO POR MEDIO DE ESTRIBO METALICO PARA ADAPTACION A CALZADO A CALZADO CONVENCIONAL-BAJO FORMULA MEDICA
2583567	42241701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO AFO CORTA ARTICULADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA TOBILLO-PIE	ORTESIS CORTA ARTICULADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA TOBILLO-PIE CON ARTICULACION-SEGUN MEDIDAS INDIVIDUALES PREVIA TOMA DE MOLDE DE YESO- CON CINTAS DE CONTACTO ADHESIVO-PROTECTORES Y APOYO PATELAR ACOLCHADO-BAJO FORMULA MEDICA
2583968	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO AFO FIJO-ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO-FORRADA INTERNAMENTE-BAJO FORMULA MEDICA	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO- SEGUN MEDIDAS INDIVIDUALES PREVIA TOMA DE MOLDE-FORRADA INTERNAMENTE-CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS Y PROTECTORES-INDICADO EN PIE CAIDO- HEMIPLEJIAS-SECUELAS DE PARALISIS CEREBRAL-PARALISIS POR INYECCION GLUTEA-TRATAMIENTO POSTOPERATORIO
2583569	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO AFO DE REACCION A PISO-PARA TOBILLO-PIE EN MATERIAL TERMOFROMADO-ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO-	ORTESIS PARA TOBILLO PIE CON REACCION A PISO EN MATERIAL TERMOPLASTICO-ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO Y TALLA DEL PACIENTE- FORRADA EN CAUCHO ESPUMA- QUE LLEVE EL CUELLO DE PIE A 90°-SOPORTE EN RODILLA CON 10° DE DORSIFLEXION-CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-PARA USO CON CALZADO CONVENCIONAL-BAJO FORMULA MEDICA
2583568	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO AFO REFORZADA-EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON PREVIO MOLDE EN YESO-	ORTESIS EN MATERIAL TERMOPLASTICO-CON RECUBRIMIENTO INTERNO- CON PREVIO MOLDE EN YESO-DOBLE REFUERZO PARA TOBILLO PIE CON ARTICULACION-CIERRES DE CONTACTO ADHESIVO-BAJO FORMULA MEDICA

							PARA TOBILLO PIE CON ARTICULACION-	
2583554	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO CORSE L-S-O- MAS EXTENSION A MUSLO- EN MATERIAL TERMOPLASTICO MODIFICADO- CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS	ORTESIS L-S-O- MAS EXTENSION A MUSLO EN MATERIAL TERMOPLASTICO MODIFICADO-ELABORADA BAJO MOLDE YESO- AJUSTABLE CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-RECUBRIMIENTO INTERNO-BAJO FORMULA MEDICA
2583570	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO DAFO-FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO, CIERRES DE CONTACTO ADEHSIVOS, SOBRE MOLDE EN YESO-	ORTESIS TIPO DAFO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO FLEXIBLE QUE SE ADAPTE A LOS CONTORNOS DEL PIE-PARA TOBILLO-PIE DINAMICO Y PERMITA UN MAYOR RANGO DE MOVIMIENTO- CON CIERRES DE CONTACTO ADEHSUVOS-TOTAL Y FLEXIBLE- ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO- USO-COREGIR O CONTROLAR LAS ALTERACIONES EN LA POSICION DEL PIE DE ORIGEN NEUROMUSCULAR OPTIMIZANDO LA BIOMECANICA DE LA MARCHA-BAJO FORMULA MEDICA
2584534	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS SEGUN MEDIDAS CON SOPORTE RIGIDO, ACOLCHADA, DE USO NOCTURNO	ORTESIS QUE LLEVA HACIA LA ABDUCCION EL GRUESO ARTEJO, MANTENIENDOLO ALINEADO CON EL PRIMER METATARSIANO, CON SOPORTE RIGIDO- ELABORADO EN NEOPRENO-ACOLCHADO-CON CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO PARA BRINDAR CONFORT-FERULA LATERAL-USO NOCTURNO PARA LA CORRECCION DEL HALLUX VALGUS-BAJO FORMULA MEDICA

2583573	42241701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3		A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO HKAFO CONVENCIONAL METALICA-ORTESIS CADERA- RODILLA TOBILLO PIE-ARTICULACION DE CADERA- RODILLA Y TOBILLO BLOQUEABLES-	ORTESIS DE MARCHA MULTIFUNCION FABRICADO A MEDIDA EN MATERIAL TERMOPLASTICO DE BAJA DENSIDAD-BAJO MOLDE DE YESO-CONSTA DE CINTURON PELVICO ARTICULACION DE CADERA Y RODILLA CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSION-ADUCCION Y ABDUCCION - MUSLERA Y PANTORRILLERA TERMOMOLDEABLE Y AJUSTABLE-ESTRIBOS METALICOS PARA ADAPTACION DE CALZADO ORTOPEDICO-CUBRE EL PIE, TOBILLO, RODILLA, MUSLO, CADERA INCLUYENDO LA PELVIS-BILATERAL-USO- FRACTURAS A NIVEL PROXIMAL DEL FEMUR-PROCESOS TRAUMATICOS GRAVES DE MIEMBRO INFERIOR ENTRE OTROS-BAJO FORMULA MEDICA
2583578	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3		A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO HKAFO CON BARRAS EN ALUMINIO PARA CADERA INCLUYENDO PELVIS-MUSLO-RODILLA-TOBILLO	ORTESIS CADERA INCLUYENDO PELVIS-MUSLO- RODILLA TOBILLO PIE-ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO BAJO MOLDE DE YESO- CON BANDA PELVICA- ARTICULACION DE CADERA- RODILLA Y TOBILLO BLOQUEABLES-ESTRIBOS METALICOS PARA ADAPTACION A CALZADO ORTOPEDICO-USO BILATERAL-INCLUYE CALZADO
2583577	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3		A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO HKAFO-CADERA-RODILLA- TOBILLO PIE-ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO BAJO MOLDE DE YESO- CON BANDA PELVICA-ARTICULACION DE CADERA- RODILLA Y TOBILLO BLOQUEABLES	ORTESIS -CADERA BARRAS DE ALUMINIO-ESTRUCTURA LARGA QUE ABARCA LA CADERA- RODILLA- TOBILO Y PIE-ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON BARRAS EN ALUMINIO O ACERO BAJO MOLDE DE YESO-FORRADA INTERNAMENTE-CON CORREAS Y CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-BANDA PELVICA-ARTICULACION EN CADERA- RODILLA Y TOBILLO-BLOQUEABLES-BAJO FORMULA MEDICA

2583576	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO KAFO RODILLA-TOBILLO-PIE-CON BARRAS DE ALUMINIO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE- ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO EN MATERIAL TERMOPLASTICO-CON CORREAS DE SUJECION CON CIERRES DE CONTACTO ADEHSIVOS Y PROTECTORES ACOLCHADOS-BARRAS LATERALES EN ALUMINIO DE CONTORNO PLANO- CON ARTICULACION DE RODILLA Y CUELLO DE PIE-BAJO FORMULA MEDICA
2583592	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA CUBITO Y RADIO ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE BIVALVADO	ORTEIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE BIVALVADO PREVIO MOLDE DE YESO CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN CAUCHO ESPUMA Y ORIFICIOS DE TRANSPIRACION CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS BAJO FORMULA MEDICA
2583581	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA FEMUR ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE-ORIFICIOS TRANSPIRABLES BIVALVADO-SOBRE MEDIDAS PREVIO MOLDE DE YESO CON CORREAS AJUSTABLES CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-USO-EN LESION DE FRACTURA DE FEMUR PARA DISTRIBUCION DE CARGAS SOBRE EL TEJIDO OSEO DAÑADO-BAJO FORMULA MEDICA
2583981	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA HUMERO ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE-	ORTEIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE CON RECUBRIMIENTO INTERNO EN ESPUMA Y ORIFICIOS TRANSPIRABLES BIVALVADO ELABORADO SOBRE MEDIDAS PREVIO MOLDE DE YESO CON CORREAS AJUSTABLES O CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS BAJO FORMULA MEDICA
2583582	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO SARMIENTO PARA TIBIA ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE	ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE-CON RECUBRIMIENTO INTERNO EN ESPUMA Y ORIFICIOS TRANSPIRABLES-BIVALVADO ELABORADO SOBRE MEDIDAS PREVIO MOLDE DE YESO CON CORREAS AJUSTABLES O CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-BAJO FORMULA MEDICA-

2583555	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO SOMI MINERVA PARA COLUMNA CERVICAL EN EXTENSION-FLEXION O NEUTRALEN MATERIAL-	ORTEISIS TIPO COLLAR PARA COLUMNA CERVICAL EN EXTENSION-FLEXION O NEUTRAL FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO FLEXIBLE ACOLCHADO Y CON SISTEMA DE CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-REGULABLE EN LA ALTURA DEL CUELLO CON APOYO MENTONIANO Y APOYO OCCIPITAL CON BARRAS ANTERIORES Y POSTERIORES REGULABLES LA BASE DE SUSTENCACION QUE SE EXTIENDE SOBRE LA BASE ESCAPULAR Y PECTORAL-ELABORADO SOBRE MEDIDAS-INDICADO EN TRAUMATISMOS DE CUELLO-AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE DEBE ANEXAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS PARA EL ASEO-BAJO FORMULA MEDICA
2583571	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TIPO TRAFO-TOBILLO-PIE-EN MATERIAL TERMOPLASTICO-	ORTESIS ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO EN MATERIAL TERMOPLASTICO-FLEXIBLE-REGULADOR DE TONO-CONTACTO TOTAL-CON PUNTOS INHIBIDORES DE TONO-BAJO FORMULA MEDICA
2583508	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	ORTESIS TOBILLO PIE ARTICULADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO	ORTESIS PARA EL PIE Y LA ESTABILIZACION DEL CUELLO DE PIE-ELABORADA BAJO MOLDE DE YESO-EN MATERIAL TERMOPLASTICO CON ARTICULACIONES MONOCENTRICAS FORRADAS INTERNAMENTE CON ESPUMA HIPOALERGENICA-SUJECION MEDIANTE CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS-USOS-HIPER EXTENSION DE RODILLA-INCAPACIDAD O DEBILIDAD DE LA FLEXION PLANTAR Y/O DORSIFLEXION-FALTA DE COORDINACION Y EQUILIBRIO ENTRE OTRAS-BAJO FORMULA MEDICA
2582452	42241509	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	PANTORRILLERA-FABRICADA EN NEOPRENO SEGUN-	ORTESIS TIPO FUNDA QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA ELABORADA EN NEOPRENO-QUE PERMITE LA TRANSPIRACION-AUMENTA LA TEMPERATURA- MEJORA LA CIRCULACION Y LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR Y PROMUEVE LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL-USO-PROPORCIONAR SOPORTE DE COMPRESION - FIRMEZA-PRESION UNIFORME Y CONSTANTE-BAJO FORMULA MEDICA

2582473	42241703	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA-BAJO FORMULA MEDICA	RODILLERA FABRICADA EN NEORPENO- CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN POLIAMIDA- QUE PERMITA LA TRANSPIRACION- SOPORTE PREVENTIVO Y TERAPEUTICO- FLEXIBLE Y TERMICO- ALIVIA EL DOLOR Y ACTIVA LA CIRCULACION- DE FACIL COLOCACION Y RETIRO-REVERSIBLE-BAJO FORMULA MEDICA
2582458	42241703	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA CON ORIFICIO QUE DA COMPRESION ADICIONAL- EN NEOPRENO	RODILLERA EN MATERIAL DE NEOPRENO O SIMILARES- CON REFUERZOS LATERALES EN ESPIRAL-ORIFICIO ESPECIAL QUE PROPORCIONA COMPRESION ADICIONAL- ALREDEDOR DE LA ROTULA-DEBE BRINDAR SOPORTE EXTRA A LOS LIGAMENTOS Y CARTILAGO DEL AREA PATELAR REVERSIBLE- PARA EVITAR EL BALANCEO DE LA RODILLA- BAJO FORMULA MEDICA
2582483	42241703	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	RODILLERA ROTULA REFORZADA- ELABORADA EN NEOPRENO TRANSPIRABLE DISEÑO ANATOMICO-	RODILLERA ROTULA REFORZADA-ELABORADA EN NEOPRENO TRANSPIRABLE DISEÑOR ANATOMICO CON CAVIDAD PATELAR CIRCULAR- AJUSTABLE CON CORREAS CON CIERRES DE CONTACTO ADHESIVOS- BAJO FORMULA MEDICA
2583587	42241703	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	RODILLERA ROTULA ABIERTA- FABRICADA EN NEOPRENO- CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO-	RODILLERA FABRICADA EN NEOPRENO- CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA- PREVINIENDO EL MAL ALINEAMIENTO Y A LARGO PLAZO LA CONDROMALACIA PATELAR-BAJO FORMULA MEDICA
2582460	46182208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	SEPARADOR HALLUX VALGUS/JUANETE, ELABORADO EN SILICONA TIPO CARRETE	SEPARADOR INTERDIGITAL EN GEL POLIMERO QUE PERMITE UNA SEPARACION ADECUADA DE LOS DEDOS LO QUE AYUDA A COREGIR LA ALINEACION DEL DEDO GORDO DEL PIE- DA COMODIDAD Y ALINEACION A LOS DEDOS PARA EVITAR LA SUPERPOSICION- SEPARADOR EN FORMA CARRETE- PARTE SUPERIOR PLANA Y LISA- PARTE INFERIOR CON VACIO INTERNO-EFECTIVO PARA ALIVIAR EL DOLOR Y LA INCOMODIDAD CAUSADA POR LOS JUANETES-BAJO FORMULA MEDICA

2582848	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	TOBILLERA ABIERTA-EN NEOPRENO DE 5MM-QUE BRINDA COMPRESION TERAPEUTICA	ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE-TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO/AIRPRENO Y/O MATERIAL ELASTICO GRADO MEDICO-CON CIERRE DE CONTACTO DE GANCHO O ADHESIBLE-ABIERTO EN TALON Y DEDOS-QUE PERMITA AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO, COMPRESION TERAPEUTICA-EMPAQUE INDIVIDUAL-BAJO FORMULA MEDICA
2583586	42241706	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-3	C/U	A-02-02-01-003-006	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA, CORTA, DISEÑO ANATOMICO, ABIERTO EN LOS DEDOS	VENDAJE FLEXIBLE-FABRICADA EN NEOPRENO DE HASTA 5mm, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON- SE AJUSTA A CUALQUIER TO O-PROMUEVE LA CICATRIZACION RAPIDA DE LOS TEJIDOS BLANDOS- DA SOPORTE Y COMPRESION AL TOBILLO- DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION-BAJO FORMULA MEDICA

PROTESIS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
000001	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO MMII A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE ARTICULADO MONOAXIAL CON ADAPTADOR EN ACERO INOXIDABLE Y/0 SISTEMA DE FIJACION	PIE ARTICULADO MONOAXIAL CON ADAPTADOR EN ACERO INOXIDABLE Y/0 SISTEMA DE FIJACION
000002	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE SACH CON TORNILLO DIFERENTES LADOS Y TALLAS	PIE SACH CON TORNILLO DIFERENTES LADOS Y TALLAS
000003	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE SACH CON DEDOS CON ADAPTADOR PIRAMIDAL	PIE SACH CON DEDOS CON ADAPTADOR PIRAMIDAL
000004	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE MULTIAXIAL CON DEDOS CON ADAPTADOR	PIE MULTIAXIAL CON DEDOS CON ADAPTADOR

000005	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DINAMICO EN CARBONO PARA DESARTICULACION DE TOBILLO TIPO SYME CON CUBIERTA COSMETICA Y ADAPTADOR	PIE DINAMICO EN CARBONO PARA DESARTICULACION DE TOBILLO TIPO SYME CON CUBIERTA COSMETICA Y ADAPTADOR
000006	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DINAMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA CON ALTA RESPUESTA DINAMICA CON CUBIERTA COSMETICA Y ADAPTADOR (PERFIL NORMAL O BAJO)	PIE DINAMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA CON ALTA RESPUESTA DINAMICA CON CUBIERTA COSMETICA Y ADAPTADOR (PERFIL NORMAL O BAJO)
000007	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE CON ALTA RESPUESTA DINAMICA CON PILON EN CARBONO CON ADAPTADORES Y CUBIERTA COSMETICA	PIE CON ALTA RESPUESTA DINAMICA CON PILON EN CARBONO CON ADAPTADORES Y CUBIERTA COSMETICA
000008	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DINAMICO PARA ACTIVIDAD MODERADA CON TORNILLO Y/0 ADAPTADOR EN ACERO INOXIDABLE	PIE DINAMICO PARA ACTIVIDAD MODERADA CON TORNILLO Y/0 ADAPTADOR EN ACERO INOXIDABLE
000009	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE PEDIATRICO DINAMICO CON DEDOS	PIE PEDIATRICO DINAMICO CON DEDOS
000010	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE EN CARBONO PARA CHOPART	PIE EN CARBONO PARA CHOPART
000011	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DINÁMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA, CON ALTA RESPUESTA DINÁMICA, CON DIVISIÓN DE LA HOJA DE CARBONO	PIE DINÁMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA, CON ALTA RESPUESTA DINÁMICA, CON DIVISIÓN DE LA HOJA DE CARBONO EN EL ANTEPIÉ PARA COMPENSACIÓN EN TERRENOS IRREGULARES CON CUBIERTA COSMÉTICA Y ADAPTADOR (ALTO PERFIL)

							EN EL ANTEPIE PARA COMPENSACIÓN EN TERRENOS IRREGULARES CON CUBIERTA COSMÉTICA Y ADAPTADOR (ALTO PERFIL)	
000012	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DINÁMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA, CON ALTA RESPUESTA DINÁMICA, CON DIVISIÓN DE LA HOJA DE CARBONO EN EL ANTEPIÉ PARA COMPENSACIÓN EN TERRENOS IRREGULARES CON CUBIERTA COSMÉTICA Y ADAPTADOR (NORMAL O BAJO PERFIL)	PIE DINÁMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA, CON ALTA RESPUESTA DINÁMICA, CON DIVISIÓN DE LA HOJA DE CARBONO EN EL ANTEPIÉ PARA COMPENSACIÓN EN TERRENOS IRREGULARES CON CUBIERTA COSMÉTICA Y ADAPTADOR (NORMAL O BAJO PERFIL)
000013	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE EN FIBRA DE CARBONO PARA ATLETAS PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL (NO EL PIE CONVENCIONAL)	PIE EN FIBRA DE CARBONO PARA ATLETAS PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL (NO EL PIE CONVENCIONAL)
000014	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE EN FIBRA DE CARBONO PARA ATLETAS PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL (NO EL PIE CONVENCIONAL)	PIE EN FIBRA DE CARBONO PARA ATLETAS PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL (NO EL PIE CONVENCIONAL)
000015	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A1 PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	PIE DE ALTA ACTIVIDAD EN FIBRA DE CARBONO CON QUILLA DIVIDIDA, MECANISMOS DE TORSIÓN Y	PIE DE ALTA ACTIVIDAD EN FIBRA DE CARBONO CON QUILLA DIVIDIDA, MECANISMOS DE TORSIÓN Y AMORTIGUACIÓN, QUE INCLUYE SISTEMA DE VACÍO ACTIVO PARA SUSPENSIÓN.

							AMORTIGUACION, QUE INCLUYE SISTEMA DE VACÍO ACTIVO PARA SUSPENSIÓN.	
000016	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A2 CUBIERTAS DE PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DINAMICO EN CARBONO PARA DESARTICULACION DE TOBILLO TIPO SYME	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DINAMICO EN CARBONO PARA DESARTICULACION DE TOBILLO TIPO SYME
000017	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A2 CUBIERTAS DE PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DE ALTA RESPUESTA DINAMICA EN CARBONO	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DE ALTA RESPUESTA DINAMICA EN CARBONO
000018	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A2 CUBIERTAS DE PIES	C/U	A.02.01-01.004.008	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DE ALTA RESPUESTA DINAMICA EN CARBONO CON QUILLA DIVIDIDA	CUBIERTA COSMETICA PARA PIE DE ALTA RESPUESTA DINAMICA EN CARBONO CON QUILLA DIVIDIDA
000019	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA PROTECTORA PARA PIES EN FIBRA DE CARBONO	MEDIA PROTECTORA PARA PIES EN FIBRA DE CARBONO
000020	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MODULAR MECÁNICA DE EJE SIMPLE CON AYUDA DE EXTENSIÓN Y FRENO BAJO CARGA EN ACERO INOXIDABLE	RODILLA MODULAR MECÁNICA DE EJE SIMPLE CON AYUDA DE EXTENSIÓN Y FRENO BAJO CARGA EN ACERO INOXIDABLE
000021	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MODULAR MECÁNICA DE EJE SIMPLE GERIÁTRICA (DE SEGURIDAD O BLOQUEO) EN METAL LIGERO	RODILLA MODULAR MECÁNICA DE EJE SIMPLE GERIÁTRICA (DE SEGURIDAD O BLOQUEO) EN METAL LIGERO
000022	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MODULAR HIDRAÚLICA DE EJE SIMPLE EN METAL LIGERO	RODILLA MODULAR HIDRAÚLICA DE EJE SIMPLE EN METAL LIGERO

000023	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MODULAR MECÁNICA POLICÉNTRICA	RODILLA MODULAR MECÁNICA POLICÉNTRICA
000024	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MODULAR NEUMÁTICA POLICÉNTRICA	RODILLA MODULAR NEUMÁTICA POLICÉNTRICA
000025	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3
000026	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MONOCÉNTRICA HIDRAÚLICA CON FASE DE APOYO DINÁMICA (ACTIVACIÓN DINÁMICA)	RODILLA MONOCÉNTRICA HIDRAÚLICA CON FASE DE APOYO DINÁMICA (ACTIVACIÓN DINÁMICA)
000027	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FASE DE APOYO O FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3 (AMPUTACION DESARTICULADO DE RODILLA)	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FASE DE APOYO O FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3 (AMPUTACION DESARTICULADO DE RODILLA)
000028	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FASE DE APOYO O FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3 (AMPUTACION	RODILLA HIDRAULICA POLICENTRICA CON SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LA FASE DE APOYO O FLEXION INICIAL. GRADO DE MOVILIDAD 2,3 (AMPUTACION DESARTICULADO DE CADERA)

							DESARTICULADO DE CADERA)	
000029	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A3 RODILLAS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA MECANICA POLICENTRICA MODULAR PEDIATRICA	RODILLA MECANICA POLICENTRICA MODULAR PEDIATRICA
000030	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A4 CADERAS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE CADERA MODULAR ANTERIOR CON IMPULSOR MECÁNICO DE EXTENSIÓN (NO LA DE BANDAS)	ARTICULACIÓN DE CADERA MODULAR ANTERIOR CON IMPULSOR MECÁNICO DE EXTENSIÓN (NO LA DE BANDAS)
000031	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A4 CADERAS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE CADERA MODULAR ANTERIOR CON IMPULSOR MECÁNICO DE EXTENSIÓN PEDIATRICA	ARTICULACIÓN DE CADERA MODULAR ANTERIOR CON IMPULSOR MECÁNICO DE EXTENSIÓN PEDIATRICA
000032	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" DELGADA EN SILICONA SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" DELGADA EN SILICONA SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN
000033	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" DELGADA EN SILICONA CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" DELGADA EN SILICONA CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN
000034	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN SILICONA CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN 3 MM	FUNDA O "LINER" EN SILICONA CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN 3 MM

000035	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN SILICONA SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN SILICONA SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN
000036	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN GEL O COPOLÍMERO CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN GEL O COPOLÍMERO CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA CON UNIÓN DISTAL PARA PIN
000037	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN GEL O COPOLÍMERO CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA SIN UNIÓN DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN GEL O COPOLÍMERO CON CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACIÓN ABAJO DE RODILLA SIN UNIÓN DISTAL PARA PIN
000038	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO O COPOLIMERO GRUESO CON CUBIERTA TEXTIL DE ESPESOR NO UNIFORME PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA CON UNION DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO O COPOLIMERO GRUESO CON CUBIERTA TEXTIL DE ESPESOR NO UNIFORME PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA CON UNION DISTAL PARA PIN
000039	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO CON CUBIERTA TEXTIL DE ESPESOR NO UNIFORME PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA SIN UNION DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO CON CUBIERTA TEXTIL DE ESPESOR NO UNIFORME PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA SIN UNION DISTAL PARA PIN

000040	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA SIN UNION DISTAL PARA PIN	FUNDA O "LINER" EN POLIURETANO SIN CUBIERTA TEXTIL PARA AMPUTACION ABAJO DE RODILLA SIN UNION DISTAL PARA PIN
000041	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" PARA DESARTICULACION DE RODILLA CON CUBIERTA TEXTIL SIN UNION DISTAL PARA PIN EN SILICONA O COPOLIMERO	FUNDA O "LINER" PARA DESARTICULACION DE RODILLA CON CUBIERTA TEXTIL SIN UNION DISTAL PARA PIN EN SILICONA O COPOLIMERO
000042	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE VACÍO EN AMPUTACIÓN DEBAJO DE RODILLA	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE VACÍO EN AMPUTACIÓN DEBAJO DE RODILLA
000043	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSION POR VACIO PARA MUÑÓN DESARTICULADO DE RODILLA	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSION POR VACIO PARA MUÑÓN DESARTICULADO DE RODILLA
000044	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSION POR VACIO PARA MUÑÓN DEBAJO DE RODILLA	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSION POR VACIO PARA MUÑÓN DEBAJO DE RODILLA
000045	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR VACÍO PARA MUÑON ARRIBA DE RODILLA	FUNDA O "LINER" PARA SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR VACÍO PARA MUÑON ARRIBA DE RODILLA
000046	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O LINER PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME	FUNDA O LINER PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME

000047	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O LINER EN SILICONA, COPOLÍMERO O URETANO PARA MUÑÓN MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDAS	FUNDA O LINER EN SILICONA, COPOLÍMERO O URETANO PARA MUÑÓN MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDAS
000048	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA O LINER EN SILICONA O MATERIAL SIMILAR, CON ANILLO (INCLUIDO EN EL LINER) PARA AMPUTADO TRANSFEMORAL	FUNDA O LINER EN SILICONA O MATERIAL SIMILAR, CON ANILLO (INCLUIDO EN EL LINER) PARA AMPUTADO TRANSFEMORAL
000049	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLERA PARA SUSPENSIÓN CON SISTEMA DE VACÍO DEBAJO DE RODILLA	RODILLERA PARA SUSPENSIÓN CON SISTEMA DE VACÍO DEBAJO DE RODILLA
000050	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A5 LINERS	C/U	A.02.01-01.004.008	PROTECTOR DE RODILLERA EN MATERIAL ELÁSTICO	PROTECTOR DE RODILLERA EN MATERIAL ELÁSTICO
000051	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON DEBAJO DE RODILLA	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON DEBAJO DE RODILLA
000052	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON ARRIBA DE RODILLA	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON ARRIBA DE RODILLA
000053	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DEBAJO DE RODILLA LAMINADO EN RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DEBAJO DE RODILLA LAMINADO EN RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO

000054	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA LAMINADO EN RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACIÓN ARRIBA DE RODILLA LAMINADO EN RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO
000055	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PARA ARRIBA DE RODILLA CON PARED INTERNA BLANDA Y MARCO EXTERNO EN FIBRA CARBONO	SOCKET PARA ARRIBA DE RODILLA CON PARED INTERNA BLANDA Y MARCO EXTERNO EN FIBRA CARBONO
000056	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON TIPO SYME	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON TIPO SYME
000057	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN TIPO SYME LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN TIPO SYME LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO
000058	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON DESARTICULADO DE RODILLA	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA MUÑON DESARTICULADO DE RODILLA
000059	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DESARTICULADO DE RODILLA LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DESARTICULADO DE RODILLA LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO

000060	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA AMPUTACION DESARTICULADO DE CADERA	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA AMPUTACION DESARTICULADO DE CADERA
000061	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A6 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DE NIVEL DESARTICULADO DE CADERA LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA MUÑON AMPUTACIÓN DE NIVEL DESARTICULADO DE CADERA LAMINADO CON RESINA ACRÍLICA Y FIBRA DE CARBONO
000062	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA COSMETICA PARA PROTESIS ABAJO DE RODILLA	MEDIA COSMETICA PARA PROTESIS ABAJO DE RODILLA
000063	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA	MEDIA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA
000064	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE	ADAPTADOR PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE
000065	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO	ADAPTADOR PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO

000066	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DESPLAZABLE PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN TITANIO	ADAPTADOR DESPLAZABLE PARA TUBO CON TORNILLO DE AJUSTE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN TITANIO
000067	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE ENCAJE ROTABLE CON NÚCLEO DE AJUSTE (PIRÁMIDE) EN ACERO Y ANCLAJE PARA LAMINADO (ARAÑA) EN ACERO INOXIDABLE	ADAPTADOR DE ENCAJE ROTABLE CON NÚCLEO DE AJUSTE (PIRÁMIDE) EN ACERO Y ANCLAJE PARA LAMINADO (ARAÑA) EN ACERO INOXIDABLE
000068	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE ENCAJE ROTABLE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN ACERO Y ANCLAJE PARA LAMINADO (ARAÑA) EN ACERO INOXIDABLE	ADAPTADOR DE ENCAJE ROTABLE CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE EN ACERO Y ANCLAJE PARA LAMINADO (ARAÑA) EN ACERO INOXIDABLE
000069	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE ENCAJE CON AJUSTE DE GIRO CON 4 TORNILLOS, CON PIRÁMIDE, CON PLACA EN ACERO O TITANIO	ADAPTADOR DE ENCAJE CON AJUSTE DE GIRO CON 4 TORNILLOS, CON PIRÁMIDE, CON PLACA EN ACERO O TITANIO
000070	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE ENCAJE CON AJUSTE DE GIRO CON 4 TORNILLOS DE AJUSTE Y PLACA (RECIBIDOR PIRÁMIDE) EN ACERO O TITANIO	ADAPTADOR DE ENCAJE CON AJUSTE DE GIRO CON 4 TORNILLOS DE AJUSTE Y PLACA (RECIBIDOR PIRÁMIDE) EN ACERO O TITANIO
000071	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE DE 60 mm O LONGITUD SIMILAR EN TITANIO	ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE DE 60 mm O LONGITUD SIMILAR EN TITANIO

000072	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE DE 75 mm O LONGITUD SIMILAR EN TITANIO	ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE DE 75 mm O LONGITUD SIMILAR EN TITANIO
000073	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE CON NÚCLEO DE AJUSTE O PIRÁMIDE (RECIBIDOR Y PIRÁMIDE) EN TITANIO	ADAPTADOR DOBLE CON NÚCLEO DE AJUSTE O PIRÁMIDE (RECIBIDOR Y PIRÁMIDE) EN TITANIO
000074	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO O ACERO CON PIRÁMIDE EN CADA LADO	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO O ACERO CON PIRÁMIDE EN CADA LADO
000075	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 32mm DE LONGITUD O SIMILAR	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 32mm DE LONGITUD O SIMILAR
000076	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 45mm DE LONGITUD O SIMILAR	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 45mm DE LONGITUD O SIMILAR
000077	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 60mm DE LONGITUD O SIMILAR	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 60mm DE LONGITUD O SIMILAR

000078	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 75mm DE LONGITUD O SIMILAR	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO PARA UNIÓN ENTRE DOS PIRÁMIDES DE 75mm DE LONGITUD O SIMILAR
000079	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PIN CORTO ESTRIADO PARA SILICON LINER	PIN CORTO ESTRIADO PARA SILICON LINER
000080	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PIN LARGO ESTRIADO PARA SILICON LINER	PIN LARGO ESTRIADO PARA SILICON LINER
000081	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR PARA PIE CON PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE	ADAPTADOR PARA PIE CON PIRÁMIDE EN ACERO INOXIDABLE
000082	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TORNILLO PARA FIJACIÓN PIE CON ARANDELA Y TUERCA	TORNILLO PARA FIJACIÓN PIE CON ARANDELA Y TUERCA
000083	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO DE 200 MM O LONGITUD SIMILAR DE 30 mm DE DIÁMETRO	TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO DE 200 MM O LONGITUD SIMILAR DE 30 mm DE DIÁMETRO
000084	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO DE 400 a 440 MM O LONGITUD SIMILAR DE 30 mm DE DIÁMETRO	TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO DE 400 a 440 MM O LONGITUD SIMILAR DE 30 mm DE DIÁMETRO

000085	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	LANZADERA PARA SILICON LINER CON PIN ESTRIADO CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE (CLUTCH LOCK) CON ROSCA PARA ADAPTADOR AL SOCKET Y EL RESPECTIVO ADAPTADOR AL SOCKET EN ARAÑA CON UÑAS LARGAS.	LANZADERA PARA SILICON LINER CON PIN ESTRIADO CON RECIBIDOR PARA PIRÁMIDE (CLUTCH LOCK) CON ROSCA PARA ADAPTADOR AL SOCKET Y EL RESPECTIVO ADAPTADOR AL SOCKET EN ARAÑA CON UÑAS LARGAS.
000086	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	LANZADERA PARA SILICON LINER CON PIN ESTRIADO CON PIRÁMIDE DISTAL (CLUTCH LOCK) CON ROSCA PARA ADAPTADOR AL SOCKET Y EL RESPECTIVO ADAPTADOR AL SOCKET.	LANZADERA PARA SILICON LINER CON PIN ESTRIADO CON PIRÁMIDE DISTAL (CLUTCH LOCK) CON ROSCA PARA ADAPTADOR AL SOCKET Y EL RESPECTIVO ADAPTADOR AL SOCKET.
000087	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	REPUESTO DE UNIDAD DE BLOQUEO PARA LANZADERA (CLOTCH LOCK)	REPUESTO DE UNIDAD DE BLOQUEO PARA LANZADERA (CLOTCH LOCK)
000088	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	VALVULA DE SUCCION METÁLICA ROSCADA CON EL ANILLO CORRESPONDIENTE	VALVULA DE SUCCION METÁLICA ROSCADA CON EL ANILLO CORRESPONDIENTE
000089	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PLATINA DE REPUESTO PARA ARTICULACIÓN DE CADERA INFERIOR METAL LIGERO	PLATINA DE REPUESTO PARA ARTICULACIÓN DE CADERA INFERIOR METAL LIGERO

000090	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	FORRO COSMÉTICO PRÓTESIS MODULAR ARRIBA DE RODILLA	FORRO COSMÉTICO PRÓTESIS MODULAR ARRIBA DE RODILLA
000091	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	FORRO COSMÉTICO PRÓTESIS MODULAR DEBAJO DE RODILLA	FORRO COSMÉTICO PRÓTESIS MODULAR DEBAJO DE RODILLA
000092	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA DE NYLON O ALGODÓN SILICONADA O EN GEL PARA MUÑON DEBAJO DE RODILLA	MEDIA DE NYLON O ALGODÓN SILICONADA O EN GEL PARA MUÑON DEBAJO DE RODILLA
000093	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOPORTE DE NEOPRENO O MATERIAL SIMILAR PARA PRÓTESIS DEBAJO DE RODILLA	SOPORTE DE NEOPRENO O MATERIAL SIMILAR PARA PRÓTESIS DEBAJO DE RODILLA
000094	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOPORTE EN NEOPRENO O MATERIAL SIMILAR PARA PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA (SUSPENSORIO FEMORAL)	SOPORTE EN NEOPRENO O MATERIAL SIMILAR PARA PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA (SUSPENSORIO FEMORAL)
000095	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	BOLSA PARA COLOCAR PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA	BOLSA PARA COLOCAR PRÓTESIS ARRIBA DE RODILLA
000096	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	DISCO EN GEL O MATERILA SIMILAR DE DIFERENTES DIÁMETRSO (ENTRE 5 Y 15 CM)	DISCO EN GEL O MATERILA SIMILAR DE DIFERENTES DIÁMETRSO (ENTRE 5 Y 15 CM)
000097	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE TUBO DE 34 MM DE DIÁMETRO EN ACERO	ADAPTADOR DE TUBO DE 34 MM DE DIÁMETRO EN ACERO

000098	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	VÁLVULA DE UNA VÍA PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL	VÁLVULA DE UNA VÍA PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL
000099	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	CARGADOR Y CABLES PARA RODILLA CON MICROPROCESADOR	CARGADOR Y CABLES PARA RODILLA CON MICROPROCESADOR
000100	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	VÁLVULA DE AUTOEXPULSIÓN PARA SUSPENSIÓN DE VACÍO TRANSFEMORAL	VÁLVULA DE AUTOEXPULSIÓN PARA SUSPENSIÓN DE VACÍO TRANSFEMORAL
000101	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR ROTACIONAL PARA PRÓTESIS TRANSFEMORAL QUE PERMITA EL REPOSICIONAMIENTO O GIRO MANUAL DE LA PIERNA	ADAPTADOR ROTACIONAL PARA PRÓTESIS TRANSFEMORAL QUE PERMITA EL REPOSICIONAMIENTO O GIRO MANUAL DE LA PIERNA
000102	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE TUBO ANGULADO CON RECIBIDOR DE PIRAMIDE 10°, 20 ó 30°	ADA PTADOR DE TUBO ANGULADO CON RECIBIDOR DE PIRAMIDE 10°, 20 ó 30°
000103	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TUBO CON ADAPTADOR DE 34 MM EN ACERO O TITANIO	TUBO CON ADAPTADOR DE 34 MM EN ACERO O TITANIO
000104	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	LANZADERA PARA PRÓTESIS PARA LAMINACION (NO INCLUYE NÚCLEO DE AJUSTE)	LANZADERA PARA PRÓTESIS PARA LAMINACION (NO INCLUYE NÚCLEO DE AJUSTE)

000105	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL POR MEDIO DE LINER QUE SE ENCUENTRE ANCLADO A CORREAS O CUERDAS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL POR MEDIO DE LINER QUE SE ENCUENTRE ANCLADO A CORREAS O CUERDAS
000106	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TUBO CON ADAPTADOR DE 22 MM DE DIAMETRO	TUBO CON ADAPTADOR DE 22 MM DE DIAMETRO
000107	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR DE ENCAJE PEDIATRICO	ADAPTADOR DE ENCAJE PEDIATRICO
000108	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	BLOQUE DE UNION DE SOCKET PEDIATRICO	BLOQUE DE UNION DE SOCKET PEDIATRICO
000109	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	FORRO COSMETICO PROTESIS PEDIATRICA TRANSFEMORAL	FORRO COSMETICO PROTESIS PEDIATRICA TRANSFEMORAL
000110	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA PERLON COSMETICA PARA PROTESIS TRANSFEMORAL PEDIATRICA	MEDIA PERLON COSMETICA PARA PROTESIS TRANSFEMORAL PEDIATRICA
000111	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TUBO CON ADAPTADOR DE TUBO ANGULADO DE 22MM DE DIAMETRO	TUBO CON ADAPTADOR DE TUBO ANGULADO DE 22MM DE DIAMETRO

000112	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ADAPTADOR ENCAJE CON PIRAMIDE PARA LAMINACION	ADAPTADOR ENCAJE CON PIRAMIDE PARA LAMINACION
000113	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA EN ALGODÓN PARA MUÑON	MEDIA EN ALGODÓN PARA MUÑON
000114	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE RODILLA DEPORTIVA	ARTICULACION DE RODILLA DEPORTIVA
000115	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SET DE REPUESTO DE CORREAS O CUERDAS PARA SISTEMA DE SUSPENSION	SET DE REPUESTO DE CORREAS O CUERDAS PARA SISTEMA DE SUSPENSION
000116	42242001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A7 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR BOMBA DE VACÍO DINÁMICO O VACIO AUMENTADO SIN PIN	SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR BOMBA DE VACÍO DINÁMICO O VACIO AUMENTADO SIN PIN
000117	42311505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 3 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 3 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS
000118	42311505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 4 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 4 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS

000119	42311505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 5 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS	MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 5 PULGADAS EN ROLLOS X 25 MTS
000120	13102022	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 3mm ,1X2 MTS	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 3mm ,1X2 MTS
000121	13102022	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 4mm ,1X2 MTS	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 4mm ,1X2 MTS
000122	13102022	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 5mm, 1X2 MTS	LAMINAS DE POLIPROPILENO NO RECICLADAS DE 5mm, 1X2 MTS
000123	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 3mm ,1X2 MTS	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 3mm ,1X2 MTS
000124	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 4mm ,1X2 MTS	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 4mm ,1X2 MTS
000125	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 5mm ,1X2 MTS	LAMINAS POLIETILENO NO RECICLADAS DE 5mm ,1X2 MTS

000126	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA PLASTAZOTE DE 10mm DE 90X90 CM COLOR PIEL (ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)	LAMINA PLASTAZOTE DE 10mm DE 90X90 CM COLOR PIEL (ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)
000127	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA PLASTAZOTE DE 5mm DE 90X90 CM COLOR PIEL (ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)	LAMINA PLASTAZOTE DE 5mm DE 90X90 CM COLOR PIEL (ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)
000128	13102017	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA DE PELITE (ESPUMA TERMOPLASTICA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAJO PESO, "CLOSED CELL") DE ALTA DENSIDAD DE 5mm DE 90X90 CM	LAMINA DE PELITE (ESPUMA TERMOPLASTICA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAJO PESO, "CLOSED CELL") DE ALTA DENSIDAD DE 5mm DE 90X90 CM
000129	31201635	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILOS	A.02.01-01.004.008	POLIURETANO ESTRUCTURAL RIGIDO (COMPONENTE A ISOCIANATO)	POLIURETANO ESTRUCTURAL RIGIDO (COMPONENTE A ISOCIANATO)
000130	31201635	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILOS	A.02.01-01.004.008	POLIURETANO ESTRUCTURAL RIGIDO POLIOL DENSIDAD ALTA (COMPONENTE B)	POLIURETANO ESTRUCTURAL RIGIDO POLIOL DENSIDAD ALTA (COMPONENTE B)
000131	31201635	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILOS	A.02.01-01.004.008	POLIURETANO ESTRUCTURAL (COMPONENTE B) DENSIDAD BAJA	POLIURETANO ESTRUCTURAL (COMPONENTE B) DENSIDAD BAJA

000132	13111018	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILOS	A.02.01-01.004.008	RESINA RIGIDA BISFENOLA X 0.9 KG (RESINA PARA LAMINAR FIBRA DE CARBONO	RESINA RIGIDA BISFENOLA X 0.9 KG (RESINA PARA LAMINAR FIBRA DE CARBONO
000133	13101906	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILO	A.02.01-01.004.008	RESINA POLIAMIDA ALIFATICA X 0.9 KILOS (ENDURECEDOR)	RESINA POLIAMIDA ALIFATICA X 0.9 KILOS (ENDURECEDOR)
000134	13111003	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILO	A.02.01-01.004.008	RESINA PALATAL POLIESTER	RESINA PALATAL POLIESTER
000135	12352304	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILO	A.02.01-01.004.008	MECK PEROXIDO (PEROXIDO DE METIL ETIL CETONA)	MECK PEROXIDO (PEROXIDO DE METIL ETIL CETONA)
000136	11162115	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	METRO	A.02.01-01.004.008	FIBRA DE CARBONO TUBULAR PARA REFUERZO AXIAL DEL SOCKET X METROS DE 5"	FIBRA DE CARBONO TUBULAR PARA REFUERZO AXIAL DEL SOCKET X METROS DE 5"
000137	11162115	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	METRO	A.02.01-01.004.008	FIBRA DE CARBONO EN MANTO X METROS	FIBRA DE CARBONO EN MANTO X METROS
000138	11151517	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	PAPEL POLIVINIL ALCOHOL (PVA) EN ROLLO X 50 MT	PAPEL POLIVINIL ALCOHOL (PVA) EN ROLLO X 50 MT

000139	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE BLANDA 10 MM	LAMINA TERMOFORMABLE BLANDA 10 MM
000140	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE RÍGIDA DE 10 MM	LAMINA TERMOFORMABLE RÍGIDA DE 10 MM
000141	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE RÍGIDA DE 12 MM	LAMINA TERMOFORMABLE RÍGIDA DE 12 MM
000142	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE FLEXIBLE DE 12 MM	LAMINA TERMOFORMABLE FLEXIBLE DE 12 MM
000143	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE FLEXIBLE DE 15 MM	LAMINA TERMOFORMABLE FLEXIBLE DE 15 MM
000144	12170000	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	PIGMENTO PARA RESINA DE LAMINACION COLOR PIEL	PIGMENTO PARA RESINA DE LAMINACION COLOR PIEL
000145	12170000	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	PIGMENTO PARA RESINA DELAMINACION COLOR MARRON	PIGMENTO PARA RESINA DELAMINACION COLOR MARRON
000146	11162114	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	METRO	A.02.01-01.004.008	CINTA DACRON DE 1"	CINTA DACRON DE 1"

000147	13111005	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KILOS	A.02.01-01.004.008	RESINA ACRILICA (METILMETACRILATO) COLA	RESINA ACRILICA (METILMETACRILATO) COLA
000148	30111701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	BULTO	A.02.01-01.004.008	YESO EN POLVO DE PRIMERA EN BULTOS DE 25 KG	YESO EN POLVO DE PRIMERA EN BULTOS DE 25 KG
000149	11162401	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	MTS	A.02.01-01.004.008	GUATA EN METROS (MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO, FABRICADO CON FILAMENTOS DE ALGODÓN)	GUATA EN METROS (MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO, FABRICADO CON FILAMENTOS DE ALGODÓN)
000150	42143605	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HEBILLAS METÁLICAS, DE UNA PULGADA	HEBILLAS METÁLICAS, DE UNA PULGADA
000151	42143605	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HEBILLAS PLÁSTICAS BLANCAS DE UNA PULGADA	HEBILLAS PLÁSTICAS BLANCAS DE UNA PULGADA
000152	31151903	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	MT	A.02.01-01.004.008	REATA DE 1 " POR MT BLANCA DE NYLON	REATA DE 1 " POR MT BLANCA DE NYLON
000153	31151903	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	MT	A.02.01-01.004.008	REATA DE 2 "POR MT BLANCA DE NYLON	REATA DE 2 "POR MT BLANCA DE NYLON
000154	11162114	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	VELCRO DE 1 PULGADA X 25 MT BLANCO	VELCRO DE 1 PULGADA X 25 MT BLANCO
000155	11162114	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	VELCRO DE 2 PULGADAS X 25 MT BLANCO	VELCRO DE 2 PULGADAS X 25 MT BLANCO

000156	13102003	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA FANTASIA 4 mm DE ESPESOR 90 X 120 COLORES SURTIDOS (POLIMERO TERMOPLASTICO EN EVA, ESPUMOSO-FOAMY)	LAMINA FANTASIA 4 mm DE ESPESOR 90 X 120 COLORES SURTIDOS (POLIMERO TERMOPLASTICO EN EVA, ESPUMOSO-FOAMY)
000157	11131504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	MTS	A.02.01-01.004.008	CORDOBAN BLANCO EN METROS	CORDOBAN BLANCO EN METROS
000158	11131504	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CUERO CARNAZA EN PIEZA	CUERO CARNAZA EN PIEZA
000159	13102003	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	BADANA EN PIEZA X PIES	BADANA EN PIEZA X PIES
000160	31201502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	PROWAIRE EN LAMINAS, ESPESOR DE 2mm, DE 1,20 POR 90 CMS (LAMINA SINTETICA PERFORADA PARA ACOLCHADO)	PROWAIRE EN LAMINAS, ESPESOR DE 2mm, DE 1,20 POR 90 CMS (LAMINA SINTETICA PERFORADA PARA ACOLCHADO)
000161	31201503	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA AISLANTE ROLLOS DE 3/4 DE PULGA X MTS	CINTA AISLANTE ROLLOS DE 3/4 DE PULGA X MTS
000162	31201503	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA, EN ROLLOS X 40 MTS	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA, EN ROLLOS X 40 MTS
000163	27111508	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" PULGADAS, EN ROLLOS X 40 MTS	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" PULGADAS, EN ROLLOS X 40 MTS

000164	27111508	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CUCHILLAS PARA CALADORA PARA MADERA	CUCHILLAS PARA CALADORA PARA MADERA
000165	27111508	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CUCHILLAS PARA CALADORA PARA METAL	HILLAS PARA CALADORA PARA METAL
000166	27112739	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CUCHILLAS PARA CALADORAS PARA, PLÁSTICOS	CUCHILLAS PARA CALADORAS PARA, PLÁSTICOS
000167	27112738	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	BANDA LIJA PARA MAQUINA PULIDORA, GRANO 36	BANDA LIJA PARA MAQUINA PULIDORA, GRANO 36
000168	31201610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	ROLLO DE LIJA GRANO 36 DE 6 PULGADAS DE ANCHO, POR 25 METROS	ROLLO DE LIJA GRANO 36 DE 6 PULGADAS DE ANCHO, POR 25 METROS
000169	31162215	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	GALON	A.02.01-01.004.008	PEGANTE MULTIUSOS (ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO) EN GALONES	PEGANTE MULTIUSOS (ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO) EN GALONES
000170	31162215	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHES TUBULARES N: 10	REMACHES TUBULARES N: 10
000171	31162215	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHES TUBULARES N: 12	REMACHES TUBULARES N: 12
000172	31162204	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHE TUBULAR N 8	REMACHE TUBULAR N 8

000173	31162204	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHES DE ALUMINIO DE 5/32 X 1 PULGADA CABEZA PLANA	REMACHES DE ALUMINIO DE 5/32 X 1 PULGADA CABEZA PLANA
000174	31162204	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHES CON ARANDELA DE COBRE DE 3/16 X 1 PULGADA	REMACHES CON ARANDELA DE COBRE DE 3/16 X 1 PULGADA
000175	31201610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REMACHES CON ARANDELA DE COBRE DE 5/32 X 3/4	REMACHES CON ARANDELA DE COBRE DE 5/32 X 3/4
000176	31161534	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	FCO	A.02.01-01.004.008	SELLADOR DE TORNILLOS (LOCTITE) FRASCO DE 50 ml 1,69 OZ	SELLADOR DE TORNILLOS (LOCTITE) FRASCO DE 50 ml 1,69 OZ
000177	31161701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	TORNILLO 5/8 ROSCA COMPLETA	TORNILLO 5/8 ROSCA COMPLETA
000178	11101518	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	TUERCA 5/8	TUERCA 5/8
000179	27111552	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	kg	A.02.01-01.004.008	TALCO INDUSTRIAL POR KILOS	TALCO INDUSTRIAL POR KILOS
000180	60121519	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HOJAS PARA SEGUETA PARA METAL 18Tx12"	HOJAS PARA SEGUETA PARA METAL 18Tx12"
000181	27112309	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAPIZ DE CERA	LAPIZ DE CERA

000182	73181112	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAPIZ DE TINTA INDELEBLE	LAPIZ DE TINTA INDELEBLE
000183	31201505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	m	A.02.01-01.004.008	TELA DE TEFLON AMERICANO DE 4 MICRAS DE ESPESOR	TELA DE TEFLON AMERICANO DE 4 MICRAS DE ESPESOR
000184	44121634	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA DOBLE FAZ MEDIA PULGADA	CINTA DOBLE FAZ MEDIA PULGADA
000185	15121514	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE MEDIA PULGADA, ROLLO POR 20 MTRS	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE MEDIA PULGADA, ROLLO POR 20 MTRS
000186	31161507	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	OZ	A.02.01-01.004.008	SILICONA EN SPRAY (LUBRICANTE)	SILICONA EN SPRAY (LUBRICANTE)
000187	39121435	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	TORNILLO GOLOSO RISA 4 X 1/4	TORNILLO GOLOSO RISA 4 X 1/4
000188	15121902	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HILO BLANCO N. 40, EN CONO POR 5000M.	HILO BLANCO N. 40, EN CONO POR 5000M.
000189	48102109	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	VASELINA, KILOS	VASELINA, KILOS
000190	31161513	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	MTS	A.02.01-01.004.008	ENVOLTURA AUTOADHERENTE, PLASTICA TRANSPARENTE ROLLO	ENVOLTURA AUTOADHERENTE, PLASTICA TRANSPARENTE ROLLO

000191	15121501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	TORNILLO 3/16 CABEZA PLANA CON TUERCA	TORNILLO 3/16 CABEZA PLANA CON TUERCA
000192	53131608	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	GALON	A.02.01-01.004.008	ACEITE PARA MANTENIMIENTO ALTA EFICIENCIA, GALON	ACEITE PARA MANTENIMIENTO ALTA EFICIENCIA, GALON
000193	11162111	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	JABON EN POLVO, KILO	JABON EN POLVO, KILO
000194	27111909	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	m	A.02.01-01.004.008	MALLA ANGEO	MALLA ANGEO
000195	53102403	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	ESCOFINAS PARA YESO	ESCOFINAS PARA YESO
000196	27111907	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	MEDIA VELADA COMPLETA POR KG	MEDIA VELADA COMPLETA POR KG
000197	31161801	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	GRATA PARA ESMERIL	GRATA PARA ESMERIL
000198	31161801	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	ARANDELAS DE ALUMINIO 3/16"	ARANDELAS DE ALUMINIO 3/16"
000199	11162114	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	KG	A.02.01-01.004.008	ARANDELAS DE ALUMINIO 5/32"	ARANDELAS DE ALUMINIO 5/32"

000200	30265802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	VENDAS ACRILICAS DE 3 PULGADAS	VENDAS ACRILICAS DE 3 PULGADAS
000201	11162124	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LAMINA TERMOFORMABLE RIGIDA DE 15mm DE 40cm X 40cm	LAMINA TERMOFORMABLE RIGIDA DE 15mm DE 40cm X 40cm
000202	31201610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	FIBRA DE CARBONO UNIDIRECCIONAL DE 5cm DE ANCHO X 5m DE LONGITUD	FIBRA DE CARBONO UNIDIRECCIONAL DE 5cm DE ANCHO X 5m DE LONGITUD
000203	44121634	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	PEGANTE ADHESIVO MULTIPROPOSITO EN SPRAY POR 305 GRAMOS	PEGANTE ADHESIVO MULTIPROPOSITO EN SPRAY POR 305 GRAMOS
000204	11162115	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	ROLLO	A.02.01-01.004.008	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS, ROLLO POR 20 MTRS	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS, ROLLO POR 20 MTRS
000205	12170000	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	METRO	A.02.01-01.004.008	FIBRA DE CARBONO TUBULAR PARA REFUERZO AXIAL DEL SOCKET POR METRO DE 8" PARA PROTESIS TRANSFEMORAL	FIBRA DE CARBONO TUBULAR PARA REFUERZO AXIAL DEL SOCKET POR METRO DE 8" PARA PROTESIS TRANSFEMORAL
000206	27112802	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	PIGMENTOS PARA LAMINACION MULTIPLES COLORES ALTA LUMINOCIDAD	PIGMENTOS PARA LAMINACION MULTIPLES COLORES ALTA LUMINOCIDAD
000207	12352310	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HOJA PARA SIERRA SIN FIN	HOJA PARA SIERRA SIN FIN

000208	15121514	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE X 280 ml	SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE X 280 ml
000209	31201610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY 382 ml	LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY 382 ml
000210	41104210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	PEGANTE SOLUCION CORRIENTE X 3785 CM	PEGANTE SOLUCION CORRIENTE X 3785 CM
000211	23121612	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	THINER COMUN X 3750 CM3	THINER COMUN X 3750 CM3
000212	27112738	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER No 18 (110) SINGER	AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER No 18 (110) SINGER
000213	27112738	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LIJA DE AGUA 9" X 11" # 150, # 180, #200 Y #220	LIJA DE AGUA 9" X 11" # 150, # 180, #200 Y #220
000214	27112738	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	REPUESTO DE LIJA PARA LIJADOR CERRADO No 40, No 60, No 80	REPUESTO DE LIJA PARA LIJADOR CERRADO No 40, No 60, No 80
000215	23131505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	BASE PARA REPUESTO DE LIJA (LIJADOR CERRADO) No 40, No 60, No 80	BASE PARA REPUESTO DE LIJA (LIJADOR CERRADO) No 40, No 60, No 80

000216	23131505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CABEZAL CONICO PARA PULIDO DE SILICONA ROSCA 5/8"	CABEZAL CONICO PARA PULIDO DE SILICONA ROSCA 5/8"
000217	42143605	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CABEZAL CONICO PARA PULIDO DE METAL ROSCA 5/8"	CABEZAL CONICO PARA PULIDO DE METAL ROSCA 5/8"
000218	20121128	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HEBILLA METALICA DE 2"	HEBILLA METALICA DE 2"
000219	31201517	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LLAVE PARA TORQUIMETRO HEXAGONAL No 4	LLAVE PARA TORQUIMETRO HEXAGONAL No 4
000220	27111508	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CINTA PLASTICA PARA LA HERMETIZACION, RELLENO Y PROTECCION DURANTE EL PROCESO DE LAMINADO	CINTA PLASTICA PARA LA HERMETIZACION, RELLENO Y PROTECCION DURANTE EL PROCESO DE LAMINADO
000221	27111537	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	HOJA DE SIERRA PARA SIERRA OSILANTE	HOJA DE SIERRA PARA SIERRA OSILANTE
000222	23131505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	BROCA PARA MADERA DE DIAMETRO 13/32, 5/16, 21/64, 3/16, 11/64, 17/64 mm	BROCA PARA MADERA DE DIAMETRO 13/32, 5/16, 21/64, 3/16, 11/64, 17/64 mm

000223	27111710	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	PIEDRA PARA ESMERIL CERAMICA 6 3/4"	PIEDRA PARA ESMERIL CERAMICA 6 3/4"
000224	44121618	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	LLAVES HEXAGONAL EN (T) DE 4 mm	LLAVES HEXAGONAL EN (T) DE 4 mm
000225	60121505	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	TIJERA PARA SASTRE INDUSTRIALES	TIJERA PARA SASTRE INDUSTRIALES
000226	27111907	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	MARCADOR FINO DE COLORES PUNTA FINA	MARCADOR FINO DE COLORES PUNTA FINA
000227	27111901	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CEPILLOS DE ALAMBRE	CEPILLOS DE ALAMBRE
000228	27111909	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CORTAFRIO	CORTAFRIO
000229	27111911	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	ESPATULA	ESPATULA

000230	27111701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	FORMONES	FORMONES
000231	27111913	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	DESTORNILLADORES	DESTORNILLADORES
000232	23242101	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	SACAVOCADOS DE GOLPE CIRCULO DE 2,4,6,8, ó,10 mm	SACAVOCADOS DE GOLPE CIRCULO DE 2,4,6,8, ó,10 mm
000233	40141735	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	CORTADOR DE TUBO CAPACIDAD DE 2" A 4"	CORTADOR DE TUBO CAPACIDAD DE 2" A 4"
000234	41121803	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	EMBUDOS METALICOS CAPACIDAD DE 500 A 1000 cc	EMBUDOS METALICOS CAPACIDAD DE 500 A 1000 cc
000235	40142002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	VASO DOSIFICADOR PLASTICO CON MEDIDAS HASTA 500 CC	VASO DOSIFICADOR PLASTICO CON MEDIDAS HASTA 500 CC
000236	40142002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO A8 MATERIAL D E CONSUMO	C/U	A.02.01-01.004.008	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO CON 2 CONECTORES HEMBRA BSP1/4". DIMENTRO INTERNO 6mm, DIAMETRO EXTERNO 8mm. PRESION MAXIMA 10 BAR	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO CON 2 CONECTORES HEMBRA BSP1/4". DIMENTRO INTERNO 6mm, DIAMETRO EXTERNO 8mm. PRESION MAXIMA 10 BAR DIMENSIONES 6,5X6,5 X 44 cm LARGO 10mts.

							DIMENSIONES 6,5X6,5 X 44 cm LARGO 10mts.	
000237	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO MMSS B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACION DEBAJO DE CODO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACION DEBAJO DE CODO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO
000238	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA AMPUTACION DEBAJO DE CODO	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA AMPUTACION DEBAJO DE CODO
000239	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA DESARTICULADO DE MUÑECA	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMOPLASTICO PARA DESARTICULADO DE MUÑECA
000240	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMO PLASTICO PARA AMPUTACION TRANSHUMERAL	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMO PLASTICO PARA AMPUTACION TRANSHUMERAL
000241	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMO PLASTICO PARA DESARTICULADO DE HOMBRO	SOCKET PROVISIONAL EN MATERIAL TERMO PLASTICO PARA DESARTICULADO DE HOMBRO
000242	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA DESARTICULADO DE MUÑECA LAMINADO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARNONO	SOCKET DEFINITIVO PARA DESARTICULADO DE MUÑECA LAMINADO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARNONO
000243	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACION TRANSHUMERAL LAMINADO EN	SOCKET DEFINITIVO PARA AMPUTACION TRANSHUMERAL LAMINADO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO

							RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO	
000244	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B1 SOCKETS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOCKET DEFINITIVO PARA DESARTICULADO DE HOMBRO LAMINADO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO	SOCKET DEFINITIVO PARA DESARTICULADO DE HOMBRO LAMINADO EN RESINA ACRILICA Y FIBRA DE CARBONO
000245	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	GANCHO PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR PARA ADULTO, DERECHO O IZQUIERDO EN ACERO	GANCHO PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR PARA ADULTO, DERECHO O IZQUIERDO EN ACERO
000246	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	GANCHO PARA PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR PARA NIÑO, DERECHO O IZQUIERDO	GANCHO PARA PROTESIS MIEMBRO SUPERIOR PARA NIÑO, DERECHO O IZQUIERDO
000247	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	MANO FUNCIONAL, APERTURA VOLUNTARIA TIRO DE ACERO	MANO FUNCIONAL, APERTURA VOLUNTARIA TIRO DE ACERO
000248	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	MANO PASIVA (COSMETICA) PARA ADULTO	MANO PASIVA (COSMETICA) PARA ADULTO
000249	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	MANO PASIVA (COSMETICA) PARA NIÑO	MANO PASIVA (COSMETICA) PARA NIÑO

000250	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	GANCHO PARA PROTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR ADULTO, PARA TRABAJO PESADO EN ACERO	GANCHO PARA PROTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR ADULTO, PARA TRABAJO PESADO EN ACERO
000251	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	MANO MIOELECTRICA PARA AMPUTACION TRANSRADIAL O TRANSHUMERAL CON CONECTORES Y CABLES	MANO MIOELECTRICA PARA AMPUTACION TRANSRADIAL O TRANSHUMERAL CON CONECTORES Y CABLES
000252	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B2 DISPOSITIVOS TERMINALES	C/U	A.02.01-01.004.008	MANO MIOELECTRICA PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON CONECTORES Y CABLES	MANO MIOELECTRICA PARA DESARTICULADO DE MUÑECA CON CONECTORES Y CABLES
000253	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	MEDIA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR	MEDIA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR
000254	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	GUANTE COSMÉTICO PARA MANO MIOELÉCTRICA	GUANTE COSMÉTICO PARA MANO MIOELÉCTRICA
000255	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	BATERIA RECARGABLE DE ALTA DURACIÓN PARA MANO Y/O CODO MIOELECTRICA	BATERIA RECARGABLE DE ALTA DURACIÓN PARA MANO Y/O CODO MIOELECTRICA
000256	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	CARGADOR Y ACCESORIOS PARA RECARGA DE BATERIAS	CARGADOR Y ACCESORIOS PARA RECARGA DE BATERIAS

000257	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	JUEGO DE ELECTRODOS PARA PRÓTESIS MIOELÉCTRICA CON DUMMIES	JUEGO DE ELECTRODOS PARA PRÓTESIS MIOELÉCTRICA CON DUMMIES
000258	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	UNIDAD ELÉCTRICA DE ROTACIÓN DE MUÑECA	UNIDAD ELÉCTRICA DE ROTACIÓN DE MUÑECA
000259	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	GUANTE COSMÉTICO PARA MANO PROTESICA	GUANTE COSMÉTICO PARA MANO PROTESICA
000260	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARNES CON SISTEMA DE TIRO DE ACERO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR CONVENCIONAL DEBAJO DE CODO	ARNES CON SISTEMA DE TIRO DE ACERO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR CONVENCIONAL DEBAJO DE CODO
000261	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARNES CON SISTEMA DE TIRO DE ACERO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR CONVENCIONAL ARRIBA DE CODO	ARNES CON SISTEMA DE TIRO DE ACERO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR CONVENCIONAL ARRIBA DE CODO
000262	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ANTEBRAZO PREFABRICADO	ANTEBRAZO PREFABRICADO

000263	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE FRICCION	ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE FRICCION
000264	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTCULACIÓN DE MUÑECA ANGOSTA PARA AMPUTACIÓN TRANSRADIAL LARGA O DESARTICULACIÓN DE MUÑECA CON PLATINA DE UNION PARA MANO Y GANCHO	ARTCULACIÓN DE MUÑECA ANGOSTA PARA AMPUTACIÓN TRANSRADIAL LARGA O DESARTICULACIÓN DE MUÑECA CON PLATINA DE UNION PARA MANO Y GANCHO
000265	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACIÓN DE MUÑECA CON PLATINA DE UNIÓN PARA MANO Y PARA GANCHO CON INSERTOS PARA DESCONEXIÓN	ARTICULACIÓN DE MUÑECA CON PLATINA DE UNIÓN PARA MANO Y PARA GANCHO CON INSERTOS PARA DESCONEXIÓN
000266	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACIÓN DE MUÑECA CON MECANISMO PARA FLEXIÓN	ARTICULACIÓN DE MUÑECA CON MECANISMO PARA FLEXIÓN
000267	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ROLLO DE CINTA DE ARNES DE 1" x 25 MTS COLOR BLANCO	ROLLO DE CINTA DE ARNES DE 1" x 25 MTS COLOR BLANCO
000268	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ROLLO DE CINTA DE ARNES DE 1/2" X 25 METROS COLOR BLANCO	ROLLO DE CINTA DE ARNES DE 1/2" X 25 METROS COLOR BLANCO

000269	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	BOLSA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR	BOLSA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR
000270	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	CABLE DE TRACCION ACERO	CABLE DE TRACCION ACERO
000271	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE MUÑECA 12 POSICIONES	ARTICULACION DE MUÑECA 12 POSICIONES
000272	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PIEZA DE ENGANCGE DE MANO O GANCHO CON ROSCA INTERNA	PIEZA DE ENGANCGE DE MANO O GANCHO CON ROSCA INTERNA
000273	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	CODO PARA PROTESIS ACCIONADAS POR TRACCION CON BLOQUEO INTERIOR CON SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FLEXION	CODO PARA PROTESIS ACCIONADAS POR TRACCION CON BLOQUEO INTERIOR CON SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FLEXION
000274	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ANILLO DE LAMINADO PARA MANO MIOELECTRICACON DUMMIE	ANILLO DE LAMINADO PARA MANO MIOELECTRICACON DUMMIE

000275	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	CODO ELECTRONICO	CODO ELECTRONICO
000276	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PIEZA CONEXION PARA MANO O GANCHO	PIEZA CONEXION PARA MANO O GANCHO
000277	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ANILLO O HEBILLA GUIA	ANILLO O HEBILLA GUIA
000278	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TERMINAL DE BOLA TRIPLE CON GRUMETE	TERMINAL DE BOLA TRIPLE CON GRUMETE
000279	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	FERRULES PARA CABLE	FERRULES PARA CABLE
000280	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	FUNDA PARA HOUSING	FUNDA PARA HOUSING
000281	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	HOUSING	HOUSING
000282	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	HANGER DE 1/16"	HANGER DE 1/16"

000283	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	RECIBIDOR DE BOLA CON TAPA 1/16"	RECIBIDOR DE BOLA CON TAPA 1/16"
000284	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	TERMINAL DE BOLA SIMPLE 1/16"	TERMINAL DE BOLA SIMPLE 1/16"
000285	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARGOLLA PARA ARNES	ARGOLLA PARA ARNES
000286	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	RETENEDOR CON PLATINA	RETENEDOR CON PLATINA
000287	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	HEBILLA DE CUATRO BARRAS PARA ARNES	HEBILLA DE CUATRO BARRAS PARA ARNES
000288	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	PROTECTOR AXILAR PLASTICO	PROTECTOR AXILAR PLASTICO
000289	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	SOPORTE TRICIPITAL (COFIA)	SOPORTE TRICIPITAL (COFIA)

000290	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE HOMBRO PARA PROTESIS CONVENCIONAL	ARTICULACION DE HOMBRO PARA PROTESIS CONVENCIONAL
000291	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE HOMBRO PARA PROTESIS MODULAR PASIVA	ARTICULACION DE HOMBRO PARA PROTESIS MODULAR PASIVA
000292	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	COMPONENTE MODULAR DE BRAZO O ANTEBRAZO PASIVO PARA AMPUTADO TRANSHUMERAL	COMPONENTE MODULAR DE BRAZO O ANTEBRAZO PASIVO PARA AMPUTADO TRANSHUMERAL
000293	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	UNIDAD DE MUÑECA MODULAR PARA MANO PASIVA	UNIDAD DE MUÑECA MODULAR PARA MANO PASIVA
000294	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	UNIDAD DE MUÑECA CONVENCIONAL PARA MANO PASIVA	UNIDAD DE MUÑECA CONVENCIONAL PARA MANO PASIVA
000295	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ARTICULACION DE CODO MODULAR CON BLOQUEO PASIVO	ARTICULACION DE CODO MODULAR CON BLOQUEO PASIVO
000296	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	ESPUMA COSMETICA PARA AMPUTADO DE MIEMBRO SUPERIOR	ESPUMA COSMETICA PARA AMPUTADO DE MIEMBRO SUPERIOR

000297	42242002	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO B3 OTROS COMPONENTES PROTESICOS	C/U	A.02.01-01.004.008	UNIDAD DE MUÑECA PARA MANO MIOELECTRICA	UNIDAD DE MUÑECA PARA MANO MIOELECTRICA
000298	42241001	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-4 SUBGRUPO GRUPO C-OTROS COMPONENTES PROTESICOSR ODILLA HIDRÁULICA CON MICROPROCES ADOR	C/U	A.02.01-01.004.008	RODILLA HIDRAULICA CON MICROPROCESADO R Y CONTROL ELECTRÓNICO EN LA FASE DE APOYO Y BALANCEO CON SENSORES DE VELOCIDAD Y CAMBIOS ANGULARES PARA NIVEL DE ACTIVIDAD 3.	RODILLA HIDRAULICA CON MICROPROCESADOR Y CONTROL ELECTRÓNICO EN LA FASE DE APOYO Y BALANCEO CON SENSORES DE VELOCIDAD Y CAMBIOS ANGULARES PARA NIVEL DE ACTIVIDAD 3.

PROTESIS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2583632	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	AUMENTO POR TACON DE TORQUE	AUMENTO POR TACON DE TORQUE EXTERNO AL CALZADO QUE PERMITA LA CORRECCION DE LA TORSION TIBIAL-BAJO FORMULA MEDICA
2583629	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO ORTOPEDICO DEL 17 AL 25-PAR	ELABORADOS EN CUERO-PEGADOS Y COCIDOS-DISPONIBILIDAD EN DIFERENTES TALLAS-MODELOS Y COLORES-BAJO FORMULA MEDICA
2583630	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO ORTOPEDICO DEL 36 AL 42-PAR	ELABORADOS EN CUERO-PEGADOS Y COCIDOS-DISPONIBILIDAD EN DIFERENTES TALLAS-MODELOS Y COLORES-BAJO FORMULA MEDICA
2583633	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO ORTOPEDICO DEL 26 AL 30-PAR	ELABORADOS EN CUERO-PEGADOS Y COCIDOS-DISPONIBILIDAD EN DIFERENTES TALLAS-MODELOS Y COLORES-BAJO FORMULA MEDICA

2583634	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO ORTOPEDICO DEL 31 AL 35-PAR	ELABORADOS EN CUERO-PEGADOS Y COCIDOS-DISPONIBILIDAD EN DIFERENTES TALLAS-MODELOS Y COLORES-BAJO FORMULA MEDICA
2583560	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO PARA PIE ARTRITICO-ANESTESICO-TRAUMATICO-EQUINO O CHAPIN-PAR	CALZADO INDICADO EN DEFORMACIONES DEL PIE Y/O ARTRITIS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS-1. ACORDONADO O CON CINTAS ADHESIVAS DE CONTACTO-2. CON APERTURA AMPLIA PARA INTRODUCIR EL PIE COMODAMENTE-3. SUELAS DE MATERIAL FLEXIBLE Y AMORTIGUADORES SI SE NECESITAN-4. ZAPATO ADAPTABLE A CUALQUIER ALTERACION ESTRUCTURAL O BIOMECANICA DEL PIE-5. LOS MATERIALES DEBEN SER DE CALIDAD-FLEXIBLES-ACOLCHADOS Y TRANSPIRABLES-SIN COSTURAS INTERNAS PRONUNCIADAS-BORDE SUPERIOR ALMOHADILLADO-CONTRAFUERTE FIRME Y REDONDEADO-6. EL ZAPATO DEBE GENERAR UN EFECTO DE DESCARGA DE LA PRESION PLANTAR AL CAMINAR
2504315	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO PACIENTE CON PIE DIABETICO-PAR	ELABORADO BAJO MOLDE-EN CUERO SUAVE Y FLEXIBLE- CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS-1. ABSORCION-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN ABSORBER Y FACILITAR LA EVAPORACION DE AGUA PARA MANTENER ESTA ZONA SECA-2. AMPLITUD-CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EVITAR PRESIONES EN LA ZONA DE LOS DEDOS SIN SER DEMASIADO HOLGADO PARA EVITAR DESLIZAMIENTO DEL PIE DENTRO DEL ZAPATO-3. VENTILACION-DEBE FAVORECER EL FLUJO DE AIRE POR EL EFECTO COMPRESION-DESCOMPRESION FACILITANDO LA VENTILACION-4. CONFORT-COMODO-CONFORTABALE Y QUE AMORTIGUE EL IMPACTO A MEDIDA QUE SE CAMINA-CAPACIDAD DE COLOCAR UNA PLANTILLA ORTOPEDICA-5. PROTECCION EN LA ZONA DE TALONES PARA QUE NO ENTRE SUCIEDAD O ELEMENTOS QUE PROVOQUEN HERIDAS-LIVIANO-BAJO FORMULA MEDICA

2583631	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	CALZADO ORTOPEDICO CON REALCE-LEVANTAMIENTO POR CENTIMETRO EN LA ESTRUCTURA DEL TACON Y LA SUELA	EL CALZADO ORTOPEDICO CON REALCE TIENE COMO PRINCIPAL CARACTERISTICA SU MODIFICACION EN LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA DEL TACON Y LA SUELA DEL ZAPATO-LO QUE PERMITE COMPENSAR DIFERENCIAS DE LONGITUD DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DE UNA PERSONA-ESTA ELEVACION PUEDE SER REALIZADA EN EL INTERIOR DEL ZAPATO COMO POR EL EXTERIOR
2582466	42211810	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-5	C/U	A.02.02.01.002.009	ZAPATO ORTOPEDICO POSTOPERATORIO	ORTESIS DE SUELA SUAVE TIPO ROQUE-ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO DURO-ELABORADO EN TELAS ACOLCHADAS-CON CIERRES DE CONTACTO

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Ar tículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2504849	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ACOLCHADO DE SOPORTE CEFALICO PARA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA-ELABORADO EN ESPONJA ORTOPEDICA	ACOLCHADO DE SOPORTE CEFALICO PARA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA-AJUSTABLE EN ALTURAY PROFUNDIDAD-ELABORADO EN ESPONJA ORTOPEDICA (LAMINADURA ENTRE LAS LAMINAS DEL APOYACABEZAS-BAJO FORMULA MEDICA
2583613	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ANDADOR-ENTRENADOR DE MARCHA PEDIATRICO	ANDADOR INFANTIL (ENTRENADOR DE MARCHA PEDIATRICO) ELABORADO EN LAMINADO EN FRIO-ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA-GRADUACION DE ALTURA MEDIANTE SISTEMA DE PIN-SOPORTE ANATOMICO ACOLCHADO- ARNES- BASE RODANTE EN RUEDAS DE 3" GIRATORIAS CON FRENO INDEPENDIENTE-DEFENSA DELANTERA ACOLCHADA-DESMONTE-BAJO FORMULA MEDICA

2582475	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR-MARCO DURABLE EN ALUMINIO-RESISTENTE A LA CORROSION	MARCO DURABLE EN ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSION-ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON AGUJEROS PARA EVITAR ACUMULACION DE FLUIDOS-DISEÑO ANGULADO QUE DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EL PESO CORPORAL PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO-ESTABILIDAD-ALTURA AJUSTABLE-PESO MAXIMO DE SOPORTE 113K-BAJO FORMULA MEDICA
2504846	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	APOYABRAZO COMPLETO ACOLCHADO PARA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA-REMOVIBLE Y DE ACUERDO CON SILLA DEL PACIENTE	APOYA BRAZO COMPLETO ACOLCHADO PARA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA- FORMA PARTE DEL CHASIS- DESMONTABLE O ABATIBLE HACIA ATRAS- DERECHO E IZQUIERDO-BAJO FORMULAMEDICA
2504847	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	APOYAPIES REBATIBLE-EXTRAIBLE-REGULABLE Y DE ACUERDO CON NECESIDAD DEL PACIENTE	APOYAPIES PARASILLADE RUEDAS NEUROLOGICA- REBATIBLE EXTRAIBLE REGULABLE Y DE ACUERDO CON NECESIDAD DEL PACIENTE- DERECHO E IZQUIERDO
2504866	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	APOYAPIES PARA SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ABATIBLE-EXTRAIBLE	APOYAPIES CON ALTURA PARASILLADE RUEDAS MOTORIZADA- ABATIBLE EXTRAIBLE REGULABLE EN ALTURAY DE DESMONTE-DE ACUERDO ANECESIDAD DEL PACIENTE-DERECHO E IZQUIERDO
2504869	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ASAS DE EMPUJE RIGIDAS ERGONOMICAPARA SILLADE RUEDAS SEMIDEPORTIVA-DE ALTURA GRADUABLE Y CLAVIJA DE SEGURIDAD	ASAS DE EMPUJE RIGIDAS ERGONOMICAPARASILLADE RUEDAS SEMIDEPORTIVA- DE ALTURAGRADUABLE Y CLAVIJADE SEGURIDAD
2503311	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	PAA	A.02.02.01.003.006	AXILARES PARA MULETAS ELABORADOS EN GOMA EVA-BORDES REFORZADOS- PAR	AXILARES PARA MULETAS ELABORADOS EN GOMA EVA- BORDES REFORZADOS-ACONDICIONAMIENTO ANTERIOR CORRUGADO Y ANTIDESLIZANTE- COLOR GRISEÑO ERGONOMICO- TAMAÑO ESTANDAR-ELIMINA LA PRESION SOBRE LAS AXILAS- DE FACIL ADAPTACION

2583528	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE-EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTON FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE Y LIGERO-BRAZALETE ECUALIZABLE AJUSTABLE EN ALTURA EN MATERIAL TERMOPLASTICO-SOPORTE MANILAR ANATOMICO PLASTICO-ANTEBRAZO AJUSTABLE EN 4 NIVELES-ALTURA AJUSTABLE POR PIN- RECATON ANTIDESLIZANTE-AMBIDIESTRO-BAJO FORMULA MEDICA
2503709	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON CANADIENSE PEDIATRICO GRADUABLE	BASTON FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE DE PESO LIGERO-BRAZALETE PLASTICO RIGIDO-MANILAR EXTERNO ANATOMICO EN PLASTICO-ALTURA REGULABLE ANIVEL DEL VASTAGO Y EN ALTURA POR PIN-EMPUÑADURA ERGONOMICA-RECATON ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO 60 kg-AMBIDIESTRO-BAJO FORMULA MEDICA
2584541	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON CANADIENSE SENCILLO O MULETA DE ANTEBRAZO-EN ALUMINIO ANODIZADO	BASTON FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE DE PESO LIGERO-BRAZALETE PLASTICO RIGIDO-MANILAR EXTERNO ANATOMICO EN PLASTICO-ALTURA REGULABLE ANIVEL DEL VASTAGO-RECATON ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO 100kg-AMBIDIESTRO-BAJO FORMULA MEDICA
2583529	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO-ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO-SOPORTE DE ANTEBRAZO GRADUABLE EN ALTURA	FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO-OFRECE RESISTENCIA-LIGEREZAY DURABILIDAD-RESISTENTE A RAYADURAS Y CORROSION-LIGERO EN PESO-SOPORTE DE ANTEBRAZO GRADUABLE EN ALTURA MEDIANTE SISTEMADE BLOQUEO-SOPORTE PALMAR CON DISEÑO ERGONOMICO EN MATERIAL PLASTICO RESISTENTE CON ACABADO ANTIDESLIZANTE QUE REDUCE LA FATIGA DE LA MANO Y MEJORA EL AGARRE-RECATON ANTIDESLIZANTE EN LABASE PARA MAYOR ADHERENCIA Y PROTECCION DE SUPERFICIES-CAPACIDAD DE PESO HASTA100 KG-USO-AYUDA PARA LA MOVILIDAD-DISEÑADO CON TODOS LOS REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD Y CALIDAD- USO- FACILITAR LA MOVILIDAD- LA ESTABILIDAD-REDUCE LA CARGA-BAJO FORMULA MEDICA

2503421	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON DE ALUMINIO-MANGO CURVO EN POLIPROPILENO RESISTENTE	BASTON FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD LIGERO Y RESISTENTE-MANGO CURVO DE POLIPROPILENO-CON ALTURA AJUSTABLE-ANILLO CON ROSCADE SEGURIDAD- PARA AJUSTAR LA ALTURA DESEADA-ALTURADE 77cm + o - 3 A91cm + o - 3-QUE SOPORTE UN PESO DE HASTA110kg-REGATON/TAPON DE GOMANATURAL ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO-USO- PARA DAR SOPORTE Y ESTABILIDAD A LOS PACIENTES-BAJO FORMULA MEDICA
2583526	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON DE MADERA MANGO EN T -RECATON ANTIDESLIZANTE	BASTON DE APOYO FABRICADO EN MADERADE ALTA CALIDAD- DISEÑADO CON UN MANGO EN FORMADE T- LONGITUD VARIABLE (GENERALMENTE ENTRE 80 CM Y 100 CM)-DIAMETRO DEL BASTON APROXIMADAMENTE 2-3 CM-DE PESO LIGERO-ACABADO BARNIZADO O CON LACA PROTECTORA-SOPORTA HASTA 100 KG DE PESO-PUNTACON RECATON ANTIDESLIZANTE-USO-APOYO PARA CAMINAR-COMO ELEMENTO DE AYUDA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA-BAJO FORMULAMEDICA
2583610	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON EN ALUMINIO ANODIZADO MANGO EN T-RECATON ANTIDESLIZANTE	BASTON EN ALUMINIO ANODIZADO MANGO ANATOMICO EN T-RESISTENTE-AJUSTABLE EN ALTURA POR PIN-CON ANILLO DE FACIL BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD-RECATON ANTIDESLIZANTE-RANGO DE ALTURA DESDE 76 cm HASTA99 cm-CAPACIDAD DE PESO 100 kg-BAJO FORMULA MEDICA
2502652	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON MULTIPODAL DE 4 APOYOS ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO-MANGO CURVO TIPO CISNE	BASTON MULTIPODAL DE 4 APOYOS-ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO-MANGO CURVO TIPO CISNE-SOPORTE CON 4 PUNTOS DE APOYO REGULABLE EN ALTURA POR PIN- RECATONES ANTIDESLIZANTES-CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO 100 KG-BAJO FORMULA MEDICA

2504025	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON MULTIPODAL DE 3 PUNTOS DE APOYO ELABORADO EN ALUMINIO ANONDIZADO MANGO ANATOMICO	BASTON DE 3 PUNTOS DE APOYO ELABORADO EN ALUMINIO ANONDIZADO MANGO ANATOMICO- CURVO Y ROTATORIO PARAPODER SER USADO DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO ALTURAGRADUABLE-DE FACIL SUJECION- REGULACION DE CAÑAPOR PULSADOR RETRACTIL CON AGUJEROS EXTERIORES- MINIMA70-c m Y MAXIMA94 A96cm-- INCREMENTO EN cm DE 2-5cm- DISEÑO DE BASE ESTABLE DE 3 APOYOS-CONTERADE GOMAANTIDESLIZANTE-BAJO FORMULA MEDICA
2582511	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON PARA INVIDENTE CON PUNTA GIRATORIA	BASTON ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO- PLEGABLE O RETRACTIL- DE 4 CAÑAS- LAS 3 PRIMERAS EN BLANCO Y LA ULTIMA EN ROJO REFLECTIVO EMPUÑADURA RECTA Y CON CORREA PARA UNA MAYOR FIJACION Y CONTROL EN LA MANO- CON BOLA RODANTE (RODACHIN)-APLICADO A LA ALTURADEL PACIENTE-BAJO FORMULA MEDICA
2583527	42211501	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	BASTON TELESCOPICO CUELLO DE CISNE	BASTON TELESCOPICO CON DISEÑO DE CUELLO DE CISNE-CON LONGITUD AJUSTABLE ENTRE 75 CM Y 100 CM-DIAMETRO DEL TUBO ENTRE 19 MM Y 22 MM PARAMAYOR RESISTENCIA-CON MECANISMO DE BLOQUEO RA PIDO PARAASEGURAR LAALTURASELECCIONADA-CUELLO EN FORMADE CISNE PARAMEJOR APOYO-MANGO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE-PUNTACON CONTERAEN CAUCHO VULCANIZADO-DISEÑO COMPACTO-FACIL DE AJUSTAR-RESISTENTE ALOS GOLPES-USO-PARAPERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA-PROBLEMAS DE EQUILIBRIO EN PROCESOS DE REHABILITACION-BAJO FORMULA MEDICA
2583530	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR CON ASIENTO EN LONA-ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA-PLEGABLE	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA-RESISTENCIA-SISTEMA-DUAL DE PLEGADO-ASIENTO ABATIBLE CON ESPUMADE ALTA DENSIDAD Y FORRO IMPERMEABLE-ALTURA AJUSTABLE DE 30 A34"- MANILARES ERGONOMICOS-RUEDAS ANTERIORES DE 5"-PESO MAXIMO DE SOPORTE DE 113 KG

2583531	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR CON ASIENTO Y CANASTILLA ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO CON RUEDAS-CANASTILLA Y FRENOS TRASEROS	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTARESISTENCIATUBO HEXAGONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD-SISTEMA DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS QUE PERMITE SEGURIDAD AL SER UTILIZADO COMO ASIENTO-GRADUABLE POR MEDIO DE TORNILLOS TRIANGULARES-MANILARES CON FRENOS PARA LAS RUEDAS TRASERAS-RUEDAS MACIZAS DE 8"X2"-ALTURADE 72 X 97cm-ALTURADEL ASIENTO DE 59 X 61 cm-PROFUNDIDAD TOTAL 65 cm-ANCHO TOTAL 59 cm-TAMAÑO DEL ASIENTO 39 X 12 cm-4 RUEDAS Y CANASTILLA-BAJO FORMULA MEDICA
2583612	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR PASO APASO ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO-CONSTRUCCION TIPO PIRAMIDAL-ULTRALIVIANO	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE 7/8-CONSTRUCCION TIPO PIRAMIDAL-ULTRALIVIANO Y DE GRAN ESTABILIDAD-PLEGABLE CON ALTURA AJUSTABLE-DE 30 - 35"-PROFUNDIDAD DE 12"-ANCHO 17-5"-PESO MAXIMO DE SOPORTE 100KG-REGATONES ANTIDESLIZANTES-BAJO FORMULA MEDICA
2505722	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE DEL ADULTO ELABORADO EN ALUMINIO ANODIZADO LIVIANO-PLEGABLE GRADUABLE EN ALTURA	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA-LIVIANO Y PLEGALBE CON TRAVESAÑO FRONTAL-GRADUABLE EN ALTURAPOR MEDIO DE PIN- MANILARES PROTECTORES ERGONOMICOS Y SUAVES-REGATONES ANTIDESLIZANTES-BAJO FORMULA MEDICA
2583611	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS DEL ADULTO ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA-LIVIANO PLEGABLE	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA-TRAVESAÑO FRONTAL METALICO PARA MAYOR ESTABILIDAD-RUEDAS MACIZAS DELANTERAS GRADUABLE Y AJUSTABLE EN ALTURA POR MEDIO DE PIN-DISEÑO EN U-MANILARES ERGONOMICOS SUAVES-REGATONES ANTIDESLIZANTES-LIVIANO Y PLEGABLE-BAJO FORMULA MEDICA

2505099	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE PEDIATRICO ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA-LIVIANO	CAMINADOR ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTARESISTENCIALIVIANO-TRAVESAÑO FRONTAL- RUEDAS MACIZAS DELANTERAS-PLEGABLE-GRADUABLE EN ALTURAPOR MEDIO DE PIN-RECATONES ANTIDESLIZANTES MANIRALES ACOLCHADOS-BAJO FORMULA MEDICA
2504591	42251701	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS CON ARNES PELVICO ELABORADO EN POLIESTER	CINTURON PELVICO PARA SILLAS DE RUEDAS-ARNES PELVICO ELABORADO EN POLIESTER SEMIRIGIDO CON INTERIOR ACOLCHADO-MAXIMA RESISTENCIA EN LOS BORDES BRINDANDO SEGURIDAD Y COMODIDAD AL PACIENTE MEDIANTE CORREAS DE SUJECION AJUSTABLES Y CIERRE CON HEBILLAS DE PRESION-BAJO FORMUL AMEDICA
2583535	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS ASIENTO Y ESPALDAR FIRME ACOLCHADO	COCHE A LA MEDIDA DEL PACIENTE-ASIENTO Y ESPALDAR FIRME ACOLCHADO-PESO DE TRANSPORTE 10-15 kg RECLINACION 30° Y BASCULACION GRADUABLE ACCIONADA POR CUIDADOR-PLEGADO COMPACTO-CON ESPALDAR ABATIBLE PARA FACIL MANIPULACION Y TRANSPORTE-ESTRIBOS UNIPODALES ELEVABLES Y GRADUABLES-SOPORTE CEFALICO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD-EJES DE DESMONTE RAPIDO EN RUEDAS POSTERIORES-CAPOTA Y MANILAR DE EMPUJE GRADUABLE-QUE INCLUYA KIT DE CRECIMIIENTO EN ANCHO Y PROFUNDIDAD Y ACCESORIOS BAJO FORMULA MEDICA
2504590	42241702	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	COJIN DE POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD PELVICA- BASE FIRME DE ESPUMACON HONDONADAPELVICA- CON CUÑAS LATERALES	COJIN DE POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD PELVICA-BASE FIRME DE ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA-CON HONDONADA PELVICA (BARRA PREISQUIAL)-CUÑAS LATERALES PARA OPTIMA ESTABILIDAD LATERAL Y ANTEROPOSTERIOR-LLEVA GEL DE REDISTRIBUCION DE PRESION-LA ESPUMA SUAVE PERMITE UNA INMERSION DE LAPELVIS PARA MAYOR ESTABILIDAD-LA PARTE INFERIOR DE RADIO GRANDE PERMITE UTILIZARLO EN CUALQUIER SUPERFICIE-CON TELA ANTIDESLIZANTE-HEBILLA DE SEGURIDAD

2503320	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTERA (RECATON Y/O TAPON) PARA MULETA-DE GOMADE ALTA CALIDAD-CON REFUERZO DE PROTECCION INTERNA	TAPON PARABASTONY/O MULETA DE ALTA CALIDAD-CON REFUERZO METALICO DE PROTECCION INTERNA- EN MATERIAL PLASTICO ANTICORROSIVO PARAEVITAR EL DESGASTE-ACCESORIO ESENCIAL PARAMEJORAR LAFUNCIONALIDAD DE LAMULETAY/O BASTON PROPORCIONANDO MAYOR TRACCION- ESTABILIDAD-ABSORCION DEL IMPACTO REDUCIENDOLO ANIVEL DE ARTICULACIONES Y MUSCULOS DAPROTECION PARAEL USUARIO COMO PARAEL DISPOSITIVO MEDICO-ANTIDESLIZANTE (BUENA ADHERENCIA AL SUELO)
2583622	42211610	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO ELABORADO EN PLASTICO Y METAL DE ALTA RESISTENCIA-ALTURA AJUSTABLE	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO ELABORADO EN PLASTICO Y METAL DE ALTARESISTENCIA-ALTURAAJUSTABLE-DESCANSABRAZOS ABATIBLES-TAPA-PESO MAXIMO DE SOPORTE 113 KG
2584536	42211603	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ELEVADOR DE SANITARIO SIN BRAZOS-ELABORADO EN PLASTICO BLANCO DE ALTARESISTENCIA	ELEVADOR DE SANITARIO SENCILLO ELABORADO EN POLIURETANO LIVIANO Y DE GRAN RESISTENCIA SUPERFICIE ERGONOMICAQUE GENERAGRAN COMODIDAD AL USUARIO-SELLADO TOTALMENTE-FACIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE A MANCHAS Y OLORES-PARTE FRONTAL EXTRA-LARGA QUE PERMITE UNAFACIL LIMPIEZA PERSONAL-TOPES LATERALES FACILMENTE AJUSTABLES-DIMENSIONES- 40CM LARGO- 41CM ANCHO-10CM ALTO-BAJO FORMULA MEDICA

2504777	42211506	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ENTRENADOR DE MARCHADEL ADULTO-SOPORTE ANATOMICO ACOLCHADO-ARNES-BASE RODANTE EN RUEDAS DE 3" GIRATORIAS-	ENTRENADOR DE MARCHADEL ADULTO-ARNES-BASE RODANTE EN RUEDAS DE 3" GIRATORIAS-CON CHASIS EN ALUMINIO AMEDIDADEL PACIENTE-DEFENSADELANTERA-SOPORTE DE PELVIS AJUSTABLE Y REMOVIBLE-POSICIONADOR DE BRAZOS GRADUABLE Y REMOBIBLE-CONTROLADORES DE MUSLO Y PIES-SISTEMADE CRECIMIENTO-ALTURAGRADUABLE MEDIAQNTE SISTEMADE PIN-RUEDAS CON CONTROL DE VELOCIDAD-FRENO INDEPENDIENTE-FACIL DE ARMAR Y DESARMAR-USO-PARA DESARROLLAR Y PRACTICAR LAHABILIDAD DE CAMINAR-SOPORTE DE PESO 120 kg-BAJO FORMULA MEDICA
2504757	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ESPALDAR RIGIDO SILLADE RUEDAS-SOPORTE LATERIAL-CONTORNO PROFUNDO PELVICO (PDC)-NIVEL DE SOPORTE TORACICO MEDIO (MT)	ESPALDAR RIGIDO SILLADE RUEDAS-SOPORTE LATERIAL CONTORNO PROFUNDO PELVICO (PDC)-NIVEL DE SOPORTE TORACITO MEDIO (MT)-ALTURA DEL RESPALDO MEDIO (M)-ESPALDAR DE POSICIONAMIENTO RIGIDO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS-FABRICADO EN ALUMINIO LIVIANO-ALTURA ANGULO INFERIOR DE LA ESCAPULA-CONTORNO MEDIO-DIFERENTES NIVELES DE SOPORTE SEGUN NECESIDAD FUNCIONAL Y ESTABILIDAD DEL TRONCO-CON CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PARA LA ADAPTACION TOTAL AL USUARIO-COMPATIBLE CON UNA VARIEDAD DE DIAMETROS DE TUBOS-MULTIPLES POSICIONES DEL TUBO DEL RESPALDO-FACIL DE INSTALAR Y RETIRAR-BAJO FORMULA MEDICA
2504632	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	ESPALDAR RIGIDO SILLA DE RUEDAS UT/MC-COJIN Y/O RESPALDO PARA SILLADE RUEDAS BAJO FORMULA MEDICA	ESPALDAR RIGIDO SILLADE RUEDAS SOPORTE LATERIAL CONTORNO MEDIO (MC)-NIVEL DE SOPORTE TORACITO SUPERIOR (UT)-ALTURA DEL RESPALDO MEDIO (M)-ESPALDAR DE POSICIONAMIENTO RIGIDO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS FABRICADO EN ALUMINIO LIVIANO-ALTURA ANGULO INFERIOR DE LA ESCAPULA-CONTORNO MEDIO-DIFERENTES NIVELES DE SOPORTE SEGUN NECESIDAD FUNCIONAL Y ESTABILIDAD DEL TRONCO-CON CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PARA LA ADAPTACION TOTAL AL USUARIO COMPATIBLE CON UNA VARIEDAD DE DIAMETROS DE TUBOS-MULTIPLES POSICIONES DEL TUBO DEL RESPALDO-FACIL DE INSTALAR Y RETIRAR-BAJO FORMULA MEDICA

2503312	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	PAA	A.02.02.01.003.006	MANILARES-EMPUÑADURAS EN GOMA/NEOPRENO PARA APOYO DE MULETAS- BANDA TUBULAR PARA CUBRIR EL SOPORTE/APOYO DE LAS MULETAS	MANILARES/EMPUÑADURAS EN GOMA/NEOPRENO PARA APOYO DE MULETAS-BANDA TUBULAR PARA CUBRIR EL SOPORTE/APOYO DE LAS MULETAS-ESTANDAR- ABSORBE IMPACTOS-RESISTENTES ALATRANSPIRACION-LAVABLES-PAR
2582181	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	MULETAS AXILARES ACOLCHADAS-ELABORADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA	MULETAS AXILARES EN ALUMINIO DE PESO LIGERO-APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLASTICO O RECUBIERTOS DE ESPUMAY POLIPIEL- EMPUÑADURAS REVESTIDAS DE CAUCHO DE ALTADENSIDAD- REGATONES DE GOMAANTIDESLIZANTE-ALTURAREGULABLE POR SISTEMATELESCOPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRACTIL (INCREMENTOS DE 1") O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES-DIFERENTES MEDIDAS
2582447	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	MULETAS AXILARES INFANTE-UNIDAD DE EMPAQUE PAR	MULETAS AXILARES EN ALUMINIO DE PESO LIGERO-APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLASTICO O RECUBIERTOS DE ESPUMAY POLIPIEL- EMPUÑADURAS REVESTIDAS DE CAUCHO DE ALTADENSIDAD- REGATONES DE GOMAANTIDESLIZANTE-ALTURAREGULABLE POR SISTEMATELESCOPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRACTIL (INCREMENTOS DE 1") O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES-DIFERENTES MEDIDAS
2503621	42211502	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.003.006	REPUESTO PARA MULETAS (MANILAR/EMPUÑADURA- AXILAR)-TAPON PARA BASTON ANTIDESLIZANTE	REPUESTOS PARA MULETAS (MANILAR/EMPUÑADURA- AXILAR) ELABORADOS EN MATERIAL LAVABLE Y RESPIRABLE-TAPON PARA BASTON ANTIDESLIZANTE Y UNIDADES METALICAS INOXIDABLES
2504779	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	RUEDA TRASERA METALICA-SILLA PARA SILLA DE RUEDAS ESTANDAR DE 24 PULGADAS (60-65CM) DE DIAMETRO-MACIZA O NEUMATICA	COMPONENTE ESENCIAL PARA SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR-RUEDA TRASERADE 24 PULGADAS (60-65cm) DE DIAMETRO- SEGUN EL EJE +RADIOS EN (ACERO- ALUMINIO O TITANIO) CON CUBIERTA SINTETICA DE GOMA MACIZA O NEUMATICO DE AIRE AROS DE MANO YUXTA PUESTOS A LAS RUEDAS PARA LA AUTOPROPULSION EN ACERO CROMADO INOXIDABLE O COMPOSITE

2504357	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA SANITARIA-ESTRUCTURAEN ACERO INOXIDABLE-ESPALDAR ALTO Y RECLINABLE	SILLA PARA BAÑO-ESTRUCTURAEN ACERO INOXIDABLE-RECIPIENTE SANITARIO CON TAPA-ESPALDAR ALTO Y RECLINABLE-APOYABRAZOS DESMONTABLE CON RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS-BLOQUEO RUEDAS TRASERAS
2503940	42192208	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA SANITARIA EN ACERO CROMADO-CON ASIENTO-TAPA-TASAEXTRAIBLE EN PLASTICO-BRAZOS FIJOS Y PLEGABLE	SILLA SANITARIA-DE ESTRUCTURAMETALICA (ACERO CROMADO- SOPORTES DE CODO EN PVC Y PLASTICO (TAPAY TASAEXTRAIBLE)-APOYABRAZOS CON SOPORTE DE CODO EN PVC-RUEDAS EN LAS 4 PATAS- CON SOPORTE DE FRENO EN LAS TRASERAS- MEDIDAS-ALTURADE 49 A59cm- SOPORTE MO 100 KILOS
2504318	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS DE ALTA TECNOLOGIA DEL ADULTO CON CHASIS O MARCO FLEXIBLE/RIGIDA	SILLA DE RUEDAS ALTA TECNOLOGIA ADULTO CON CHASIS O MARCO FLEXIBLE/RIGIDO-SOBRE MEDIDAS- ESPALDAR CONTORNEADO-CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO-APOYA BRAZOS REMOVIBLE-ABATIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-APOYA PIES REMOVIBLE- GRADUABLE EN ALTURA-ASIENTO SOBRE MEDIDAS- ESTANDAR-LLANTAS ANTERIORES SOLIDAS- LLANTAS POSTERIORES SOLIDAS- ADITAMENTOS-CINTURON PELVICO- JOYSTICK PROGRAMABLE- FUENTE DE PODER- EL PACIENTE DEBE ASUMIR LA BATERIA POSTERIOR A LA FECHADE ENTREGA DE LA SILLA-BAJO FORMULA MEDICA
2504319	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS DE ALTA TECNOLOGIA PEDIATRICA CON CHASIS O MARCO FLEXIBLE/RIGIDA	SILLA DE RUEDAS ALTA TECNOLOGIA PEDIATRICA CON CHASIS O MARCO FLEXIBLE-RIGIDO-SOBRE MEDIDAS-ESPALDAR CONTORNEADO-CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO-APOYABRAZOS REMOVIBLE-ABATIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-APOYAPIES REMOVIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-ASIENTO SOBRE MEDIDAS-ESTANDAR- LLANTAS ANTERIORES SOLIDAS-LLANTAS POSTERIORES SOLIDAS-ADITAMENTOS- CINTURON PELVICO-JOYSTTICK PROGRAMABLE-FUENTE DE PODER- EL PACIENTE DEBE ASUMIR LA BATERIA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LA SILLA-BAJO FORMULA MEDICA

2583534	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA BARIATRICA ADULTO EN ACERO 7/8 PARAMAYOR FORTALEZAY SEGURIDAD	SILLA BARIATRICA EN ACERO CON DOBLE CRUCETA PARA MAYOR FORTALEZA Y SEGURIDAD CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200 A220 KG-DESCANSA BRAZOS Y DESCANSA PIES REMOVIBLES-PLEGABLE-AJUSTABLE AMEDIDAS DEL PACIENTE RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE 24 PULGADAS RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS TAPICERIARESISTENTE SEGUN PRESCRIPCION MEDICA QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA-BAJO FORMULA MEDICA
2582461	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR EN ACERO INOXIDABLE	CHASIS O MARCO EN ACERO-ANCHO DEL ASIENTO DE 16 A20 PULGADAS-MARCO PLEGABLE - SOPORTE DE PESO ENTRE 90 Y 120 kg -ESPALDAR EN TAPICERIAEN LONAIMPERMEABLE-LAVABLE-CON BOLSILLO EN EL ESPALDAR-ASAS DE EMPUJE ERGONOMICAS-FRENOS TIPO PALANCA-CORTOS EN ACERO O ALUMINIO BILATERALES-LLANTAS ANTERIORES MACIZAS DE 6-8 PULGADAS-LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS O MACIZAS DE 22- 25 PULGADAS-RINES CON RAYOS CRUZADOS -AROS DE PROPULSION EN ACERO-
2583662	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA12-14 CON CHASIS O MARCO EN ALUMINIO	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON MARCO PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE-TELA DE LONA IMPERMEABLE-ANTIINFLAMABLE Y LAVABLE- SOPORTE DE PESO DE 45 A60kg-ALTURA CON RANGO DE 32-38cm-LLANTAS ANTERIORES MACIZAS DE 6-8"- SUPERFICIE DE CAUCHO O POLIURETANO-LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS DE DE 20-22"-RINES PLASTICOS O RAYOS- AROS DE PROPULSION EN ALUMINIO O PLASTICO-MANILAR DE EMPUJE CON CAPAPROTECTORA-FRENO PUSH-EJES FIJOS LAMINA LATERAL PARAPROTECTOR DE ROPA CON O SIN SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO (OPCIONAL)

2503893	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA(ADULTO) CON CHASIS O MARCO PLEGABLE-RIGIDO-SOBREMEDIDAS	SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA ADULTO CON CHASIS O MARCO RIGIDO-SOBRE MEDIDAS-BASCULABLE-ESPALDAR RIGIDO-RECLINABLE-DE TENSION GRADUABLE-CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO-APOYABRAZOS REMOVIBLE-ABATIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-APOYA PIES REMOVIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-GRADUABLE EN ANGULO-MONOPODAL-BIPODAL- FORMA EN-V-SOPORTE DE PANTORRLLA-ANGULO TIBIOTARSIAL FIJO-GRADUABLE-ASIENTO CONTORNEADO-SOBRE MEDIDAS-LLANTAS ANTERIORES MACIZAS- CON SUPERFICIE DE POLIURETANO-LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS-SOLIDAS
2503892	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLADE RUEDAS GAMA ALTA PEDIATRICA-CHASIS O MARCO PLEGABLE-RIGIDO-SOBREMEDIDAS	SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA PEDIATRICA CON CHASIS O MARCO PLEGABLE-RIGIDO-SOBRE MEDIDAS-BASCULABLE-ESPALDAR RIGIDO-CONTORNEADO- RECLINABLE-DE TENSION GRADUABLE-CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO-APOYA BRAZOS REMOVIBLE-ABATIBLE- GRADUABLE EN ALTURA-APOYA PIES REMOVIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-GRADUABLE EN ANGULO-MONOPODAL-BIPODAL- FORMA EN-V-SOPORTE DE PANTORRLLA-ANGULO TIBIOTARSIAL FIJO-GRADUABLE-ASIENTO CONTORNEADO- SOBRE MEDIDAS-LLANTAS ANTERIORES SOLIDAS-LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS- SOLIDAS
2504316	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA-CHASIS FLEXIBLE/RIGIDO DEL ADULTO	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA ADULTO CON CHASIS O MARCO EN ALUMINIO FLEXIBLE-RIGIDO SOBRE MEDIDAS-ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSION REGULABLE -CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO-APOYABRAZOS REMOVIBLE-ABATIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-APOYA PIES REMOVIBLE-GRADUABLE EN ALTURA-GRADUABLE EN ANGULO- MONOPODAL-BIPODAL- FORMA EN-V-ASIENTO FLEXIBLE-RUEDAS ANTIVUELCO LLANTAS ANTERIORES MACIZAS-CON SUPERFICIE DE POLIURETANO-RUEDAS POSTERIORES NEUMATICAS DE 24" CON EJE DE DESMONTE RAPIDO-ADITAMENTOS-PROTECTORES LATERALES

2583639	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA PEDIATRICA	CHASIS O MARCO RIGIDO-DESMONTABLE O PLEGABLE EN MATERIAL RESISTENTE-SOPORTE DE PESO MINIMO 80 KG-CON KIT DE CRECIMIENTO MINIMO DE 2 PULGADAS-SEGUN MEDIDA INICIAL DEL USUARIO (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHO Y EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA)-MEDIDAS PERSONALIZADAS-ASAS DE EMPUJE-ASIENTO BASE RIGIDAREMOVIBLE- SISTEMADE BASCULACION MANUAL AJUSTABLE POR HERRAMIENTA- DESCANSA BRAZOS PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA Y LONGITUD-REMOVIBLES- JOY STICK- BRAZO ABATIBLE-CON PERADE AGARRE- TRACCION TRASERA
2583640	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLADE RUEDAS MOTORIZADA ADULTO	CHASIS O MARCO RIGIDO- SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG- MEDIDAS PERSONALIZADAS-ESPALDAR RIGIDO ACOLCHADO CON ESPUMADE ALTADENSIDAD- CON OPCION DE RELLENOS COMPENSATORIOS-FUNDAIMPERMEABLE Y LAVABLE- ASAS DE EMPUJE- ASIENTO BASE RIGIDAREMOVIBLE-SISTEMADE BASCULACION MANUAL-ACTIVADAPOR HERRAMIENTA-DESCANSABRAZOS PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA- REMOVIBLES- JOY STICK BRAZO (ANCLAJE) ABATIBLE- CON PERADE AGARRE-TRACCION TRASERA- RUEDAS DELANTERAS GIRO INDEPENDIENTE- MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS
2583637	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA CON CHASIS PLEGABLE GAMA MEDIA	CHASIS O MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO CERTIFICADO- DE MEDIDAS PERSONALIZADAS- CON EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)- KIT DE CRECIMIENTO MINIMO 2 PULGADAS EN CHASIS- ASIENTO Y ESPALDAR (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHO- EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA) SEGUN MEDIDAINICIAL DEL USUARIO-DISPONIBILIDAD MINIMO DE TRES COLORES-ESPALDAR RIGIDO- ACOLCHADO- ESPUMADE ALTADENSIDAD- CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS- CON OPCION DE ADAPTAR CUÑAS COMPENSATORIOS

2505741	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA RUEDAS MARCO PLEGABLE	SILLADE RUEDAS ACTIVAMARCO PLEGABLE HIBRIDASOBRE MED EN ALUMINIO APOYAPIES ABATIBLES- REMOVIBLES EN U O BIPODALICO AJUSTABLE EN ALTURA- CENTRO DE GRAVEDAD GRADUABLE TENEDOR EN ALUM CORREAPELVICA- FRENO TIPO PALANCAEJES DE DESMONTE RAPIDO CON TAPAHONGO-AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ESPALDAR RIGIDO DE POSIAMIENTO CONTORNEADO DE ALTURAMEDIO O BAJA-RUEDADELANTERATIPO SOFT ROLL- FRENO TIPO TIJERAO PALANCAEN ALUMINIO UNIDAD
2503890	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS-PARAPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO GAMA ALTA	CHASIS O MARCO RIGIDO ABIERTO-SOBREMEDIDAS-EN ALUMINIO AERONAUTICO CERTIFICADO-EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS ALTURAY PROFUNDIDAD-SOPORTE DE PESO MINIMO DE 120 kg-TELALONAIMPERMEABLE-LAVABLE-TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO-ESPALDAR ALTURAMAXIMASEGUN EL NIVEL DE LALESION-TELALONAIMPERMEABLE-LAVABLE-TENSION REGULABLE-ASADE EMPUJE ERGONOMICA-FRENOS CONFIGURABLES TIPO PALANCACORTO BILATERAL O TIPO TIJERA-LLANTAS ANTERIORES MACIZAS DE MINIMO 4 PULGADAS POR MINIMO 1-25 PULGADAS
2583666	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS HEMIPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO ABIERTO-SOBRE MEDIDAS GAMA ALTA	CHASIS O MARCO RIGIDO ABIERTO- SOBRE MEDIDAS- ALUMINIO AERONAUTICO CERTIFICADO- EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)- SOPORTE DE PESO MINIMO DE 120 KG DE ACUERDO ATALLAY PESO DEL USUARIO- DISPONIBILIDAD MINIMO DE TRES COLORES- ASIENTO TELALONAIMPERMEABLE Y LAVABLE- TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO- ESPALDAR ALTURAMAXIMASEGUN NIVEL DE LALESION-TELALONAIMPERMEABLE Y LAVABLE- TENSION REGULABLE- ASADE EMPUJE ERGONOMICA-FRENOS TIPO PALANCACORTO BILATERAL

2583668	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO - CHASIS O MARCO PLEGABLE RIGIDO	-I58CHASIS O MARCO PLEGABLE RIGIDO ALUMINIO 60/61 MEDIDAS PERSONALIZADAS-I58EJES VERTICALES (EN ALTURA) HORIZONTALES (EN PROFUNDIDAJUSTABLES KIT DE CRECIMIENTO PARANIÑOS RESPALDO--ESPALDAR SISTEMAPOSTURAL RIGIDO IMPERMEABLE - ANTIINFLAMABLE Y LAVABLE-MAS PERSONALIZADAS- –BASE RIGIDAPARAADAPTAR SISTEMADE POSICIONAMIENTO-RECLINABLE HASTA120° CON SISTEMAACTIVO DE GUALLAPI N Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO -BASCULACION PELVICAMINIMO DE 45°- ALTURAREGULABLE SEGUN CRECIMIENTO (NIÑOS)
2583668	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO CON PROPULSION DE LLANTAS TRASERAS-CON APOYA PIES-APOYA BRAZOS	SEGUN PRESCRIPCION MEDICARESISTENTE SILLASOBRE MEDIDAS MARCO EN ALUMINIO-PLEGABLE O FIJO CON ESPALDAR RIGIDO ABATIBLE SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURAY ABATIBLES FACILMENTE SOPORTE CEFALICO RUEDAS POSTERIORES ANTIVUELCO ACORDE AFORMULACION RUEDAS ANTERIORES SOLIDAS ACORDE AFORMULACION EJES DE DESMONTE RAPIDO ESTRIBOS PODALICOS AJUSTABLES EN ALTURACOJINERIABASICAEN ASIENTO Y ESPALDAR APOYABRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES Y QUE INCLUYALOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA
2504348	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA EN ALUMINIO MARCO RIGIDO RECLINABLE BASCULABLE-SOPORTES LATERALES DE TRONCO SOPORTE CEFALICO	SILLADE RUEDAS NEUROLOGICAEN ALUMINIO MARCO RIGIDO RECLINABLE BASCULABLE-SOPORTES LATERALES DE TRONCO SOPORTE CEFALICO- AJUST - ABDUCTOR AJUSTABLE- EN ALTURAY PROFUNDIDAD- REPOSAPIES Y APOYABRAZOS REMOVIBLES Y AJUSTABLES AALTURA- CINTURON PELVICO YD E EMPUJE AJUSTABLE EN ALTURA-

2504349	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA A MEDIDA DEL PACIENTE CON ESPALDAR ALTO- CON MECANISMOS DE RECLINAMIENTO	SILLADE RUEDAS PEDIATRICAAMEDIDADEL PACIENTE CON ESPALDAR ALTO- CON MECANISMOS DE RECLINAMIENTO Y ECUALIZACION CON SOPORTE T ICO-PECHERACORREAPE LVICA- TOPE ABDUCTOR (ENTRE MUSLOS) CON ESTRIBOS Y CORREAS DE SOPORTE EN ESTRIBOS LLANTAS DE 16 PULGADASL ANTERAS 6 Y/O 8 PULGADAS-FRENOS CONVENCIONALES-
2504350	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA NEUROLOGICA EN ALUMINIO MARCO RIGIDO RECLINABLE BASCULANTE SOPORTE LATERALES DE TRONCO Y SOPORTE CEFALICO AJUSTABLE	SILLANEUROLOGICAEN ALUMINIO MARCO RIGIDO RECLINABLE BASCULANTE SOPORTE LATERALES DE TRONCO Y SOPORTE CEFA LICO AJUSTABLE- ABDUC JUSTABLE EN ALTURAY PROFUNDIDAD- REPOSAPIES Y APOYABRAZOS REMOVIBLES Y AJUSTABLES AALTURA- CINTURON PELVICO Y ASAS DE EMPUJU STABLES EN ALTURA-
2504360	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLADE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO IMPORTADA- QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULA EL ESPECIALISTA	SEGUN PRESCRIPCION MEDICAY QUE INCLUYALOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTACOMO- PECHERANORMAL O MARIPOSA- CINTURON PEL - BANDAPANTORRILERA(OPCIONAL) PESO DE TRANSPORTE- 15 A18 KG CAPACIDAD DE PESO- 100 A140 KG INDICADOR DE BASCULACION INTELIGEP OR RODILLOS-OPCION DE BASCULACION PODAL Y/O MANUAL- SOBREMEDIDAS O KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO
2503354	42192210	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-6	C/U	A.02.02.01.004.002	SILLA LIVIANA EN ALUMINIO- REGULACION PROGRESIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	SILLALIVIANAEN ALUMINIO- REGULACION PROGRESIVADE LAPROFUNDIDAD DEL ASIENTO- ANCHO- ALTURADEL RESPALDO Y LONGITUD DE LAS PIE - SISTEMADE DESMONTE RAPIDO Y MECANISMO DE PLEGADO COMPACTO- RUEDAS ANTERIORES REGULARES DE 8 PULGADAS SOLIDAS Y RUEDAS POSTERS DE 10 PULGADAS NEUMATICAS- BARRADE EMPUJE ERGONOMICAABATIBLE Y AJUSTABLE EN ALTURA- SISTEMADE BASCULACION MANUAL

SOLUCIONES AUDITIVAS								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2503580	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO DE 20 CANALES-RETROAURICULAR	AUDIFONO DE 20 CANALES-RETROAURICULAR- MANEJO DE ADAPTACION POTENTE PORQUE PERMITE DISMINUIR LA AMPLIFICACION DE MANERA GRADUAL Y CON EL TIEMPO- COMPRESION FRECUENCIAL DONDE SE MEJORA LA PERCEPCION-RANGO AMPLIO DE SONIDOS-REALCE DE GRAVES-PROGRAMA AUTOMATICO- TECNOLOGIA INHALAMBRICA-BAJO FORMULA MEDICA
2503622	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO CON CIRCUITO AMPLIFICADOR MULTICANAL A PARTIR DE 8 CANALES. 4 BANDAS-COMPRESION WDRC- AGC-0-BLOQUEO DE FEEDBACK 5G	AUDIFONO CON CIRCUITO AMPLIFICADOR MULTICANAL PARTIR DE 8 CANALES. 4 BANDAS- COMPRESION WDRC- AGC-0-BLOQUEO DE FEEDBACK 5G. REDUCCION DE RUIDO. ENFOQUE DE VOZ Y PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE LA SEÑAL. RETARDO EN EL ENCENDIDO- MICROBIANO DIRECCIONAL. ALTA CAPACIDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE RUIDO EN EL AMBIENTE DE ACUERDO CON CAPACIDAD DEL USUARIO. MINIMA DISTORSION- CON ADAPTACION EN AMBIENTES VARIABLES. ALERTA DE BATERIA BAJA. RESALTADOR DE HABLA. CON PILA DE 13 O 675. NIVEL PROMEDIO DE SALIDA MAXIMADE 115db A 135dbR-BAJO FORMULA MEDICA
2503646	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONOS DIGITALES PROGRAMABLES MULTICANAL MINIMO DE 4 CANALES-FRECUENCIA DE CORTES VARIABLES	AUDIFONOS DIGITALES PROGRAMABLES MULTICANAL MINIMO DE 4 CANALES-FRECUENCIA DE CORTES VARIABLES- MENOR DISTORSION- ADPATACION EN AMBIENTES CAMBIABLES- MICROFONO ADAPTATIVO. DIGITAL PROGRAMABLE CON SOFTWARE (COMPUTADOR)O PROGRAMADOR PORTATIL. ENTRADA DE AUDIO DISPO NIBLE PARA AUDIFONOS RETROAURICULARES. FACILIDAD DE PROGRAMACION-BAJO FORMULA MEDICA

2504028	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO RETROAURICULAR 8 CANALES CIRCUITO SAGA	AUDIFONO RETROAURICULAR 8 CANALES CIRCUITO SAGA-DISEÑADO PARA PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA UNILATERAL O ASIMETRICA-EN EL CUAL EL SONIDO DEL OIDO AFECTADO SE TRANSMITE AL OIDO QUE AUN TIENE AUDICION-PUEDE SER CROS (ENRUTAMIENTO DE SEÑAL CONTRALATERAL) O BICICROS (ENRUTAMIENTO DE SEÑAL BILATERAL)-DEPENDIENDO DE SI EL AUDIFONO SE USA EN UN SOLO OIDO O EN AMBOS- LA TRANSMISION PUEDE SER INALAMBRICA O POR CABLE-PERMITE UNA MEJOR AUDICION EN ENTORNOS RUIDOSOS YFACILITA LA COMPRESNION DEL HABLA-BAJO FORMULA MEDICA
2504029	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO INTRAAURICULAR 8 CANALES CIRCUITO SAGA	AUDIFONO INTRAAURICULAR DE 8 CANALES PARA DIFERENCIACION EN DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA ENTRE 200Hz A 8 khZ-CON COBERTURA DE FRECUENCIA AJUSTABLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TIPOS DE PERDIDA AUDITIVA-PROCESAMIENTO DIGITAL-DSP (PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES) DE ALTO DE RESOLUCION-CIRCUITO-SAGA CON GANACIA ADAPTATIVA AUTOMATICO-REDUCCION DE RUIDO CON FILTRO AVANZADO PARA MINIMIZAR RUIDOS DE FONDO-LIMITADOR DE VOLUMEN CON PROTECCION CONTRA NIVELES DE VOLUMEN PELIGROSOS-PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO-CON MICROFONO DE ALTA SENSIBILIDAD-OMNIDIRECCIONAL-RECEPTOR DE ALTA FIDELIDAD CON RESPUESTA LINEAL-BATERIA RECARGABLE-RESISTENTE A LA HUMEDAD-BAJO FORMULA MEDICA

2504030	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO RETROAURICULAR DE 12 CANALES CIRCUITO SIRIUM/INTUIS2	AUDIFONO RETROAURICULAR (BTE) DE 12 CANALES-DIGITAL CON PROCESAMIENTO DE SEÑAL AVANZADO-PROGRAMABLE-POTENCIA CON VARIANTES DESDE LEVE HASTA SEVEROS-CON DIFERENTES NIVELES DE GANANCIA-BATERIAS RECARGABLES O DE ZINC SEGUN EL MODELO-RESPUESTA EN FRECUENCIA APROXIMADAMENTE 20 Hz. 10 Hz-EL CIRCUITO SIRIUM PROPORCIONA UNA REPRODUCCION CLARA Y NATURAL DEL SONIDO-PORQUE TIENEN SISTEMAS DE FILTRADO Y REDUCCION DE RUIDO DE FONDO-PROGRAMAS Y AJUSTES A TRAVES DE UN CONTROL EXTERNO O DIRECTAMENTE EN EL DISPOSITIVO-AJUSTE Y PROGRAMACION PERSONALIZABLE POR AUDIOPROTESISTA MEDIANTE SOFTWARE ESPECIAIZADO-RESISTENTE AL AGUA Y AL SUDOR-BAJO FORMULA MEDICA
2504031	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO INTRAAURICULAR DE 12 CANALES CIRCUITO SIRIUM/INTUIS2	AUDIFONO INTRAAURICULAR CON 12 CANALES DE PROCESAMIENTO CON TECNOLOGIA DIGITAL AVANZADA DEL SONIDO QUE FACILITA UN AJUSTE PERSONALIZADO PARA DIFERENTES GRADOS DE PERDIDA AUDITIVA-CON UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 200 Hz - 8 kHz AJUSTABLE SEGUN NECESIDAD DEL PACIENTE QUE PERMITE UNA MEJOR DISCRIMINACION DEL SONIDO Y REDUCCION DE RUIDO-PROGRAMABLE VIA SOFTWARE-CONTROLES DE VOLUMEN Y PROGRAMAS EN EL DISPOSITIVO-CONECTIVIDAD INHALAMBRICA-BATERIAS DESECHABLES-MANUAL DE ISTRUCCIONES-USO-PARA PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL-CONDUCTIVA O MIXTA-BAJO FORMULA MEDICA

2504032	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO RETROAURICULAR DE 16 CANALES CIRCUITO ORION SP	AUDIFONO RETROAURICULAR-PROGRAMABLE DE 16 CANALES-16 BANDAS-CON TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO DIGITAL AVANZADO-CON UNA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 250 HZ A 8 KHZ (AJUSTABLE SEGUN MODELO)-REDUCCION DE RUIDO Y CANCELACION DE ECO-PROGRAMACION PERSONALIZADA POR AUDIOPROTESISTA-4 PROGRAMAS-COMPATIBILIDAD CON APLICACIONES MOVILES PARA AJUSTES Y CONTROL-DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA AMPLIFICACION AUDITIVA EN PACIENTES CON DIFERENTES GRADOS Y TIPOS DE PERDIDA AUDITIVA-OFRECE UNA PERSONALIZACION AVANZADA Y UNA ADAPTACION PRECISA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO-DISPLEY DE BATERIAS DESECHABLES.MANUAL DE INSTRUCCIONES-BAJO FORMULA MEDICA
2504033	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO INTRAAURICULAR DE 16 CANALES CIRCUITO ORION SP	EL AUDIFONO INTRAAURICULAR- CON 16 CANALES DE PROCESAMIENTO- CON PROCESAMIENTO DIGITAL AVANZADO QUE LE PERMITE LA REDUCCION DE RUIDO Y LA MEJORA DE LA CLARIDAD DEL SONIDO-FRECUENCIA DE OPERACION 100 HZ Y 8 KHZ (DEPENDIENDO DEL MODELO)-PROGRAMACION DIGITAL- VIA SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA AJUSTE PERSONALIZADO-CONTROL DE VOLUMEN DIGITAL O ANALOGICO SEGUN MODELO- EN CONECTIVIDAD TIENE ENTRADA PARA MICROFONO EXTERNO-CON POSIBLE CONECTIVIDAD BLUETOOTH O ADAPTADORES-BATERIA DE ZINC-AIR O RECARGABLE-USO-DISCAPACIDAD AUDITIVA SEVERA A MODERADA- ADAPTACION-REVISION PERIODICA Y AJUSTES POR UN AUDIOLOGO ESPECIALIZADO-BAJO FORMULA MEDICA

2504260	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO PARA PERDIDA SEVERA-12 CANALES DE PROCESAMIENTO BTE	AUDIFONO BTE (BEHIND-THE-EAR)-CON 12 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL PARA UNA ADAPTACION PRECISA A DIFERENTES PERFILES DE PERDIDA AUDITIVA SEVERA-4 PROGRAMAS DE AUDICION CONFIGURABLES-MICROFONO DIRECCIONAL PARA MEJORAR LA PERCEPCION EN AMBIENTES RUIDOSOS Y FACILITAR LA COMPRENSION DEL HABLA-PROGRAMACION PERSONALIZADA POR AUDIOLOGO PARA OPTIMIZAR LA AUDICION SEGUN LA PERDIDA ESPECIFICA-BATERIA RECARGABLE O DE ZINC-AIRE- SEGUN EL MODELO- CONECTIVIDAD OPCIONAL CON CAPACIDADES BLUETOOTH PARA CONEXION CON DISPOSITIVOS EXTERNOS (MOVILES-TELEVISORES- ETC.)-BAJO FORMULA MEDICA

2504262	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONOS PARA PERDIDA MODERADA- 8 CANALES	AUDIFONO DIGITAL DE CANAL MULTIPLE (8 CANALES) AJUSTABLES PARA UNA ADAPTACION PRECISA A DIFERENTES PERFILES DE PERDIDA AUDITIVA-RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 250 HZ - 8000 HZ-CON TECNOLOGIA DE SUPRESION DE RUIDO DE FONDO-MICROFONOS DIRECCIONALES Y OMNIDIRECCIONALES-CONTROL DE VOLUMEN MANUAL Y AUTOMATICO-MULTIPLES PROGRAMAS DE ESCUCHA PRECONFIGURADOS PARA DIFERENTES ENTORNOS (HABLA EN SILENCIO- RUIDO MODERADO- AMBIENTES RUIDOSOS)-BATERIA RECARGABLE O DE ZINC-CARBON- DURACION APROXIMADA DE 50 HORAS-COMPATIBLE CON CONEXIONES BLUETOOTH PARA TRANSMISION DE SONIDO DESDE DISPOSITIVOS EXTERNOS-ADECUADO PARA DIFERENTES ESTILOS (RETROAURICULARES-INTRACANAL- COMPLETAMENTE EN EL CANAL)-PRECAUCIONES-USO BAJO SUPERVISION Y AJUSTE POR UN PROFESIONAL EN AUDIOLOGIA-INDICACIONES DE USO-PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA MODERADA-PACIENTES QUE REQUIEREN AMPLIFICACION PERSONALIZADA PARA DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA-PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE NECESITAN MEJOR PERCEPCION DEL HABLA Y SONIDOS AMBIENTALES

2504263	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONOS PARA PERDIDA LEVE-8 CANALES	AUDIFONO DIGITAL DE CANAL MULTIPLE (8 CANALES) AJUSTABLES PARA UNA ADAPTACION PRECISA A DIFERENTES PERFILES DE PERDIDA AUDITIVA-RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 250 HZ - 8000 HZ-CON TECNOLOGIA DE SUPRESION DE RUIDO DE FONDO-MICROFONOS DIRECCIONALES Y OMNIDIRECCIONALES-CONTROL DE VOLUMEN MANUAL Y AUTOMATICO-MULTIPLES PROGRAMAS DE ESCUCHA PRECONFIGURADOS PARA DIFERENTES ENTORNOS (HABLA EN SILENCIO- RUIDO MODERADO- AMBIENTES RUIDOSOS)-BATERIA RECARGABLE O DE ZINC-CARBON- DURACION APROXIMADA DE 50 HORAS-COMPATIBLE CON CONEXIONES BLUETOOTH PARA TRANSMISION DE SONIDO DESDE DISPOSITIVOS EXTERNOS-ADECUADO PARA DIFERENTES ESTILOS (RETROAURICULARES-INTRACANAL- COMPLETAMENTE EN EL CANAL)-PRECAUCIONES-USO BAJO SUPERVISION Y AJUSTE POR UN PROFESIONAL EN AUDIOLOGIA-INDICACIONES DE USO-PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA MODERADA-PACIENTES QUE REQUIEREN AMPLIFICACION PERSONALIZADA PARA DIFERENTES RANGOS DE FRECUENCIA-PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE NECESITAN MEJOR PERCEPCION DEL HABLA Y SONIDOS AMBIENTALES-BAJO FORMULA MEDICA
2504395	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO DIGITAL RETROAURICULAR (BTE)12 CANALES DE COMPRESION-CON 12 BANDAS DE ECUALIZACION-DOBLE MICROFONO DIRECCIONAL	AUDIFONO DIGITAL RETROAURICULAR (BTE) CON TECNOLOGIA AVANZADA- DISEÑADO PARA PERSONAS CON PERDIDAS AUDITIVAS PROFUNDAS. OFRECE MULTIPLES FUNCIONES PROGRAMABLES- CONTROL DE VOLUMEN EXTERNO Y TECNOLOGIA DE REDUCCION DE RUIDOS PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA AUDITIVA-2 CANALES DE COMPRESION-12 BANDAS AJUSTABLES DE ECUALIZACION-DOBLE MICROFONO DIRECCIONAL-SISTEMA DE REDUCCION DE RUIDOS-CONTROL DE VOLUMEN EXTERNO-TOTALMENTE PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO-BATERIA-USO- PERSONAS CON PERDIDAS AUDITIVAS PROFUNDAS O SEVERAS-USUARIOS QUE REQUIEREN DISPOSITIVOS CON ALTA POTENCIA Y AJUSTE PERSONALIZADO-SITUACIONES DONDE LA

								REDUCCION DE RUIDO Y LA DIRECCION DEL SONIDO SEAN NECESARIAS-BAJ FORMULA MEDICA
2504396	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO DIGITAL RETROAURICULA (BTE)16 CANALES CON MICROFONO RETROAURICULAR-PROGRAMABLE 12 CANALES- CON MICROFONO DIRECCIONAL	AUDIFONO DIGITAL RETROAURICULAR (BTE) DE 16 CANALES DE PROCESAMIENTO CON MICROFONO RETROAURICULAR Y PROGRAMABLE DE 12 CANALES CON MICROFONO DIRECCIONAL INTEGRADO-DE TECNOLOGIA DIGITAL AVANZADA COMPATIBLE CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS Y AJUSTES ESPECIFICOS PARA DIFERENTES ENTORNOS AUDITIVOS- BATERIA DE ZINC-AIR O RECARGABLE (SEGUN MODELO)-PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO- FUNCIONES ADICIONALES-CANCELACION DE RUIDO-REDUCCION DE RETROALIMENTACION-MEJORA DE LA COMPRENSION EN ENTORNOS RUIDOSOS-COMPATIBLE CON ACCESORIOS DE TRANSMISION INALAMBRICA Y CONTROL REMOTO-BAJO FORMULA MEDICA
2504529	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO UNILATERAL24 CANALES- 24 BANDAS- RECEPTOR EN EL CANAL- CONECTIVIDAD INALAMBRICA	AUDIFONO UNILATERAL CON 24 CANALES Y 24 BANDAS ESTA DISEÑADO PARA BRINDAR UNA SOLUCION AUDITIVA AVANZADA PARA PACIENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. CUENTA CON UN RECEPTOR EN EL CANAL-COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH Y OTRAS TECNOLOGIAS INALAMBRICAS PARA TRANSMISION DIRECTA DESDE TELEFONOS-TELEVISORES Y OTROS DISPOSITIVOS-DISEÑO UNILATERAL- ORIENTADO A PACIENTES CON PERDIDA AUDITIVA EN UN SOLO OIDO-TAMAÑO COMPACTO PARA COMODIDAD Y DISCRECION-BATERIAS RECARGABLES O DE BOTON-SEGUN MODELO ESPECIFICO-PROGRAMACION DIGITAL AVANZADA-OPCIONES DE CONTROL DE VOLUMEN Y PROGRAMAS MULTIPLES-CANCELACION DE RUIDO Y REDUCCION DE ZUMBIDOS-USO-PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA UNILATERAL-BAJO FORMULA MEDICA

2504603	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO CON TRANSMISOR "CROS PURE"- QUE SE COLOCA DETRAS DEL OIDO- DETECTA EL SONIDO- LO PROCESA Y LO TRANSMITE AL AUDIFONO DEL OTR	EL SISTEMA CROS PURE ES UN DISPOSITIVO AVANZADO DISEÑADO PARA PACIENTES CON PERDIDA AUDITIVA UNILATERAL O ASIMETRICA. PERMITE LA TRANSMISION DE SONIDO DE UN OIDO CON PERDIDA A UN OIDO CON AUDICION NORMAL O MEJOR PRESERVADA- MEJORANDO LA PERCEPCION DEL SONIDO EN AMBIENTES DIVERSOS- TECNOLOGIA INALAMBRICA DIGITAL QUE PERMITE UNA COMUNICACION EN TIEMPO REAL PARA UNA TRANSMISION CLARA Y SIN INTERFERENCIAS-POSEE UN TRANSMISOR (EMISOR) QUE SE COLOCA EN EL OIDO CON PERDIDA AUDITIVA- CAPTURA EL SONIDO Y LO ENVIA AL RECEPTOR-QUE SE UBICA EN EL OIDO CON AUDICION NORMAL- ENTREGANDO EL SONIDO RECIBIDO-CONECTIVIDAD BLUETOOTH QUE PERMITE CONEXION CON DISPOSITIVOS EXTERNOS COMO TELEFONOS- TELEVISORES- ETC-CONTROL DE VOLUMEN Y PROGRAMAS-AJUSTABLES MEDIANTE CONTROLES EN EL DISPOSITIVO O A TRAVES DE UNA APP MOVIL-BATERIAS RECARGABLES DE LITIO O PILAS DE BOTON (SEGUN MODELO)- USO- PACIENTES CON PERDIDA AUDITIVA UNILATERAL O ASIMETRICA-CUANDO LA PERDIDA EN UN OIDO IMPIDE LA PERCEPCION DEL SONIDO EN ESE LADO-MEJORAR LA LOCALIZACION ESPACIAL Y LA COMPRENSION DEL HABLA EN AMBIENTES RUIDOSOS-BAJO FORMULA MEDICA

2504672	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO MIH CROFONO EN HELIX CON 4 NIVELES DE POTENCIA	EL AUDIFONO MIH (MICROFONO EN HELIX) ESTA DISEÑADO PARA OFRECER SOLUCIONES PERSONALIZADAS A PACIENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. CON CUATRO NIVELES DE POTENCIA (BAJO- MEDIO- ALTO Y ULTRA ALTO)- PROPORCIONA UNA AMPLIFICACION AJUSTADA PARA DIFERENTES GRADOS DE PERDIDA AUDITIVA-GARANTIZANDO UNA MEJOR CALIDAD DE SONIDO Y COMODIDAD-AUDIFONO CON MICROFONO EN HELIX-CON NIVELES DE POTENCIA 4 (BAJO- MEDIO- ALTO- ULTRA ALTO)-CUENTA CON MICROFONO EN HELIX PARA CAPTACION DE SONIDO-AMPLIFICADOR AJUSTABLE SEGUN NIVEL DE POTENCIA-BATERIA RECARGABLE O DE LARGA DURACION (SEGUN VERSION)-PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL PARA MEJORAR LA CLARIDAD DEL SONIDO-CARCASA RESISTENTE Y COMODA PARA USO PROLONGADO-USO-PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA LEVE A PROFUNDA-USO DIARIO EN DIFERENTES ENTORNOS-ADAPTABLE A NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA PACIENTE-BAJO FORMULA MEDICA

2504678	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO DE AURICULAR EN OIDO (RIE/RIC). CON RECEPTOR EN EL CANAL RIC. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES-PROGRAMA TOTALMENTE FLEXIBLE	LOS AUDIFONOS CON AURICULAR EN EL OIDO (AUDIFONOS RIE) SON EL TIPO DE AUDIFONOS MAS POPULAR. TAMBIEN PUEDEN LLAMARSE AUDIFONOS CON AURICULAR EN EL CANAL-AUDIFONOS RIC O AUDIFONOS RITE-EL AUDIFONO RIC (RECEPTOR EN EL CANAL)-ES UN DISPOSITIVO AUDITIVO DE TECNOLOGIA AVANZADA QUE DA UNA MEJOR CALIDAD DE SONIDO-DE MODELO VARIABLE SEGUN FABRICANTE-ES DIGITAL CON PROCESAMIENTO DE SONIDO EN TIEMPO REAL-RECEPTOR-ALTAVOZ INTEGRADO EN EL CANAL-BATERIA RECARGABLE (LI-ION) O DE ZINC-AIR-MICROFONOS CON TECNOLOGIA DIRECCIONAL PARA MEJORAR LA COMPRENSION EN AMBIENTES RUIDOSOS-CONTROL DE VOLUMEN-MANUAL O DIGITAL-CON POSIBILIDAD DE CONTROL MEDIANTE APP O MANDO REMOTO-CON MULTIPLES PROGRAMAS AJUSTABLES PARA DIFERENTES ENTORNOS (HABLA- MUSICA- AMBIENTES RUIDOSOS)-BLUETOOTH PARA CONEXION CON TELEFONOS- TELEVISORES- OTROS DISPOSITIVOS-BATERIA RECARGABLE O DE USO PROLONGADO-VOLUMEN- PROGRAMAS Y AJUSTES EN LA CARCASA O MEDIANTE APLICACIONES MOVILES-USO-DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LEVES A MODERADAS-PERSONAS QUE REQUIEREN AMPLIFICACION PERSONALIZADA-PACIENTES CON PERDIDA AUDITIVA EN UNO O AMBOS OIDOS-BAJO FORMULA MEDICA

2505108	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONOS ENMASCARADORES DE RUIDO-PROGRAMADO POR COMPUTADOR	AUDIFONOS ENMASCARADORES DE RUIDO-EQUIPADOS CON TECNOLOGIA PROGRAMABLE VIA COMPUTADOR-CON DOS CANALES INDEPENDIENTES-CON DOS CANALES INDEPENDIENTES PARA MAYOR PRECISION EN EL PROCESAMIENTO DEL SONIDO-4 BANDAS DE FRECUENCIA PARA AJUSTES DE GANANCIA-TECNOLOGIA DE ENMASCARAMIENTO-CONFIGURACION MEDIATE SOFTWARE ESPECIALIZADO- BATERIA RECARGABLE O DE LARGA DURACION-COMPATIBLE CON DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE AJUSTE-CONECTIVIDAD CON PUERTOS USB O INALAMBRICOS PARA PROGRAMACION Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE- CUMPLE CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA-USO- DISPOSITIVOS PARA ENMASCARAR RUIDOS EN AMBIENTES RUIDOSOS-PROGRAMACION PERSONALIZADA PARA DISTINTOS GRADOS Y TIPOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA-USO EN TERAPIAS DE REHABILITACION AUDITIVA-BAJO FORMULA MEDICA
2582769	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO COMPLETAMENTE EN EL CANAL (CIC)	EL AUDIFONO COMPLETAMENTE EN EL CANAL (CIC) ES UN DISPOSITIVO AUDITIVO DISEÑADO PARA AJUSTARSE COMPLETAMENTE EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO- MICROFONO MINIATURA- AMPLIFICADOR AJUSTABLE-RECEPTOR (ALTAVOZ) MINIATURA-CIRCUITOS DIGITALES PARA PROCESAMIENTO DEL SONIDO- OPCIONES DE PROGRAMACION-PROGRAMACION DIGITAL PERSONALIZADA-CONTROL DE VOLUMEN Y PROGRAMAS MEDIANTE INTERRUPTORES O APLICACIONES MOVILES- BATERIA DE ZINC-AIR DE CORTA DURACION- FACIL DE REEMPLAZAR-AJUSTABLES SEGUN LA PERDIDA AUDITIVA DEL PACIENTE- SISTEMAS DE REDUCCION DE RUIDO Y FEEDBACK- OPCIONES DE CONEXION BLUETOOTH PARA DISPOSITIVOS COMPATIBLES-USO- DISCAPACIDAD AUDITIVA LEVE A MODERADA SEVERA- PERSONAS CON PERDIDA AUDITIVA EN AMBOS O UN SOLO OIDO-BAJO FORMULA MEDICA

2582797	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	C/U	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO RETROAURICULAR (BTE) RIE - CON RECEPTOR EN EL CANAL RIC	AUDIFONO RETROAURICULAR (BTE) RIE- CON RECEPTOR EN EL CANAL RIC. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES-PROGRAMA TOTALMENTE FLEXIBLE-PULSADOR SINCRONIZADO- CONTROL DE VOLUMEN SINCRONIZADO- SMARTSTART TM-PHONENOW TM. COMUNICACION OIDO-OIDO-TRANSMISION DIRECTA DE AUDIO. FUNCIONALIDAD INHALAMBRICA. CARACTERISTICAS AUDIOLOGICAS-COMPRESION WARP- 12 CANALES-DIRECCIONALIDAD BINAURAL-DIRECCIONALIDAD ADAPTATIVA- REALCE DE GRAVES- PROCESADOR MIXTO DIRECCIONAL. DE ADAPTACION ABIERTA- CON O SIN RECEPTOR DE CANAL CON OPCION DE MICROMOLDE CIC- ITC Y CONCHA (CON TODO TIPO DE BATERIA). COBERTURA PARA TODO TIPO Y GRADO DE PERDIDA AUDITIVA- CON TECNOLOGIA TINITUS. CIRCUITO DE COMPRESION WDRC- AGCO- EWRC-REDUCTOR DE RUIDO-BAJO FORMULA MEDICA
2587520	42211705	ZMQX	ZMQX-001	ZMQX-001-7	CU	A-02-01-01-004-008-01	AUDIFONO LIVIO AI 1600 BTE-RIC 10 CANAL UN AUDIFONO DE CONDUCCION AEREA ES UN DISPOSITIVO PORTATIL DE AMPLIFICACION DE SONIDO QUE SE	EL AUDIFONO LIVIO AI 1600 BTE-RIC ES UN DISPOSITIVO DE CONDUCCION AEREA-INTEGRADO CON TECNOLOGIA AVANZADA-OFRECE UNA SOLUCION DISCRETA Y EFICIENTE PARA MEJORAR LA AUDICION EN DIFERENTES ENTORNOS-AUDIFONO BTE (BEHIND-THE-EAR) CON TECNOLOGIA RIC (RECEIVER-IN-CANAL)-10 CANALES DE PROCESAMIENTO AJUSTABLES PARA UNA PERSONALIZACION PRECISA DEL AJUSTE-CONECTIVIDAD BLUETOOTH PARA TRANSMISION INALAMBRICA DESDE DISPOSITIVOS COMPATIBLES-PROCESAMIENTO DIGITAL DEL SONIDO DE ALTA CALIDAD-PROGRAMAS AJUSTABLES SEGUN LAS NECESIDADES DEL USUARIO-POTENCIA Y AMPLIFICACION AJUSTABLE PARA DIFERENTES GRADOS DE PERDIDA AUDITIVA-RESPUESTA EN FRECUENCIA OPTIMIZADA PARA CLARIDAD Y COMPRENSION-BATERIA-RECARGABLE O DE ZINC-AIRE (SEGUN MODELO)-CON CANCELACION DE RUIDO Y REDUCCION DE RETROALIMENTACION-CONECTIVIDAD CON TELEFONOS INTELIGENTES Y OTROS DISPOSITIVOS-

								CONTROL DE VOLUMEN Y PROGRAMAS MEDIANTE APLICACIONES COMPATIBLES-USO-RECOMENDADO PARA PACIENTES CON PERDIDA AUDITIVA DE LEVE A SEVERA. LA PROGRAMACION Y AJUSTE DEBEN REALIZARSE POR UN PROFESIONAL AUDIOLOGICO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA ADAPTACION

DICO-QUIRÚRGICOS GENERALES
GRUPO ADMINISTRACIÓN - V1

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2505267	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR PARA ACCESO INTRAVENOSOS ESTERIL INDIVIDUAL	ADAPTADOR PARA ACCESO INTRAVENOSO- CON MEMBRANA CONCAVA EN SILICONA GRADO MEDICO- LIBRE DE LATEX POR UNIDAD. SISTEMA CERRADO LIBRE DE AGUJAS CON CONEXION-LIBRE DE RESTRICCION- TIPO LUER LOCK PARA FACILIDAD DE USO CON LAS JERINGAS. LINEAS DE INFUSION UTILIZADO PARA TERAPIA INTERMITENTE O CONTINUA. EFICAZ CONTRA LA CONTAMINACION MICROBIANA. ESTERIL PARA CONSERVAR EN TEMPERATURA AMBIENTE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500031	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR MEZCLADOR NUTRICIONAL EN POLIPROPILENO- NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	ACCESORIO PARA CONECTOR PUERTO DE ALIMENTACION QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA SONDAS Y KIT DE GASTROSTOMIA EN POLIPROPILENO- NO ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502276	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ADPAPTADOR PARA TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE Y/O TOMA DE MUESTRAS/TAPON SALINIZADO	ADAPTADOR PARA TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE Y/O TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE- CON CONEXION LUER LOCK (EN ROSCA PARA EL CATETER)- SI APROXIMADAMENTE CIEN (100) CODIGOES. GARANTIZA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE EMPATAR EL TAPON AL CATETER-EVITANDO DESCONEXIONES ACCIDENTALES-EMPAQUE INDIVIDUAL
2584021	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR DE TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE-	CONECTOR SIN AGUJA CON TUBO DE EXTENSION MATERIAL DE PVC DE GRADO MEDICO CON ABRAZADERA-EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-CONECTOR LUER INTERNACIONAL-

							CON EXTENSION-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	BIOCOMPATIBLE. ADAPTADOR DE AJUSTE HERMETICO- BUENA CARACTERISTISA DE SELLADO- LO QUE CONDUCE A NINGUNA FUGA- SE UTILIZA JUNTO CON LA CANULA ARTERIAL Y VENOSA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500422	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ALAS ACCESO SUBCUTANEO PEDIATRICO 20G X 20 mm3	AGUJAS ESPECIALES CON CODIGO BISELADA DE 20 G X 20 mm- INDICADA PARA LA CODIGO DE SISTEMAS IMPLANTABLES DE ACCESO VASCULAR-CANULA DE SUPERFICIE LIGERAMENTE RUGOSA PARA UNA MAYOR ADHERENCIA A LA MEMBRANA. SUJECION FIRME Y ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500092	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ALAS ACCESO SUBCUTANEO PEDIATRICO 22G X11 mm	AGUJAS ESPECIALES CON CODIGO BISELADA DE 22 G X 11 mm- INDICADA PARA LA CODIGO DE SISTEMAS IMPLANTABLES DE ACCESO VASCULAR-CANULA DE SUPERFICIE LIGERAMENTE RUGOSA PARA UNA MAYOR ADHERENCIA A LA MEMBRANA. SUJECION FIRME Y ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500091	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ALAS PARA ACCESO SUBCUTANEO-20G X15mm	AGUJAS ESPECIALES CON CODIGO BISELADA DE 20 G X 15 mm- INDICADAS PARA LA CODIGO DE SISTEMAS IMPLANTABLES DE ACCESO VASCULAR-CANULA DE SUPERFICIE LIGERAMENTE RUGOSA PARA UNA MAYOR ADHERENCIA A LA MEMBRANA. SUJECION FIRME Y ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504551	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BIOPSIA POR ASPIRACION TIPO CHIBA CALIBRE 20 G-LONGITUD 20 cm.	AGUJA AUTOMATICA BIOPSIA TIPO TRU CUT 13G x 4-6 mm- COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO MAG. AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDOS ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- CANULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK PARA MULTIPLES BIOPSIAS Y BIOPSIA BAJO GUIA DE TC. ESTILETE EXTRAIBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 mm ESTILETE ADICIONAL CON CODIGO DE TROCAR PARA POSICIONAMIENTO BAJO GUIA DE TC-EMPUÑADURA ABS DE DOS ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO- CON VENTANA PARA VER EL TAMAÑO DE MUESTRA ELEGIDO- MARCADOR ECOGENISO INTERNO- ESPACIADOR ESTEREOTACTICO-FABRICADA EN ALEACION METALICA GRADO MEDICO NO MAGNETISA-EMPAQUE INDIVIDUAL

2504664	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BLOQUEO SIMPATICO NO.21 G	AGUJAS ATRAUMATICAS PARA BLOQUEO DE PLEXOS O NERVIOS PERIFERICOS QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN BAJO ULTRASONIDO-CON ALARGADERA DE INFUSION Y CABLE DE CONEXION QUE LLEVA AL ESTIMULADOR NERVIOSO. AGUJA CON RECUBRIMIENTO AISLANTE EN TODA SU LONGITUD DEMARCADA POR CENTIMETRO-SOLO EL BISEL ES LA PARTE CONDUCTORA-EL PABELLON DE LA AGUJA ES TRANSPARENTE Y ERGONOMICO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501746	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA/CANULA PARA NEUORESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 21G- LONGITUD 0.55 X 100 mm	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 21G - 25 mm; CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°- EXTENSION DE ANESTESIA- CON MARCACION DE LONGITUD EN CENTIMETROS-TUBO DE INYECCION TRANSPARENTE Y CONEXION LUER LOCK Y CABLE DE CONEXIONES- AISLAMIENTO NANO LINE EN LA LONGITUD DE LA AGUJA. EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERILIZACION OXIDO DE ETILENO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501747	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA/CANULA PARA NEUORESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 20G- LONGITUD 0.55X50mm	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 20G - 0.55X50mm; CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°- EXTENSION DE ANESTESIA- CON MARCACION DE LONGITUD EN CENTIMETROS- TUBO DE INYECCION TRANSPARENTE Y CONEXION LUER LOCK Y CABLE DE CONEXIONES. AISLAMIENTO NANO LINE EN LA LONGITUD DE LA AGUJA. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILIZACION OXIDO DE ETILENO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501745	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA/CANULA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 20G 0.55X50mm-LONG 0.55X25mm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA 20G - 0.55X25mm; CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°- EXTENSION DE ANESTESIA- CON MARCACION DE LONGITUD EN CENTIMETROS- TUBO DE INYECCION TRANSPARENTE Y CONEXION LUER LOCK Y CABLE DE CONEXIONES. AISLAMIENTO NANO LINE EN LA LONGITUD DE LA AGUJA. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILIZACION OXIDO DE ETILENO-EMPAQUE INDIVIDUAL

2502471	42142500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA COLECTA MULTIPLE 20G (0.9mm) x 1 PULGADA (25mm)- PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO.	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 PULGADA- AGUJA PARA COLECTA DE SANGRE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- DE DOBLE CODIGO- PAREDES DELGADAS- SILICONADAS- TRIBISELADA- TAPON DE GOMA EN EL LADO OPUESTO DEL QUE VAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE PARA PREVENIR LA FUGA DE SANGRE. CARTUCHO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO. ESTERIL- ATOXICA- HIPOALERGENISA Y APIROGENA. SILICONADA INTERIOR Y EXTERIORMENTE- DE PAREDES FINAS- ESTERIL- EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2503786	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA COLECTA MULTIPLE 21 X 1/2" PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO.	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 Y MEDIA PULGADA- AGUJA PARA COLECTA DE SANGRE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- DE DOBLE CODIGO- PAREDES DELGADAS- SILICONADAS- TRIBISELADA- TAPON DE GOMA EN EL LADO OPUESTO DEL QUE VAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE PARA PREVENIR LA FUGA DE SANGRE. CARTUCHO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO. ESTERIL- ATOXICA- HIPOALERGENISA Y APIROGENA. SILICONADA INTERIOR Y EXTERIORMENTE- DE PAREDES FINAS- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502967	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA COLECTA MULTIPLE 22 G (0.7mm) x1" (25mm)- PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO.	AGUJA HIPODERMICA 22 G X 1 PULGADA- AGUJA PARA COLECTA DE SANGRE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- DE DOBLE CODIGO- PAREDES DELGADAS- SILICONADAS- TRIBISELADA- TAPON DE GOMA EN EL LADO OPUESTO DEL QUE VAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE PARA PREVENIR LA FUGA DE SANGRE. CARTUCHO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO. ESTERIL- ATOXICA- HIPOALERGENISA Y APIROGENA. SILICONADA INTERIOR Y EXTERIORMENTE- DE PAREDES FINAS- ESTERIL- EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ETI PROTECTORA
2503787	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA COLECTA MULTIPLE 22 X 1/2 PULGADA PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO.	AGUJA HIPODERMICA 22 G X 1 PULGADA Y MEDIA- AGUJA PARA COLECTA DE SANGRE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- DE DOBLE CODIGO- PAREDES DELGADAS- SILICONADAS- TRIBISELADA- TAPON DE GOMA EN EL LADO OPUESTO DEL QUE VAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE PARA PREVENIR LA FUGA DE SANGRE. CARTUCHO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO. ESTERIL- ATOXICA- HIPOALERGENISA Y APIROGENA. SILICONADA INTERIOR Y EXTERIORMENTE- DE PAREDES FINAS- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL

2504253	42142534	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA DE GASTRO 23 GAUSH CON 7 FR- LONGITUD DE 1550 cm	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA DE GASTROENTEROLOGIA- DIMENSIONES DE 23 GAUSH CON 7 FR- LONGITUD DE 1550 cm- USO PARA INYECCION DE LA SUBMUCOSA GASTROINTESTINAL O PARA ADMINISTRAR AGENTES DE ESCLEROTERAPIA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501700	42142534	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA DE LIQUIDOS INTRAOSEA NO.16 G- PUNTA DE DIAMANTE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA DE LIQUIDOS INTRAOSEA NO.16 G EN EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL-TROCAR 16G-MANDRIL DE TROCAR CON SOPORTE Y CODIGO EN DIAMANTE- MARCA EN EL TROCAR PARA MEDIR DISTANCIA-CON ADAPTACION DE CONECCION LUER LOCK-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501701	42142534	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA DE LIQUIDOS INTRAOSEA NO.18 G- PUNTA DE DIAMANTE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA DE LIQUIDOS INTRAOSEA NO.18 G EN EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-TROCAR 16G-MANDRIL DE TROCAR CON SOPORTE Y CODIGO EN DIAMANTE- MARCA EN EL TROCAR PARA MEDIR DISTANCIA- CON ADAPTACION DE CONECCION LUER LOCK-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501713	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 27G x 3 1/2 PULGADA PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O CODIGO LUMBAR PEDIATRICA 27G X 2 PULGADAS-EN ACERO NIVEL MEDICO FIRME Y ELASTICO-PUNTA QUINCKE- CORTO CON CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE-ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501709	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 20G x 3 1/2 PULGADA PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR PEDIATRICA 20Gx3 1/2"-EN ACERO NIVEL MEDICO FIRME Y ELASTICO- PUNTA QUINCKE-CORTO CON CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501710	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 22G x 3 1/2 PULGADA	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR PEDIATRICA 22Gx3 1/2 PULGADA-EN ACERO GRADO MEDICO FIRME Y ELASTICO- BISEL QUINCKE- CORTO CON CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL

							PUNTA QUINCKE	
2505439	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA / PUNCION LUMBAR 23G 3 1/2 PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR PEDIATRICA 23G 3 1/2PULGADA-EN ACERO GRADO MEDICO FIRME Y ELASTICO- BISEL QUINCKE CORTO-CON CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501711	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 25G x 3 1/2 PULGADA PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR PEDIATRICA 25Gx3 1/2 PULGADA -EN ACERO GREADO MEDICO FIRME Y ELASTICO-BISEL QUINCKE- CORTO CON CODIGO COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501706	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 25Gx3 1/2 PULGADA PUNTA LAPIZ	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O LUMBAR PEDIATRICA 25G X 3 1 /2 PULGADA PUNTA LAPIZ. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA. PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501707	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 26Gx3 1/2 PULGADA PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O LUMBAR PEDIATRICA 26Gx3 1/2 PULGADA PUNTA LAPIZ. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE-AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA-PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500036	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 26G x 3 1 /2PULGADA-PUNTA QUINCKE	AGUJA ACERO INOXIDABLE PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR DE 26 G POR 3 Y MEDIO PULGADAS- ESTERIL- CON PUNTA TIPO QUINCKE-PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA ESPINAL Y/O LUMBAR-BISEL CORTO-PABELLON DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA PERMITIR LA VISUALIZACION EL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE-ESTILETE CON SISTEMA DE LLAVE O MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CANULA QUE FACILITA LA ADECUADA ORIENTACION DE LA POSICION DEL BISEL DE LA

								AGUJA-PRODUCTO PARA SER UTILIZADO UNA SOLA VEZ-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501708	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 27G x 3 1/2 PULGADA PUNTA QUINCKE	AGUJAS ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR PEDIATRICA 27Gx3 1/2 PULGADA PUNTA LAPIZ. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE-AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA-PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502246	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR 27Gx3 1/2 PULGADA-PUNTA LAPIZ	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR- PEDIATRICA 27Gx3 1/2 PULGADA PUNTA LAPIZ-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA. PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2587236	42142514	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA O PUNCION LUMBAR -18G X 3 1/2-TIPO QUINCKE	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR- PEDIATRICA 18 Gx3 1/2PULGADA PUNTA LAPIZ-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA. PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2584138	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 14 G X 1 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDEA Y/O LUMBAR- PEDIATRICA 18 Gx3 1/2PULGADA PUNTA LAPIZ-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISEL TIPO WHITACRE-CODIGO DE COLOR DEPENDIENDO DEL CALIBRE. AJUSTE PERFECTO ENTRE EL MANDRIL Y LA AGUJA. PRESENCIA DE MUESCA ENTRE EL ESTILETE Y LA CAMARA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500062	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 16 G X 1 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ESTERIL-DESCARTABLE-	AGUJA HIPODERMICA DE 16 X 1 1/2 EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2502153	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 18 G X 1PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 18 X 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500063	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 18 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 18 X 1 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500064	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 19 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 19 X 1 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502155	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 20 G X 2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 20 X 2 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2500623	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 20 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 20 X 1/2 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503539	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 20 G X 1 1/4PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 20 X 1 1/4 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502154	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 20 G X 1PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 20 X 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503629	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 20 G X 1/2PULGADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 20 X 2/1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500622	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE GRADO	AGUJA HIPODERMICA DE 21 X 1 2/1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL

							MEDICO. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500065	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 22 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 22 X 1 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503541	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 22 G X 1 1/4PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 22 X 1 1/4 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503532	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 22 G X 1PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 22 X 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500066	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 23 X 1 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2503511	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 23 X 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503820	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1/2PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 23 X 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502729	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 24 G X 1PULGADA- EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 24 X 1 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500067	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 25G (0.5mm) x1PULGADA (25mm)-EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 25 (0.5 mm) X 1 (25 mm) EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503036	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 25 G X 1 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 25 X 1 1/2 PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2501382	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 25 G X 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 25 X 1/2 PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502720	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 26 G X 1 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 26 X 1 1/2 PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502722	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 26 G X 1/2(0.45x12mm). EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA DE 26 X 1/2 PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPO BLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501225	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 26 G X 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA 26 G X 1/2 EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPOBLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE FACIL APETRTURA- DESCATRABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500068	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 27 G X 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA 27 G X 1/2 EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPOBLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

								DE FACIL APETRTURA- DESCATRABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503148	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 27 G X 1 1/2PULGADA-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA 27 G 1 1/2 EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPOBLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE FACIL APETRTURA- DESCATRABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2505264	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2PULGADA (0.30x12mm)-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA 30 G 1/2 EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPOBLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE FACIL APETRTURA- DESCATRABLE-EMPAQUE INDIDIVDUAL
2584104	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA N° 32 G(0.23mm) X5/32(4 mm)- EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA 32 G (0.23 mm) X 5/32 (4 mm) EN ACERO INOXIDABLE SILICONADO- GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE (BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS (TIPOBLIXTER)- CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO- PABELLON DE POLIPROPILENO-EXENTA DE LATEX- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE FACIL APETRTURA- DESCATRABLE-EN ACERO INOXIDABLE-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502359	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA HIPODERMICA ALADA 21Gx19mm EN ACERO INOXIDABLE-CON ALETAS. DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA HIPODERMICA ALADA 21 G X 19 mm EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO (CANULA CON PROTECTOR)- BISEL CON PRECISION GLIDE-CONO LUER LOCK Y/O LUIE SLIP- RECUBIERTA CON LUBRICANTE GRADO MEDICO QUE FACILITA EL DESLIZAMIENTO-PABELLON DE POLIPROPILENO- EXENTA DE LATEX-ESTERIL-DESCARTABLE-DE FACIL APETRTURA- EMPAQUE INDIVIDUAL

2500624	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 37 mm	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 37 mm EN ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON EXCEPTO EN LA CODIGO CON CODIGO DE COLOR UNIVERSAL. EMPATE DE AGUJA EN MATERIAL PLASTICO DE FACIL AGARRE. CABLE CONECTOR ENTRE 65-75cm EN EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500625	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 50mm	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 50 mm EN ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON EXCEPTO EN LA CODIGO CON CODIGO DE COLOR UNIVERSAL. EMPATE DE AGUJA EN MATERIAL PLASTICO DE FACIL AGARRE. CABLE CONECTOR ENTRE 65-75cm EN EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504180	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 27MM	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA 27 mm EN ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON EXCEPTO EN LA CODIGO CON CODIGO DE COLOR UNIVERSAL. EMPATE DE AGUJA EN MATERIAL PLASTICO DE FACIL AGARRE. CABLE CONECTOR ENTRE 65-75cm EN EMPAQUE INDIVIDUAL.
2502794	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE SEGURIDAD 21 G(0.8mm) x1 ½ PULGADA (38mm). PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO	AGUJA MULTIPLE CALIBRE 21 G X 1 1/2-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRIBISELADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO-ALINEADO AL BISEL Y SE ACTIVA CON SANGRE Y PERFORA EL TUBO AL VACIO-ESTERIL-APIROGENA- DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500090	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE SEGURIDAD 21 G X1 1/5 (0.8 X 38 mm) PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO.	AGUJA MULTIPLE CALIBRE 21 G X 1 1/5-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRIBISELADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO-ALINEADO AL BISEL Y SE ACTIVA CON SANGRE Y PERFORA EL TUBO AL VACIO-ESTERIL-APIROGENA- DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502484	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD DE 22G(0.7mm)	AGUJA MULTIPLE CALIBRE 22 G X 1 -EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRIBISELADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO-ALINEADO AL BISEL Y SE ACTIVA CON SANGRE Y

							X1PULGADA (25mm). PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICAS EN TUBOS AL VACIO	PERFORA EL TUBO AL VACIO-ESTERIL-APIROGENA- DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502795	42142515	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE SEGURIDAD 22 G(0.7mm) x1 1/2PULGADA (38mm). PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO	AGUJA MULTIPLE CALIBRE 22 G X 1 1/2 -EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRIBISELADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO-ALINEADO AL BISEL Y SE ACTIVA CON SANGRE Y PERFORA EL TUBO AL VACIO-ESTERIL-APIROGENA- DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502422	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL No 26 G EN ACERO INOXIDABLE-PARA ANESTESIA / ANALGESIA	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL N° 26 G- CON BISEL TIPO TUOHY-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-PARA ANESTESIA/ANALGESIA PERIDURAL ADULTO- MARCACIONES A INTERVALOS DE 1 cm-ESTERIL-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2503122	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA- 21 G X 100 mm X 25 mm-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA-21 G X 100 mm X 25 mm-CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°- EXTENSION DE ANESTESIA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2565513	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA NEUROESTIMULACION PERIFERICA 21G X 25 mm X LONG 0.55 mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA-21 G X 25 mm X 0.55 mm; CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°-EXTENSION DE ANESTESIA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503176	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA NEUROESTIMULACION PERIFERICA 21G X 50 mm X	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA-21 G X 50 mm X 0.55 mm-CANULA PARA BLOQUEO PERIFERICO CON BISEL 15°- EXTENSION DE ANESTESIA- EMPAQUE INDIVIDUAL

							LONG 0.55 mm-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504165	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA-22G X 120 mm X 0.7	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE - PARA USO EN BLOQUEO DE NERVIO EN ANESTESIA REGIONAL Y PERIFERICA 22 G 0.7x120mm - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL
2504166	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA NEUROESTIMULACION Y ANESTESIA PERIFERICA-22G X 80 mm X 0-7 mm	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE - PARA USO EN BLOQUEO DE NERVIO EN ANESTESIA REGIONAL Y PERIFERICA 22 G X 80 mm X 0.7 mm - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL
2505716	42142502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA NEUROESTIMULACION PERIFERICA 20G X 100mm	AGUJA NEUROESTIMULA PERIFERICA ATRAUNATICA- 20G X 100mm X 0.90 mm-EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-PVC-PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NEUROESTIMULACION PERIFERICA-CON ALARGADERA DE INFUSION Y CABLE DE CONEXION QUE LLEVA AL ESTIMULADOR NERVIOSO-ESTERIL-USO-ANESTESIA PARA PROCEDIMIEOS QUIRURGICOS-TERAPIA DEL DOLOR-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501702	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BLOQUEO SIMPATICO NO.22 G LONG 100-150mm- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-DE ACERO INOXIDABLE- LONGITUD DE AGUJA DE 100-150mm-AGUJA DE 22G -CAMARA TRANSPARENTE DE LLENADO-MANDRIL CON BOTON INDICADO CODIGO EN FORMA DE LAPIZ - PLASTICO GRADO MEDICO ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL DESECHABLE
2501703	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BLOQUEO SIMPATICO NO.23 G LONG 100-150mm- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-DE ACERO INOXIDABLE- LONGITUD DE AGUJA DE 100-150mm-AGUJA DE 23G -CAMARA TRANSPARENTE DE LLENADO -MANDRIL CON BOTON INDICADO CODIGO EN FORMA DE LAPIZ - PLASTICO GRADO MEDICO ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL DESECHABLE

2501704	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BLOQUEO SIMPATICO NO.24 G LONG 100-150mm- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-DE ACERO INOXIDABLE- LONGITUD DE AGUJA DE 100-150mm- AGUJA DE 24G -CAMARA TRANSPARENTE DE LLENADO -MANDRIL CON BOTON INDICADO CODIGO EN FORMA DE LAPIZ - PLASTICO GRADO MEDICO ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL DESECHABLE
2501705	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BLOQUEO SIMPATICO NO.25 G LONG 100-150mm- EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-DE ACERO INOXIDABLE- LONGITUD DE AGUJA DE 100-150mm- AGUJA DE 25G -CAMARA TRANSPARENTE DE LLENADO -MANDRIL CON BOTON INDICADO CODIGO EN FORMA DE LAPIZ - PLASTICO GRADO MEDICO ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS ESTERIL DESECHABLE
2501161	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA PLUMA DOSIFICADORA INSULINA 32Gx5/32PULGADAx4mm	AGUJA DESECHABLE EN ACERO INOXIDABLE FINO PARA PLUMA DOSIFICADORA DE INSULINA DE 4 mm A 8 mm DE LARGO X 29 A 33 GAUGE DE GROSOR - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL
2502247	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL No 16G EN ACERO INXIDABLE GRADO MEDICO. PARA ANESTESIA/ANALGESIA	AGUJA PERIDURAL- CON BISEL REDONDEADO TIPO TUOHY- CENTRO CON ALAS FIJAS Y CONEXION LUER LOCK - MARCACIONES A INTERVALOS POLIPROPILENO-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL -PARA ANESTESIA/ANALGESIA PERIDURAL ADULTO N° 16 G
2502862	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL No 17G EN ACERO INXIDABLE GRADO MEDICO. PARA ANESTESIA/ANALGESIA	AGUJA EPIIDURAL- CON BISEL TIPO TUOHY- ESTERIL-PARA ANESTESIA/ANALGESIA PERIDURAL ADULTO NO 17 G " X 80mm- MARCACIONES A INTERVALOS POLIPROPILENO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL

2502248	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL No 18G EN ACERO INXIDABLE GRADO MEDICO. PARA ANESTESIA/ANALGESIA	AGUJA PERIDURAL- CON BISEL REDONDEADO TIPO TUOHY- CENTRO CON ALAS FIJAS Y CONEXION LUER LOCK - MARCACIONES A INTERVALOS POLIPROPILENO-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL -PARA ANESTESIA/ANALGESIA PERIDURAL ADULTO N° 18 G
2502863	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PERIDURAL/EPIDURAL No 20G EN ACERO INXIDABLE GRADO MEDICO. PARA ANESTESIA/ANALGESIA	AGUJA EPIDURAL- CON BISEL TIPO TUOHY-ESTERIL-PARA ANESTESIA/ANALGESIA PERIDURAL ADULTO NO 20 G " X 80mm-MARCACIONES A INTERVALOS POLIPROPILENO-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2503631	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PLUMA DOSIFICADORA INSULINA31GX8 mm (5/16PULGADA)-ESTERIL-EMPAQUE INDIVUAL	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-31Gx8mm (5/16") PRESICION GLIDE- BISEL TRIFACETADO CON PAREDES DELGADAS Y SISTEMA DE PULIDO EXTERIL-APIROGENA
2500037	42142513	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PUNCION ANGIOGRAFISA SELDINGER-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA CODIGO ANGIOGRAFISA SELDINGER-CONECTOR ERGONOMICO CON CODIGOTO DE REFERENCIA PARA ORIENTAR EL BISEL. INSERCION Y RETIRO SUAVE SOBRE EL ALAMBRE GUIA. CON EMPAQUE INDIVIDUAL
2502238	42141504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.004	APLICADOR CON PUNTA DE FLUORESCEINA SODISA 5%-USO OFTALMISO	APLICADOR Y/O TIRA REACTIVA DE FLUORESCEINA SODISA 5% OFTALMISA. UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LOS PROBLEMAS DE CORNEA- CONJUNTIVA APLANACION - SOBRE INDIVIDUAL ESTERIL
2503697	40141658	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON BAKRI PARA MANEJO O DISMINUCION DE LA HEMORRAGIA POSPARTO	BALON BAKRI PARA MANEJO O DISMINUCION DE LA HEMORRAGIA POSPARTO ES UN DISPOSITIVO EN SILICONA DE 54 cm DE LARGO Y 24 FR CON CAPACIDAD MAXIMA DE 800CC

2500184	42141902	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA VACIA PARA ENEMAS/APLICAR SOLUCIONES RECTALES MAS CAMPO PROTECTOR DE CAMA. NO ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	BOLSA VACIA PARA ENEMAS.EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTERIL.BOLSA PLASTICA.TUBO DE PLASTICO.LLAVE REGULADORA DE FACIL MANEJO.CANULA RECTAL UNIDAD
2501198	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 0.25L/250ml MULTICAPA	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL DE 0-25 LITROS O 250 MILILITROS FORMADA POR TRES O MAS CAPAS- GENERALMENTE LAS DOS INTERNAS SON DE UN MATERIAL QUIMICAMENTE INERTE Y LA EXTERNA EN UN POLIMERO FOTOPORTECTOR- ESTERIL DE UNICO USO.
2501199	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL- E.V.A. X 500ml/0.5 LITROS/PEDIATRICA	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL DE 500 ml FABRICADA EN ETIL VINIL ACETATO (E.V.A)- SECCION AMPLIA PARA EL PASO DE LIQUIDOS Y AMPLIO FILTRO DE ENTRADA DE AIRE- ESTRIAS V E MEDICACION SEPARADOS DE LA LINEA DE ADMINISTRACION CON CONECTOR LUER MACHO. OBTURADOR DE CIERRE (NON REOPENING)- CON ESPIGAS PERFO M- ESTERIL EN UNICO EMPAQUE DE UN SOLO USO
2501200	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 0.5L/500ml MULTICAPA	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 500 ml FORMADA POR TRES 0 MAS CAPAS- GENERALMENTE LAS DOS INTERNAS SON DE UN MATERIAL QUIMICAMENTE INERTE Y LA EXTERNA EN UN POLIMERO FOTOPORTECTOR- ESTERIL DE UNICO USO.
2501201	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL- E.V.A. X 1000ml/1 LITRO	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL DE 1000 ml FABRICADA EN ETIL VINIL ACETATO (E.V.A)- SECCION AMPLIA PARA EL PASO DE LIQUIDOS Y AMPLIO FILTRO DE ENTRADA DE AIRE- ESTRIAS V E MEDICACION SEPARADOS DE LA LINEA DE ADMINISTRACION CON CONECTOR LUER MACHO. OBTURADOR DE CIERRE (NON REOPENING)- CON ESPIGAS PERFO M- ESTERIL EN UNICO EMPAQUE DE UN SOLO USO
2501202	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 1L/1000ml MULTICAPA	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 1000 ml FORMADA POR TRES 0 MAS CAPAS- GENERALMENTE LAS DOS INTERNAS SON DE UN MATERIAL QUIMICAMENTE INERTE Y LA EXTERNA EN UN POLIMERO FOTOPORTECTOR- ESTERIL DE UNICO USO.

2501203	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL-E.V.A. X 2000ml/2 LITROS	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL DE 2000 ml FABRICADA EN ETIL VINIL ACETATO (E.V.A)-SECCION AMPLIA PARA EL PASO DE LIQUIDOS Y AMPLIO FILTRO DE ENTRADA DE AIRE- ESTRIAS V E MEDICACION SEPARADOS DE LA LINEA DE ADMINISTRACION CON CONECTOR LUER MACHO. OBTURADOR DE CIERRE (NON REOPENING)- CON ESPIGAS PERFO M- ESTERIL EN UNICO EMPAQUE DE UN SOLO USO
2501204	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 2L/2000ml MULTICAPA	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 2000 ml FORMADA POR TRES O MAS CAPAS-GENERALMENTE LAS DOS INTERNAS SON DE UN MATERIAL QUIMICAMENTE INERTE Y LA EXTERNA EN UN POLIMERO FOTOPORTECTOR- ESTERIL DE UNICO USO.
2501205	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL-E.V.A. X 3000ml/3 LITROS	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL DE 3000 ml FABRICADA EN ETIL VINIL ACETATO (E.V.A)-SECCION AMPLIA PARA EL PASO DE LIQUIDOS Y AMPLIO FILTRO DE ENTRADA DE AIRE- ESTRIAS V E MEDICACION SEPARADOS DE LA LINEA DE ADMINISTRACION CON CONECTOR LUER MACHO. OBTURADOR DE CIERRE (NON REOPENING)- CON ESPIGAS PERFO M- ESTERIL EN UNICO EMPAQUE DE UN SOLO USO
2501206	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 3L/3000ml MULTICAPA	BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL 3000 ml FORMADA POR TRES O MAS CAPAS-GENERALMENTE LAS DOS INTERNAS SON DE UN MATERIAL QUIMICAMENTE INERTE Y LA EXTERNA EN UN POLIMERO FOTOPORTECTOR- ESTERIL DE UNICO USO.
2500234	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA/CONTENEDOR VACIA PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 1000ml	CONTENEDOR DE MEZCLAS PARA NUTRICION PARENTERAL DE 1000 ml ELABORADO EN (PVC/EVA/ABS/POLYSOPRENO/POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD/POLIPROPILENO) DE CIERRE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA- ESTERIL-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL- CON ROTULO DE IDENTIFICACION
2500235	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL 1500ml	CONTENEDOR DE MEZCLAS PARA NUTRICION PARENTERAL DE 1500 ml ELABORADO EN (PVC/EVA/ABS/POLYSOPRENO/POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD/POLIPROPILENO) DE CIERRE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA- ESTERIL-DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL- CON ROTULO DE IDENTIFICACION

2500232	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA/CONTENEDOR VACIA PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 150ml	CONTENEDOR DE MEZCLAS PARA NUTRICION PARENTERALDE 150 ml ELABORADO EN (PVC/EVA/ABS/POLYSOPRENO/POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD/POLIPROPILENO) DE CIERRE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL- CON ROTULO DE IDENTIFICACION
2500236	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA/CONTENEDOR VACIA PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 3000ml	CONTENEDOR DE MEZCLAS PARA NUTRICION PARENTERAL DE 3000 ml ELABORADO EN (PVC/EVA/ABS/POLYSOPRENO/POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD/POLIPROPILENO) DE CIERRE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL- CON ROTULO DE IDENTIFICACION
2500233	51191603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA/CONTENEDOR VACIA PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 500ml	CONTENEDOR DE MEZCLAS PARA NUTRICION PARENTERAL DE 500 ml ELABORADO EN (PVC/EVA/ABS/POLYSOPRENO/POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD/POLIPROPILENO) DE CIERRE Y SEGURIDAD DEL SISTEMA- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL- CON ROTULO DE IDENTIFICACION
2501293	42231500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA VACIA NUTRICION ENTERAL- EXCENTA DE LATEX X 1000ml	BOLSA VACIA PARA NUTRICION ENTERAL- EXCENTA DE LATEX EN PVC DE 1000 ml- CON CONECTOR PARA SONDA NASOGASTRICA UNIVERSAL- ESTERIL Y DE UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2500250	42231500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA VACIA CON EQUIPO NUTRICION ENTERAL X 1500ml	BOLSA PLASTICA DE GRADO MEDICO VACIA CON EQUIPO NUTRICION ENTERAL CON CAPACIDAD DE X 1500ml NO ESTERIL NO APTA PARA USO INTRAVENOSO
2500672	42231500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA CON EQUIPO INCLUIDO PARA NUTRICION ENTERAL ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL- DESCARTABLE	BOLSA VACIA CON EQUIPO INCLUIDO PARA NUTRICION ENTERAL. LIBRE DE LATEX Y DEHP. TRANSPARENTE CON REJILLA NUMERICA Y CONECTOR PARA SONDA NASOGASTRICA. ESTERIL Y DESCARTABLE. CON CONCECTOR ESCALONADO PARA SONDA NASOGASTRICA. CON CLAMP DE CIERRE HERMETICO PARA CONTROLAR LA ADMINISTRACION. DE 1000 A 1500ml DE CAPACIDAD. DE UN SOLO USO.
2500171	42143301	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOMBA INFUSION CATETER ABLACION ELECTROFISIOL	BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA AUTO SELECTOR PORTABLE Y SEGURA- DISEÑADA PARA INFUSION CONTINUA Y/O INTERMITENTE DE MEDICAMENTOS QUE INCLUYEN ANTIBIOTISOS- QUIMIOTERAPIA Y TERAPIAS PARA MANEJO DEL

							OGIA- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	DOLOR- PROPORCIONA UN METODO PRECISO Y FLEXIBLE EN EL SUMINISTRO DE MEDICACION. 400 ml TASA REGULABLE 1.0-14 ml/HORA MAS BOLSA DE TRANSPORTE. CON/SIN PROTECCION UV PARA MEDICAMENTOS QUE REQUIERAN. EMPAQUE ESTERIL.
2504204	42231604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOTON GASTRICO N° 24	BOTON DE ALIMENTACION DE GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL-ES DISCRETO Y FACIL DE OCULTAR-DE SILICONA DE GRADO MEDICO DE ALTA CLARIDAD- DISEÑADA PARA VISIBILIDAD Y DRAPEADO-CAUCHO NATURAL- SIN LATEX-24 FR
2504695	42231604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOTON GASTRICO N° 14 Y/O SONDA DE BAJO PERFIL DIAMETRO. ESTERIL	BOTON GASTRICO Y/O SONDA DE BAJO PERFIL No. 14. DIAMETRO DEL ESTOMA 14Fr. LARGO DEL ESTOMA- 08-4.5 cm. VOLUMEN DE LLENADO DEL GLOBO- 5ml. DISPOSITIVO CON CABEZA 100% SILICONA RADIOPACA GRADO MEDICO- PUERTO CON TAPA QUE TIENE UN SEGMENTO ESTRIADO PARA FACILITAR EL CIERRE Y VALVULA ANTIRETORNO EN SILICONA- SONDA TRANSPARENTE CON LINEA RADIOPACA. DISEÑADA PARA INTRODUCIRSE EN LA CAVIDAD GASTRICA A TRAVES DE UN ESTOMA POR TECNICA QUIRURGICA. USO- ADMINISTRACION DIRECTA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504696	42231604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOTON GASTRICO N° 18 Y/O SONDA DE BAJO PERFIL DIAMETRO Ø EXTERIOR 6MM-6.7MM-8MM LONGITUD 1.20cm-3.40cm. ESTERIL	BOTON GASTRICO Y/O SONDA DE BAJO PERFIL No. 18. MEDIDAS- DIAMETRO Ø EXTERIOR 6mm-LONGITUD 1.20cm-3.40cm. DISPOSITIVO CON CABEZA 100% SILICONA RADIOPACA GRADO MEDICO- PUERTO CON TAPA QUE TIENE UN SEGMENTO ESTRIADO PARA FACILITAR EL CIERRE Y VALVULA ANTIRETORNO EN SILICONA- SONDA TRANSPARENTE CON LINEA RADIOPACA. DISEÑADA PARA INTRODUCIRSE EN LA CAVIDAD GASTRICA A TRAVES DE UN ESTOMA POR TECNICA QUIRURGICA. USO- ADMINISTRACION DIRECTA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504697	42231604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOTON GASTRICO N° 20 Y/O SONDA DE BAJO PERFIL DIAMETRO Ø EXTERIOR 6.70MM-LONGITUD 1.70cm-2.40cm. ESTERIL	BOTON GASTRICO Y/O SONDA DE BAJO PERFIL No. 20. MEDIDAS-DIAMETRO Ø EXTERIOR 6.70mm-LONGITUD 1.70cm-2.40cm. DISPOSITIVO CON CABEZA 100% SILICONA RADIOPACA GRADO MEDICO- PUERTO CON TAPA QUE TIENE UN SEGMENTO ESTRIADO PARA FACILITAR EL CIERRE Y VALVULA ANTIRETORNO EN SILICONA- SONDA TRANSPARENTE CON LINEA RADIOPACA. DISEÑADA PARA INTRODUCIRSE EN LA CAVIDAD GASTRICA A TRAVES DE UN OSTOMA POR

								TECNICA QUIRURGICA. USO- ADMINISTRACION DIRECTA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504536	42231604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOTON GASTRICO N° 17 FR 1.0cm	BOTON GASTRICO Ø EXTERIIOR N°17 Fr LONGITUD DEL ESTOMA 1.0cm. MATERIAL DE ELABORACION-SILICONA. TUBO DE ALIMENTACION PARA GASTROSTO
2502327	42221902	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BURETA SENCILLA 150ml-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	BURETA SENCILLA 150CC. EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA-CON DISPOSITIVO DE PERFORACION (TIPO ESPIGA) CON PROTECTOR- TUBO GRADUADO TRANSLUCIDO AFORADO-SUBDIVIDIDO EN DECIMAS DE ml-FILTRO HIDROFOBICO QUE PERMITE EL PASO DEL AIRE FILTRADO PARA EQUILIBRAR LA PRESION INTERNA CON LA PRESION EXTERNA-ADAPTABLE A EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS. ESTERIL Y LIBRE DE LATEX. SITIO DE INYECCION. DISPOSITO LIQUIDOS ENDOVENOSOS. USO- PARA LA ADMINISTRACION DE UN VOLUMEN DE LIQUIDOS ESPECIFICO EN UN TIEMPO DADO EN ml/hora.
2584170	42221902	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BURETA SENCILLA FOTOSENSIBLE 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	BURETA SENCILLA 150CC. BURETRA CON DISPOSITIVO DE PERFORACION CON PROTECTOR. TUBO GRADUADO TRANSLUCIDO CON ESCALA VOLUMETRICA DE 1 ml CON ESPIGA CONECTORA DE CODIGO AGUDA Y PROTECTOR. SITIO DE INYECCION. CON FILTRO DE FLUIDOS DISPOSITO DE INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS. BOLSA DE LIQUIDOS Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CON PROTECCION FOTOSENSIBLE. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. USO UNICO
2502499	42231502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE GASTROSTOMIA 24 FR	CANULA-SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR. SONDA DE RECAMBIO PARA LA ADMINISTRACION DE NUTRICION- LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS AL ESTOMAGO EN PACIENTES QUE NO SON FISISAMENTE CAPACES DE REALIZAR LA MASTICACION Y DEGLUCION NORMALES DE LA INGESTA NUTRICIONAL.MATERIAL 100 % DE SILICONA DE USO MEDICO PERMITE UTILIZAR CUALQUIER CONECTOR ESCALONADO DE NUTRICION Y JERINGA. DISCO DE RETENCION EXTERNO QUE MANTIENE EL TUBO EN SU POSICION Y CON PERFORACIONES QUE PERMITEN LA CIRCULACION DE AIRE ALREDEDOR DEL ESTOMA. BALON DE RETENCION INTERNO QUE GARANTIZA UN SELLO COMPLETO Y EVITA

								FILTRACIONES DEL CONTENIDO GASTRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500123	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION CURVA ENISA 4FR E/BIPOLAR-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER ABLACION. DE CURVA ENISA CON DEFLECCION DE LA CODIGO. ELECTRODOS BIPOLAR. DIAMETRO 4 FRENCH. CON IRRIGACION Y TERMOCUPULA. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL- TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. CON SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA.
2500265	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION CURVA ENISA 4FR E/HEXAP	CATETER ABLACION- DE CURVA ENISA- DE ELECTRODOS HEXAPOLAR- DE DIAMETRO 4 FRENCH- CON IRRIGACION- Y CON TERMOCUPLA
2500140	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION CURVA ENISA 5 FR E/CUAD	CATETER ABLACION. DE CURVA ENISA CON DEFLECCION DE LA CODIGO. ELECTRODOS BIPOLAR. DIAMETRO 5 FRENCH. CON IRRIGACION Y TERMOCUPULA. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL- TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. CON SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA
2500144	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION DE MULTI CURVA	CATETER ABLACION. DE MULTI CURVA. ELECTRODOS BIPOLAR. DIAMETRO 7 FRENCH. SIN IRRIGACION NI TERMISOR. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL. TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. CON SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA
2500138	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION ELECTRODO CUADRIPOLAR 5FR	CATETER ABLACION. DE CURVA ENISA. ELECTRODOS CUADRIPOLAR CON ELECTRODO EN CUERPO DEL CATETER. DIAMETRO 5 FRENCH. IRRIGACION TERMOCUPLA. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL. TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA.
2500264	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION-CURVA BI DIRECCIONAL	CATETER ABLACION- DE CURVA BIDIRECCIONAL- DE ELECTRODOS HEXAPOLAR- DE DIAMETRO CON IRRIGACION- Y SIN TERMISOR
2500035	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION- DE CURVA ENISA 6FR- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER ABLACION- DE CURVA ENISA- DE ELECTRODOS HEXAPOLAR- DE DIAMETRO FR 6 FRENCH- CON IRRIGACION- Y CON TERMOCUPLA
2500034	42203416	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ABLACION- DE CURVA ENISA 7FR- ESTERIL-	CATETER ABLACION- DE CURVA ENISA- DE ELECTRODOS BIPOLAR- DE DIAMETRO 7 F RENCH- CON IRRIGACION- Y CON TERMOCUPLA

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2502872	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CENTRAL 7.5 FR TRILUMEN ACCESO VENA DIFICIL	CATETER PARA VENA CENTRAL DE TRES LUMEN ELABORADO EN POLIURETANO- CON GUIA DE ALAMBRE Y AGUJA QUE FACILITA EL ACESO VENOSO. DESCARTA RADIOPACO
2502308	42221500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER ARTERIAL TIPO LEADER EN POLIURETANO TRANSPARENTE- 20GX8cm	CATETER ARTERIAL DE POLIURETANO TRANSPARENTE. LINEAS RADIOPACAS. CON CENTRO ROJO. TIPO BLISTER. CON VIA DE COLOCACION CATETER ARTERIAL RADIAL. CATETER ARTERIAL FEMORAL. TRANSPARENTE CON AGUJA DE CODIGO GUIA RECTA VAINA PROTECTORA
2587223	42203502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER BIPOLAR MARCAPASOS TEMPORAL	CATETER BIPOLAR PARA MARCAPASOS DIRIGIDO POR TORSION LO QUE PROPORCIONA UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD Y ESTABILIDAD MECANICA. DIAMETRO- 5 FR LONGITUD DEL CATETER- 110 cm ANCHO DEL ELECTRODO- 2 mm DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS- 10 mm DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS- 25 mm USO- PEDIATRICO
2500191	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CENTRAL EPICUTANEO NEONATAL 24G-2FR- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA EPICUTANEO NEONATAL 24G 2FR. MATERIAL SILICONADO. ESTERIL. CATETER EPICUTANEO CAVA EN SILICONA PARA NEONATOS. PREMATUROS O RECIEN NACIDOS.
2502693	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CENTRAL INSERCION PERIFERICA MONOLUMEN 16 G	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA MONOLUMEN.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO.CON CODIGO FLEXIBLE. 16 G. BIOCOMPATIBLE-BLANDO- FLEXIBLE- CON CONEXIONES LUER (HEMBRA)- TOTALMENTE RADIOPACO-MARCACION CENTIMETRICA CADA 5 cmS Y CON UN PROLONGADOR INTEGRADO DE 9 cmS DE LONGITUD- POSEE UN ESTILETE METALISO INTERNO- PARA GARANTIZAR LA RIGIDEZ DEL CATETER Y CON ESTO FACILITAR SU INSERCION. CONTIENE 1 CATETER RADIOPACO MONOLUMEN CON PROLONGADOR INTEGRADO- ALAS DE FIJACION Y ESTILETE O MANDRIL INTERNO. 1 CANULA INTRODUCTORA CORTO PELABLE. 1 CINTA METRISA. 1 DISPOSITIVO PARA FIJACION. 1 JERINGA

2502309	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA PISc- DE 1 VIA- FR 28G X 20 cmS- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA. PISC. DE 1 VIA. FR 28G X 20cmS. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO- BIOCOMPATIBLE. LARGO Y FLEXIBLE CON CONCECTOR SIN AGUJA Y TAPA DESINFECTANTE EN EL EXTREMO. USO UNICO
2500192	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CENTRAL 7.0 FR BILUMEN ACCESO VENA DIFICIL PVC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7.0 FR ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX- KIT COMPUESTO POR 01 CATETER BILUMEN (7.0 FR X 20cm). 01 AGUJA DE 18G 68mm LONGITUD- 01 GUIA NITINOL EN J- 01 DILATADOR DE 10cm. 01 BISTURI. 01 ALA DE FIJACION SECUNDARIA. 01 JERINGA 5ml. 02 TAPON DE MEMBRANA PARA INYECCIONES Y 01 INSERTO). CATETER ANTIMICROBIANO QUIMICO. PAQUETE ESTERIL CON INDICACION SIMBOLOS LOTE.FECHA VENCE Y CONSERVACION
2501028	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CENTRAL INSERCION PERIFERICA MONOLUMEN	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA MONOLUMEN. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE. CON MARCACION CENTIMETRICA CADA 5cm Y CON UN PROLOGADOR INTEGRADO DE 9cm DE LONGITUD. MONITOREO DE PRESION VENOSA DE ACUERDO CON EL CALIBRE
2504241	42143801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CISTOMETRIA DOBLE LUMEN 9 FR	CATETER DE CISTOMETRIA DE POLIURETANO RADIOPACO GRADUADO DE 9 FR DE DIAMETRO EXTERNO POR 20 O 40 cm DE LONGITUD EN VERSION DE DOBLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION VESICAL O TRIPLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION EN LA VEJIGA Y EL CANAL URETRAL EXTREMO DISTAL CILINDRICO CODIGO RECTA O COLETA CON ORIFICIOS LATERALES
2504118	42143801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CISTOMETRIA DOBLE LUMEN 6 FR	CATETER DE CISTOMETRIA DE POLIURETANO RADIOPACO GRADUADO DE 6 FR DE DIAMETRO EXTERNO POR 45 cm DE LONGITUD EN VERSION DE DOBLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION VESICAL O TRIPLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION EN LA VEJIGA Y EL CANAL URETRAL EXTREMO DISTAL CILINDRICO CODIGO RECTA O COLETA CON ORIFICIOS LATERALES

2504119	42143801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CISTOMETRIA DOBLE LUMEN 7 FR	CATETER DE CISTOMETRIA DE POLIURETANO RADIOPACO GRADUADO DE 7 FR DE DIAMETRO EXTERNO POR 45 cm DE LONGITUD EN VERSION DE DOBLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION VESICAL O TRIPLE LUMEN PARA LA MEDICION TRANSURETRAL DE LA PRESION EN LA VEJIGA Y EL CANAL URETRAL EXTREMO DISTAL CILINDRICO CODIGO RECTA O COLETA CON ORIFICIOS LATERALES
2500033	42203402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER DIAGNOSTICO TIPO PERIFERICO 4 FR- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER DIAGNOSTICO DE TIPO PERIFERICO. CON TORQUE. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL. TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA
2500141	42203402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER DIAGNOSTICO TIPO PERIFERICO 5 FR	CATETER DIAGNOSTICO DE TIPO PERIFERICO. CON TORQUE. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL. TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA
2500437	42203402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER DIAGNOSTICO TIPO PERIFERICO 6 FR- HIDROFILICO SELECTIVO	CATETER HIDROFILICO SELECTIVO. LUMEN AMPLIO. CON DOBLE MALLA METALICA INTERNA. RESISTENTE A PRESIONES ELEVADAS. RECUBRIMIENTO HIDROFILICO DISTAL. TRENZADO INTERNO DE ACERO INOXIDABLE. SUPERFICIE SUAVE Y RADIOPACA
2501123	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 2FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 2 FR LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA ESTAN FABRICADOS EN POLIAMIDA- RADIOPACA Y TIENEN UNA LONGITUD TOTAL DE 80 cm PARA LAS TALLAS 3 A 7FR Y UNA LONGITUD TOTAL DE 60 cm PARA LA TALLA 2FR. CUENTA CON UN MONOLUMEN- CONECTOR LUER LOCK Y UN GLOBO LISO DE LATEX. LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA SE SUMINISTRAN CON UN ESTILETE DE INTRODUCCION Y UNA JERINGA DESECHABLE DE 3 ml EMPAQUE INVIDUAL ESTERIL
2501124	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 4FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 4FR LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA ESTAN FABRICADOS EN POLIAMIDA- RADIOPACA Y TIENEN UNA LONGITUD TOTAL DE 80 cm PARA LAS TALLAS 3 A 7FR Y UNA LONGITUD TOTAL DE 60 cm PARA LA TALLA 2FR. CUENTA CON UN MONOLUMEN- CONECTOR LUER

								LOCK Y UN GLOBO LISO DE LATEX. LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA SE SUMINISTRAN CON UN ESTILETE DE INTRODUCCION Y UNA JERINGA DESECHABLE DE 3 ml EMPAQUE INVIDUAL ESTERIL
2501125	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 5FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 5FR LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA ESTAN FABRICADOS EN POLIAMIDA- RADIOPACA Y TIENEN UNA LONGITUD TOTAL DE 80 cm PARA LAS TALLAS 3 A 7FR Y UNA LONGITUD TOTAL DE 60 cm PARA LA TALLA 2FR. CUENTA CON UN MONOLUMEN- CONECTOR LUER LOCK Y UN GLOBO LISO DE LATEX. LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA SE SUMINISTRAN CON UN ESTILETE DE INTRODUCCION Y UNA JERINGA DESECHABLE DE 3 ml EMPAQUE INVIDUAL ESTERIL
2501126	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 3FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL MONOLUMEN 3FR LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA ESTAN FABRICADOS EN POLIAMIDA- RADIOPACA Y TIENEN UNA LONGITUD TOTAL DE 80 cm PARA LAS TALLAS 3 A 7FR Y UNA LONGITUD TOTAL DE 60 cm PARA LA TALLA 2FR. CUENTA CON UN MONOLUMEN- CONECTOR LUER LOCK Y UN GLOBO LISO DE LATEX. LOS CATETERES DE EMBOLECTOMIA SE SUMINISTRAN CON UN ESTILETE DE INTRODUCCION Y UNA JERINGA DESECHABLE DE 3 ml EMPAQUE INVIDUAL ESTERIL
2501127	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 4FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 4FR.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. RADIOPACO.LONGITUD DEL CATETER ENTRE 60-80cmS.BALON EL CATETER DE EMBOLECTOMIA DE UN SOLO LUMEN CONSISTE EN LATEX- FIJADO CON LIGADURAS A UN EJE RADIOPACO DE UN SOLO LUMEN DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA. UN CONECTOR DE BLOQUEO LUER PROXIMAL- TAMBIEN HECHO DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA- SE CONECTA A UNA JERINGA- QUE SE UTILIZARA PARA INFLAR EL BALON.
2501128	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 5FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 5FR.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. RADIOPACO.LONGITUD DEL CATETER ENTRE 60-80cmS.BALON EL CATETER DE EMBOLECTOMIA DE UN SOLO LUMEN CONSISTE EN LATEX- FIJADO CON LIGADURAS A UN EJE RADIOPACO DE UN SOLO LUMEN DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA. UN CONECTOR DE BLOQUEO LUER PROXIMAL-

								TAMBIEN HECHO DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA- SE CONECTA A UNA JERINGA- QUE SE UTILIZARA PARA INFLAR EL BALON.
2503597	42203425	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EMBOLECTOMIA MONOLUMEN 3FR	CATETER DE EMBOLECTOMIA ARTERIAL BILUMEN 3FR.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. RADIOPACO.LONGITUD DEL CATETER ENTRE 60-80cmS.BALON EL CATETER DE EMBOLECTOMIA DE UN SOLO LUMEN CONSISTE EN LATEX- FIJADO CON LIGADURAS A UN EJE RADIOPACO DE UN SOLO LUMEN DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA. UN CONECTOR DE BLOQUEO LUER PROXIMAL-TAMBIEN HECHO DE BLOQUE DE POLIETER AMIDA- SE CONECTA A UNA JERINGA- QUE SE UTILIZARA PARA INFLAR EL BALON.
2502423	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER EPIDURAL X 26G EN POLIAMIDA	CATETER EPIDURAL X 26G- EN POLIAMIDA- QUE PERMITE FACIL MANIPULACION Y FACIL AVANCE HACIA EL ESPACIO EPIDURAL. CON GUIA INTRODUCTORI LATERALES
2504249	42181903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	GLN	A.02.02.01.003.006	CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TRANSITORIO DE 7 FR CON LONGITUD DE 110 cm. PARA DIAGNOSTICO Y ESTIMULACION TEMPORAL DEL CORAZON	CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TRANSITORIO DE 7 FR CON LONGITUD DE 110 cm. PARA DIAGNOSTICO Y ESTIMULACION TEMPORAL DEL CORAZON.
2504594	42181903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL LONG 80cm X DIAMETRO 4 FR CON BALON EN LA PUNTA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	CATETER TIPO FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL- DE UN LUMEN-LONGITUD 80cm X DIAMETRO 3 FR CON BALON EN LA CODIGO- CON M FORMATUBULAR EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO- POLICARBONATO)-ACONDISIONADO CO ADAPTADOR LUER LOCK. ESTILETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO SI

2504123	42181903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL LONGITUD 80cmXDIAMETRO 4 FR CON BALON EN LA PUNTA.ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER TIPO FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL- DE UN LUMEN-LONGITUD 80cm X DIAMETRO 4 FR CON BALON EN LA CODIGO- CON FORMA TUBULAR EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO- POLICARBONATO)-ACONDISIONADO CO ADAPTADOR LUER LOCK. ESTILETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO SI
2504124	42181903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 80cm X 5 FR CON BALON EN LA PUNTA UNIDAD	CATETER FOGARTY DE OCLUSION PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 80cm X 5 FR CON BALON EN LA CODIGO UNIDAD
2501039	42295503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER IMPLANTABLE PARA QUIMIOTERAPIA	CATETER IMPLANTABLE PARA QUIMIOTERAPIA. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. CON RESERVORIO DE ACCESO DE 6.5 FR. CATETER CON CONECTOR PARA LAV 2. SONDA DE PLASTICO DELGADA Y FLEXIBLE.
2501035	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICA BILUMEN 4-5FR	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICO BILUMEN 4.5 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL CONSTA DE 01 CATETER BI-MULTILUMEN 4.5 FR X 20 cm POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX - 01 GUIA CON MARCAS. 01 AGUJA INTRODUCTORIA EXTREMO EN "J" CODIGO RECTA SUAVE. 01 AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION. 01 JERINGA INTRODUCTORIA. 02 DILATADOR DE TEJIDOS. OBTURADOR ANTIPOLVO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OXIDO ETILENO. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2501034	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICA BILUMEN 4FR	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICO BILUMEN 4FR. EMPAQUE INDIVIDUAL CONSTA DE 01 CATETER BI-MULTILUMEN 4FR X 20 cm POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX - 01 GUIA CON MARCAS. 01 AGUJA INTRODUCTORIA EXTREMO EN "J" CODIGO RECTA SUAVE. 01 AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION. 01 JERINGA INTRODUCTORIA. 02 DILATADOR DE TEJIDOS.

								OBTURADOR ANTIPOLVO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OXIDO ETILENO. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2501037	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICA BILUMEN 5.5 FR	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICO BILUMEN 5.5 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL CONSTA DE 01 CATETER BI-MULTILUMEN 5.5 FR X 20 cm POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX. 01 GUIA CON MARCAS. 01 AGUJA INTRODUCTORIA EXTREMO EN "J" CODIGO RECTA SUAVE. 01 AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION. 01 JERINGA INTRODUCTORIA. 02 DILATADOR DE TEJIDOS. OBTURADOR ANTIPOLVO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OXIDO ETILENO. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2501036	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICA BILUMEN 5 FR	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICO BILUMEN 5 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL CONSTA DE 01 CATETER BI-MULTILUMEN 5 FR X 20 cm POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX. 01 GUIA CON MARCAS. 01 AGUJA INTRODUCTORIA EXTREMO EN "J" CODIGO RECTA SUAVE. 01 AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION. 01 JERINGA INTRODUCTORIA. 02 DILATADOR DE TEJIDOS. OBTURADOR ANTIPOLVO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OXIDO ETILENO. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2501033	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERC ADULTO BILUMEN 7FR	CATETER KIT INSERCION PEDIATRICO BILUMEN 7 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL CONSTA DE 01 CATETER BI-MULTILUMEN 7FR X 20 cm POLIURETANO RADIOPACO LIBRE DE LATEX. 01 GUIA CON MARCAS. 01 AGUJA INTRODUCTORIA EXTREMO EN "J" CODIGO RECTA SUAVE. 01 AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION. 01 JERINGA INTRODUCTORIA. 02 DILATADOR DE TEJIDOS. OBTURADOR ANTIPOLVO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OXIDO ETILENO. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2501030	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERC ADULTO TRILUMEN 7.5FR	CATETER KIT INSERCION ADULTO TRILUMEN 7.5 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE. GUIA DE ALAMBRE DE ACERO CON MARCADO CENTIMETRICO Y ECG. CODIGO BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION EN EL OTRO.

2501029	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERC ADULTO TRILUMEN 7FR	CATETER KIT INSERCION ADULTO TRILUMEN 7FR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE. GUIA DE ALAMBRE DE ACERO CON MARCADO CENTIMETRICO Y ECG. CODIGO BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION EN EL OTRO
2501032	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERC ADULTO TRILUMEN 8.5FR	CATETER KIT INSERCION ADULTO TRILUMEN 8.5 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE. GUIA DE ALAMBRE DE ACERO CON MARCADO CENTIMETRICO Y ECG. CODIGO BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION EN EL OTRO
2501031	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER KIT INSERC ADULTO TRILUMEN 8FR	CATETER KIT INSERCION ADULTO TRILUMEN 8 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE. GUIA DE ALAMBRE DE ACERO CON MARCADO CENTIMETRICO Y ECG. CODIGO BLANDA RECTA EN UN EXTREMO Y AGUJA INTRODUCTORA DE PRESION EN EL OTRO
2504125	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PARA LAVADO ALVEOLAR 16 FR NO BRONCOESCOPISO CATÈTER TELESCOPADO	CATETER PARA LAVADO ALVEOLAR NO BRONCOESCOPISO CATÈTER TELESCOPADO-PUERTO DE IRRIGACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL- CON PUERTO PÀRA ADMINISTRACION DE OXIGENO A BAJO FLUJO. ESTERIL
2501040	42221501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PARA LINEA ARTERIAL 20G. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER PARA LINEA ARTERIAL 20G. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. GUIA METALICA DE 10 - 30cmS. CATETER 20G CON MECANISMO DE FIJACION. FUNDA PARA CODIGO. AGUJA ECOGENISA E INTRODUCTORA. ESTERIL. LIBRE DE LATEX
2584045	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL N° 18- ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIUAL	EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXI SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2584086	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL N° 19- ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIUAL	EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXI SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2584089	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL N° 20- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIUAL	EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXI SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2584097	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL N° 22- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIUAL	EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXI SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501156	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL NO.21. ESTERIL. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER PERICRANEAL N° 21 EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXICO SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL AGUJA AFILADA Y CODIGO CON DISEÑO BISELADO- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501212	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL NO.23. ESTERIL. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER PERICRANEAL N° 23 EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXICO SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL AGUJA AFILADA Y CODIGO CON DISEÑO BISELADO- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501213	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERICRANEAL NO.25. ESTERIL. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER PERICRANEAL N° 25 EQUIPO DE VENOPUNCION PARA INYECCION A CORTO PLAZO DE FLUIDOS- FARMACOS Y TRANSFUSIONES ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. TUBO FABRICADO EN PVC GRADO MEDICO- NO TOXICO SILICONIZADO.CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACION DE CALIBRE. CONEXION LUER LOCK- ESTERIL AGUJA AFILADA Y CODIGO CON DISEÑO BISELADO- EMPAQUE INDIVIDUAL
2500558	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO 16 G	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO N° 16- ELABORADO EN POLIAMIDA NO-REACTIVO- POLIURETANO O SILICONA- COEFICIENTE DE PROFUNDIDAD- RADIOPACO DE EXTREMIDAD ABIERTA O CERRADA - TRES ORIFICIOS LATERALES PARA PERFUSION- CON GRADUACIONES CENTIMETRICAS

2502864	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO 17 G	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO N° 17- ELABORADO EN POLIAMIDA NO-REACTIVO- POLIURETANO O SILICONA- QUIMICAMENTE INERTE- COEFICIENTE DE PROFUNDIDAD- RADIOPACO. DE EXTREMIDAD ABIERTA O CERRADA CON TRES ORIFICIOS LATERALES- CON MARCAS DESDE LOS CINCO HASTA LOS VEINTEC DIAMED
2500559	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO 18 G	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO N° 18- ELABORADO EN POLIAMIDA NO-REACTIVO- POLIURETANO O SILICONA- COEFICIENTE DE PROFUNDIDAD- RADIOPACO DE EXTREMIDAD ABIERTA O CERRADA - TRES ORIFICIOS LATERALES PARA PERFUSION- CON GRADUACIONES CENTIMETRICAS
2502865	42142509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO 20 G-CON JERINGA DE 10 cc	CATETER PERIDURAL/EPIDURAL ADULTO N° 20- ELABORADO EN POLIAMIDA NO-REACTIVO- POLIURETANO O SILICONA- QUIMICAMENTE INERTE- COEFICIENTE DE PROFUNDIDAD- RADIOPACO. DE EXTREMIDAD ABIERTA O CERRADA CON TRES ORIFICIOS LATERALES- CON MARCAS DESDE LOS CINCO HASTA LOS VEINTE cm DE DIAMETRO
2500194	42295601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER PROXIMAL VENTRAL PARA VALVULA PARA HIDROCEFALIA	CATETER DE TUBO PLASTICO PROXIMAL VENTRICULAR PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA CON CUBIERTA CON CAMARA INCLUIDA PERMITIENDO EL FLUJO DE LIQUIDOS
2501041	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER SUBCLAVIO PEDIATRICO MONOLUMEN 22-GA	CATETER SUBCLAVIO PEDIATRICO. MONOLUMEN. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CODIGO FLEXIBLE- CON FIJACION Y PROLONGADOR INTEGRADO DE 4.5 cm DE LONGITUD. AGUJA DE CODIGO 21 G. 42mm DE LONGITUD. GUIA METALICA RECTA DIAMETRO 0.46 mm-LONGITUD DE 23 Y 26 cm. CON VAINA PROTECTORA.
2501038	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER SUBCLAVIO PEDIATRICO MONOLUMEN 20GA	CATETER SUBCLAVIO PEDIATRICO. MONOLUMEN. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO RADIOPACO. CON CODIGO FLEXIBLE-CON FIJACION Y PROLONGADOR INTEGRADO DE 4.5 cm DE LONGITUD. AGUJA DE CODIGO 20 G. 42 mm DE LONGITUD. GUIA METALICA RECTA-DIAMETRO 0.46 mm CON UNA LONGITUD DE 23 Y 26 cm. CON VAINA PROTECTORA.
2587224	42221506	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UMBILICAL DE 3	CATETER DE VASOS UMBILICALES DE ALTA RESISTENCIA EN POLIURETANO DE 1-2 Y 3

							LUMEN EN POLIURETANO	LUMENES- TRANSPARENTE CON LINEAS RADIOPACAS- EXTREMIDAD DISTAL BISELADA
2504617	42221506	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UMBILICAL NEONATAL MONOLUMEN 3.5F	EL CATETER PARA VENAS Y ARTERIAS UMBILICALES DE UN LUMEN PERMITE UN MONITOREO DE PRESION CONTINUO MIENTRAS SE ADMINISTRAN MEDISAMENT DISEÑADOS PARA FACILIDAD DE INSERCION- SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PACIENTE. - CODIGOS REDONDEADAS PARA REDUCIR RIESGOS DE PERFORACION- C
2504126	42294212	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER URETERAL PUNTA CONICA UNIDAD	CATETER URETERAL CODIGO CONICA FLEXIBLE Y CUERPO DE CATETER RIGIDO DE 2MM Y 70cm DE LONGITUD
2500193	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO AVANZADO TRILUMEN 8.5FR- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER VENOSO AVANZADO TRILUMEN 8.5FR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. ELABORADO EN POLIURETANO DE 8.5 FR. CON INSERCION SOBRE GUIA Y AGUJA. RECTO O CURVO. USO UNICO.
2502310	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CENTRAL 7.5FR BILUMEN PVC	CATETER VENOSO CENTRAL 7.5FR BILUMEN. ELABORADO EN PVC O POLIURETANO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. CON AGUJA INTRODUCTORA PARA EVITAR EMBOLIA
2502866	42221503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16 G 7F	CATETER VENOSO CENTRAL ELABORADO EN SILICONA- POLIETILENO O POLIPROPILE- NO-BIOCOMPATIBLE- BLANDO- FLEXIBLE- RADIOPACO- CON MARCAS ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502723	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO PERIFERICO POLIURETANO 18G X 1 1/4 CON SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO PERIFERICO DISEÑADO EN POLIURETANO 18G X 1 1/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD- TROMBORRESISTENTE- TERMOSENSIBLE- CON MEMORIA ELASTOMERICA- RADIOPACO- BIOCOMPATIBLE OBSERVACION INMEDIATA DEL RETORNO VENOSO. CONECTOR LUER LOK DEL ADAPTADOR (LIBRE DE DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES). EMPAQUE TIPO BLISTER DE SEGURIDAD
2502724	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO PERIFERICO POLIURETANO 20G X 1 1/4PULGADA CON SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO PERIFERICO DISEÑADO EN POLIURETANO 20G X 1 1/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD- TROMBORRESISTENTE- TERMOSENSIBLE- CON MEMORIA ELASTOMERICA- RADIOPACO- BIOCOMPATIBLE OBSERVACION INMEDIATA DEL RETORNOVENOSO. CONECTOR LUER LOK DEL ADAPTADOR (LIBRE DE DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES). EMPAQUE TIPO BLISTER DE SEGURIDAD

2500208	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 14G X 1 3/4PULGADA- CON SISTEMA DE SEGURIDAD- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 14G X 1 3/4". USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA- CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500209	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 16G X 1 1/4 CON SISTEMA DE SEGURIDAD- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 16G X 1 ¼. USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA- CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500210	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 16Gx1 1/4PULGADA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD- EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 16G X 1 ¼. USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500211	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO DE 1 VIA 18G x 1 1/4PULGADA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 18G X 1 ¼. USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA- MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500212	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO PERIFERICO N 18 G X 1 1/4PULGADA. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 18G X 1 ¼. USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA-QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA. Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION

2500218	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 20Gx1PULGADA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 20G X 1". USO UNICO-EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA-CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE- FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500213	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 20G X 1 1/4PULGADA. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 20G X 1 ¼. USO UNICO-EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA. Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500215	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 22Gx1PULGADA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 22G X 1 ". USO UNICO-EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA-CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500214	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO PERIFERICO N 22 G X 1PULGADA. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 22G X 1 ". USO UNICO-EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA. Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500217	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1 VIA 24G X 3/4PULGADA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 24G X 3/4". USO UNICO-EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA-CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE- FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION

2500216	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 24G x 3/4PULGADA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 24G X 3/4 ". USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500219	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO LARGO 1 VIA 14GX2PULGADA INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 14G X 2 ". USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA- - QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500220	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO LARGO 1VIA 16Gx2PULGADA INDIVIDUAL	CATETER INTRAVENOSO N 16G X 2 ". USO UNICO- EN POLIURETANO FLEXIBLE ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO- LIBRE DE PIROGENOS- LIBRE DE LATEX MATERIAL BIOCOMPATIBLE. AGUJA TRIBISELADA O PENTABISELADA-QUE CONSTA DE TRES PARTES- CATETER- AGUJA Y/O CANULA Y SISTEMA DE CONECCION LUER LOCK. IMPRESION SIMBOLOS-LOTE FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500223	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 16G CON SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO DE TEFLON CORTO 1 VIA 16G. CON SISTEMA DE SEGURIDAD. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CON CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500222	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 16G EMPAQUE INDIVIDUAL. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 16G. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO.

								EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500221	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 14G EMPAQUE INDIVIDUAL.	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 14G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MERDISO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500224	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 18G SIN SISTEMA DE SEGUIR DAD	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 18G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO.EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500225	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 20G EMPAQUE INDIVIDUALSIN SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 20G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500227	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 22G- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. SIN SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 22G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE

								INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500226	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 24G- EMPAQUE INDIVIDUAL SIN SISTEMA DE SEGURIDAD	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 24G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500228	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO CORTO 1VIA 14G EMPAQUE INDIVIDUAL.	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 14G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CON CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2500229	42221504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER VENOSO TEFLON LARGO 1VIA 16G- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. SSS	CATETER VENOSO TEFLON CORTO 1 VIA 16G. TEFLON POLIURETANO ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIROGENOS AGUJA EN ACERO QUIRUGICO. AGUJA LUBRICADA CON SILICONA GRADO MEDICO CON CONTRASTE RADIOPACO CONEXION LUER. CONSTA DE UNION AGUJA Y TEFLON CAMARA DE RETORNO ALETAS LUER CON SUJECION ERGONOMICA. FILTRO HIDROFOBICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ENVASE O VAINA. IMPRESION SIMBOLOS LOTE Y FECHA VENCIMIENTO Y CONSERVACION
2504940	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CONECTOR ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA	CONECTOR DE ACCESO INTRAVENOSOS SIN AGUJA ESTERIL DE UNICO USO EN POLICARBONATO RESISTENTE A LIPIDOS Y SILICONA SIN COMPONENTES DE METAL
2500650	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CONECTOR SISTEMA CERRADO CON AGUJA MACRO- DE UNA SOLA	CONECTOR LIBRE DE AGUJA DISEÑADO PARA TERAPIA INTRAVENOSA INTERMITENTE Y/O CONTINUA Y ASPIRACION. DE USO UNICO. LIBRE DE LATEX. EMPAQUES INDIVIDUALES. MANTENERSE EN UN LUGAR LIMPIO- FRIO Y SECO.

							PIEZA CON SELLO DE SILICONA- LIBRE DE LATEX. EMPAQUE INDIVIDUAL	
2500651	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CONECTOR SISTEMA CERRADO CON AGUJA MICRO- DE UNA SOLA PIEZA CON SELLO DE SILICONA- LIBRE DE LATEX. EMPAQUE INDIVIDUAL	VALVULA DE SEGURIDAD SIN AGUJA CON CIERRE AUTOMATICO SINO ESTA EN USO. UNA SOLA PIEZA. CON SELLO DE SILICONA. LIBRE DE LATEX O METALES.
2502561	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CONECTOR DE BAJA PRESION	TUBO CONECTOR DE PVC DE BAJA PRESION PARA INYECTOR DE MATERIAL DE CONTRASTE Y SOLUCIONES COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE INYECTORES DE RESONANCIA MAGNETISA Y TOMOGRAFIA. ESTERIL Y DESECHABLE.
2584185	42142620	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO ACCESO INFUSION INTRAOSEA MANUAL PEDIATRICO	DISPOSITIVO DE ACCESO CON AGUJA PARA INFUSION INTRAOSEA MANUAL PEDIATRICO EXISTEN 2 FORMATOS- UNO PEDIATRICO (ROJO)- QUE PERMITEN LA INSERCION RAPIDA DE UN CATETER DE 18 G O 15 G- RESPECTIVAMENTE- Y CON CAPACIDAD PARA REGULAR LA PROFUNDIDAD DE DISPARO (ADULTOS MAXIMO 2-5 cm Y NIÑOS 1-5 cm MAXIMO)
2502936	42142620	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO AUTOMATICO DE INSERCION DE AGUJAS INTRAOSEAS. CON AGUJA PARA PUNCION INTRAOSEA- CON ESTILETE- BISEL CORTO Y MULTIPERFORA	DISPOSITIVO AUTOMATICO DE INSERCION DE AGUJAS INTRAOSEAS. CON AGUJA PARA CODIGO INTRAOSEA 15G-18G
2504205	42293107	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO MEDICO PARA SEPARACION DE TEJIDOS	DISPOSITIVO MEDICO PARA SEPARACION DE TEJIDOS. EN ACERO INOXIDABLE. CON ARO FLEXIBLE PARA INSERCION

							CON ARO FLEXIBLE PARA INSERCION. INCSIONES DE 5-9 cm UNIDAD	
2584189	42181516	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROMIOGRAFIA- CON UN CONDUCTOR IMPRESO DE PLATA	ELECTRODO AUTOADHESIVO PARA ELECTROMIOGRAFIA. CON UN CONDUCTOR IMPRESO DE PLATA. FLEXIBLE. DURABLE.
2500339	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPATE MACHO MACHO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MATERIAL PVC. EMPATE UNIVERSAL.
2500349	42222301	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE COMPONENTES SANGUINEOS 15 GOTAS/ml. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO PLASTICO GRADO MEDICO. TRANSLUCIDO. FLEXIBLE. EN UN EXTREMO CON PROTECTOR DEL ADAPTADOR LUER. CON ADAPTADOR LUER AL CATETER. LLAVE REGULADORA. MANGUERA CONDUCTORA. CAMARA DE GOTEO EN PVC CON FILTRO. CODIGOZON. PROTECTOR DEL CODIGOZON. EMPAQUE TIPO BLISTER.
2500341	42222301	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE BOMBA INFUSION 250cm	EQUIPO PLASTICO GRADO MEDICO. TRANSLUCIDO. FLEXIBLE. EN UN EXTREMO CON PROTECTOR DEL ADAPTADOR LUER. CON ADAPTADOR LUER AL CATETER. LLAVE REGULADORA. MANGUERA CONDUCTORA. CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON FILTRO. CODIGOZON. PROTECTOR DEL CODIGOZON. CLIP DE SUJECION ESTERILES. DESECHABLES. LIBRES DE LATEX Y DEHP
2584190	42293501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y EN PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION DE SOLUCIONES EN PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS. EQUIPO CON DOS CODIGOZONES Y ADAPTADOR A CATETER-ELABORADO EN FLUJO- CAMARA DE GOTEO CON LINEA DE LLENADO- ESTERIL- LIBRE DE PIROGENOS. EMPAQUE INDIVIDUAL
2500340	42222008	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO BOMBA ADMINISTRACION DE	EQUIPO CON BOMBA Y VALVULA DE MEDICACION SECUNDARIA. EN PVC GRADO MD. VALVULA DE CERRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.

							MEDICAMENTOS EN BOLO CON VALVULA	
2584096	42222008	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO BOMBA DE INFUSION. LLAVE REGULADORA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO BOMBA DE INFUSION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.LLAVE REGULADORA SEGURA.MATERIAL FLEXIBLE CONECTOR QUE EVITE FUGAS CLAMP DE SEGURIDAD COMPATIBLECON LAS BOMBAS EXISTENTESEN LA INSTITUCION
2500667	42222008	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL CON PUNZON	SET DE INFUSION ES UN EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES DE NUTRICION ENTERAL CON CODIGOZON TIPO ESPIGA. CUBIERTA AJUSTABLE AL PIN PERFORADOR. CAMARA DE VISUALIZACION. CONECTOR ESTERIL. APTO PARA UTILIZAR CON NUTRICION PRE ENVASADA
2500356	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER	FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO. CON DISPOSITIVO DE PERFORACION - TERMINADO EN CODIGO FORMA DE BISEL CON PROTECTOR DE LA ESPIGA. MANGUERA EN PVC MEDICO. FLEXIBLE. LLAVE REGULADORA. ADAPTADOR UNIVERAL LUER SLIP. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO
2500654	42222008	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE BOMBA INFUSION RADIOPACO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE. (MANGUERA FOTOPROTECTORA). LIBRE DE PVC. DEHP Y LATEX. CON CASSETTE DE CONTROL DE FLUIDOS. EMPAQUE INDIVIDUAL. MANTENER EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
2500342	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE MACROGOTEO CON AGUJA 175 cm- UNIDAD-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO CON AGUJA- DE 175 cm GOTAS TOTAL APROX 10 FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO- COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION - TERMINADO EN CODIGO FORMA DE BISEL; PROTECTOR DE LA ESPIGA POR SU PARTE MAS ANCHA- FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJAS EN LA MANGUERA FABRICADA DE PVC-FLEXIBLE. EQUIPO PARA INGRESO DE AIRE CON CAMARA DE GOTEO DE 1 GOTAS/CC. – REGULADOR DE FLUJO TIPO RUEDA – TUBOS EN PVC – LIBRE DE LATEX – CON SITIO DE INYECCION EN Y- Y ADAPTADOR

2500343	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE MICROGOTEO CON AGUJA 174 cm- UNIDAD-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO CON AGUJA- DE 174 cm GOTAS TOTAL APROX 10 FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO- COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORA- CION (SPIKE)- TERMINADO EN CODIGO FORMA DE BISEL; PROTECTOR DE SPIKE POR SU PARTE MAS ANCHA- FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJASEN LA MANGUERA FABRICADA DE PVC-FLEXIBLE. EQUIPO PARA INGRESO DE AIRE CON CAMARA DE GOTEO DE 1 GOTAS/CC. – REGULADOR DE FLUJO TIPO RUEDA – TUBOS EN PVC – LIBRE DE LATEX – CON SITIO DE INYECCION EN Y- Y ADAPTADOR
2584037	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER	FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO-COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORA-CION (SPIKE)- TERMINADO EN CODIGO FORMA DE BISEL; PROTECTOR DE SPIKE POR SU PARTE MAS ANCHA- FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJASEN LA MANGUERA FABRICADA DE PVC-FLEXIBLE. EQUIPO PARA INGRESO DE AIRE CON CAMARA DE GOTEO DE 1 GOTAS/CC. – REGULADOR DE FLUJO TIPO RUEDA – TUBOS EN PVC – LIBRE DE LATEX – CON SITIO DE INYECCION EN Y- Y ADAPTADOR
2500673	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO EN Y ADMINISTRACION SOLUCIONES-ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO EN Y PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES. EMPAQUE INDIVIDUAL. ADMINISTRACION SIMULTANEA DE SOLUCIONES. MATERIAL EN PVC GRADO MEDICO. LLAVE REGULADORA DE LLENADO
2500521	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO INFUSION CONTROL ANALGESISO PCA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO INFUSION CONTROL ANALGESISO PCA. RECIPIENTE PLASTICO TRANSPARENTE CON GLOBO O DEPOSITO ELASTOMERISO INTERNO. DE USO UNICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. LIBRE DE LATEX. MATERIAL PVC MEDICO-ESPIGO DE INSERCION PARA BURETA O BLOQUE. SEGUN BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE CON EQUIPO DISPONIBLE
2500545	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO INFUSION DI 100 ADMON RAPIDA DE FLUIDOS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO INFUSION CONTROL ANALGESISO PCA. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. LIBRE DE LATEX. MATERIAL PVC GRADO MEDICO-ESPIGO DE INSERCION PARA BURETA O BLOQUE. LLAVE REGULADORA DE VOLUMEN Y CLAMP DE SEGURIDAD. CODIGO COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE SOLUCIONES SEGUN BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE CON EQUIPO DISPONIBLE.

2502328	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA 10GOT. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO-COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION TERMINADO EN CODIGO FORMA DE BISEL; PROTECTOR DEL BISEL POR SU PARTE MAS ANCHA- FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJAS EN LA MANGUERA FABRICADA DE PVC GRADO MEDICO-FLEXIBLE. EQUIPO PARA INGRESO DE AIRE CON CAMARA DE GOTEO DE 1 GOTAS/CC. – REGULADOR DE FLUJO TIPO RUEDA – TUBOS EN PVC – LIBRE DE LATEX – CON SITIO DE INYECCION EN Y- Y ADAPTADOR
2500345	42231505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO NUTRICION ENTERAL EN PVC GRADO MEDICO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVUAL	EN PVC NO TOXICO Y NO PIROGENISO CON MACRO CAMARA DE GOTEO CODIGO DE PIERCING CON TAPA PROTECTORA CON REGULADOR DE CAUDAL TUBO CON UNA LONGITUD DE 1-5 MTS-REALIZANDO LA CONEXION ENTRE LA SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL CONECTADA AL PACIENTE Y EL RECIPIENTE DE LA SOLUCION QUE CONTIENE EL ALIMENTO A ADMINISTRAR.
2503260	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL- EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL-EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO- LLAVE REGULADORA DE FLUJO SUAVE Y SEGURA- LLAVE DE TRES VIAS INDIVIDUAL
2504614	42231505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO PARA BOMBA INFUSION NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA - ESTERIL	SET BOMBA FREEGO UNIVERSAL -DESCRIPCION-SISTEMA DE ADMINISTRACION PARA BOMBA CON ADAPTADOR UNIVERSAL - CARACTERIS APERTURA DE 40mm - CORTADOR Y FILTRO DE AIRE - UN SOLO USO (DESECHAR DESPUES DE 24 HORAS) – ESTERIL
2584140	42222300	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE DE UN SOLO USO-TUBO FLEXIBLE EN PVC- NO COLAPSABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE DE UN SOLO USO- COMPONENTES- TUBO FLEXIBLE (MANGUERA) EN PVC- NO COLAPSABLE-DISPOSITIVO DE PERFORAC GOTEO EN PVC FLEXIBLE CAMARA CON FILTRO- EN PVC FLEXIBLE TRANSLUCIDO- CON FILTRO DE + O - 200 MICRONES. CON REGULADOR DE FLUJO REGULADOR DE FLUJO EN ABS CON PUERTO DE INYECCION Y CONECTOR LUER LOCK CON AGUJA ADAPATABLE A VARIOS CALIBRES

2500350	42222300	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE SIN AGUJA PVC GRADO MEDICO-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE DE UN SOLO USO- COMPONENTES- TUBO FLEXIBLE (MANGUERA) EN PVC- NO COLAPSABLE- DISPOSITIVO DE PERFORAC GOTEO EN PVC FLEXIBLE CAMARA CON FILTRO- EN PVC FLEXIBLE TRANSLUCIDO- CON FILTRO DE + O - 200 MICRONES. CON REGULADOR DE FLUJO REGULADOR DE FLUJO EN ABS CON PUERTO DE INYECCION Y CONECTOR LUER LOCK SIN AGUJA
2501594	42222300	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPOS PARA LA TRANSFUSION DE PLAQUETAS-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO DESTINADO A LA TRANSFUSION DE PLAQUETAS SIN AGUJA- DESECHABLE-TUBO FLEXIBLE CON FILTRO (MANGUERA) EN PVC- NO COLAPSABLE- DISPOSITIVO DE PERFORAC GOTEO EN PVC FLEXIBLE CAMARA CON FILTRO- EN PVC FLEXIBLE TRANSLUCIDO- CON FILTRO DE + O - 200 MICRONES. CON REGULADOR DE FLUJO REGULADOR DE FLUJO EN ABS CON PUERTO DE INYECCION Y CONECTOR LUER LOCK- ESTERIL EN SUPERFICIES INTERNAS Y AREAS BAJO PROTECTORES- ATOX QUE PERMITA GRADUAR EL PASO DEL COMPONENTE SANGUINEO
2504202	42293501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ESFINTEROTOMO DE PUNTA TRIPLE LUMEN DE DISTAL 5 FR - DE AGUJA PARA PRECORTE- 35GW/5FR- MODELO KD-V441M	ESFINTEROTOMO DE TRIPLE LUMEN CODIGO REDONDEADA 5mm ALAMBRE DE CORTE DE 20mm/ 25mm/ 30mm CON MARCAS DE COLOR DIAMETRO 2.55mm REDONDEADO A 2.05 mm ROTABLE RECURVEADA- PARA CABLE GUIA DE .035 PULGADAS UN SOLO USO- EMPAQUE ESTERILIZADO.
2504254	42293501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ESFINTEROTOMO O PAPILOTOMO DE ARCO TRILUMEN 7 FR	ESFINTEROTOMO O PAPILOTOMO DE ARCO TRILUMEN ESFINTEROTOMIA PRECURVADO. DE ARCO. TRIPLE LUZ. DE 7 FR PARA GUIA DE 0.035". MARCAS DE COLOR. USO UNICO. ESTERIL. CON USO DE CANULACION DEL SISTEMA DUCTAL Y LA ESFINTEROTOMIA
2501946	42293501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	ESFINTEROTOMO TRILUMEN 7FR- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	ESFINTEROTOMO TRILUMEN 7FR.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.PARA USO UNICO DE 7FR/200cmS DE LONGITUD ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO. TODOS LOS COMPONENTES SON ESTERILES
2504698	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION EN Y DE 12PULGADA PARA CONECTAR A BOTON GASTRICO	EXTENSION EN Y DE 12" PARA CONECTAR A BOTON GASTRICO. TUBO PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE DEHP [di-(2-etilhexil) ftalato]. CON MECANISMO CONECTOR DE LLAVE "SECUR-LOK". PUERTO PARA MEDICAMENTOS. ABRAZADERA PARA TUBO. NO ESTERIL.

								DISPOSITIVO DE MEDICION DEL ESTOMA ESTERIL CON RAYOS GAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504699	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION EN Y 24PULGADACONECTAR BOTON GASTRI	EXTENSION EN Y 24"CONECTAR BOTON GASTRICO. TUBO PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE DEHP [di-(2-etilhexil) ftalato]. CON MECANISMO CONECTOR DE LLAVE "SECUR-LOK". PUERTO PARA MEDICAMENTOS. ABRAZADERA OARA TUBO. NO ESTERIL. DISPOSITIVO DE MEDICION DEL ESTOMA ESTERIL CON RAYOR GAMA. EMPAQUE INDIVIDUAL
2503756	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION DE ANESTESIA EN Y LONG 12.3cm-ELABORADA EN POLIURETANO TRANSPARENTE	EXTENSION DE ANESTESIA EN Y LONG 12.3cm-ELABORADA EN POLIURETANO TRANSPARENTE-CON CLAMP INTERRUPTOR DE PASO- CON DOS VIAS
2584171	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION DE ANESTESIA LONGITUD 76-80cm-CONECTOR UNIVERSAL-ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	EXTENSION DE ANESTESIA CON PINZA PLASTICA. CONECTORES LUER LOOK. DESECHABLE. UNIDAD.
2500446	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION DE ANESTESIA LONGITUD 80-90cm	EXTENSION PARA ANESTESIA LONGITUD 80-90 cm. EN MATERIAL PVC. ABS. O POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD- POLIESTER. TUBO DIAMETRO IGUAL A EQUIPO VENOCLISIS CON PINZA ESTRANGULADORA DE CIERRE CONECTOR LUER LOCK. PRESENTACION PAQUETE INDIVIDUAL ESTERIL-ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE.
2500418	41104913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO DESLEUCOCITADOR GLOBULOS ROJOS ADULTO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	FILTRO DESLEUCOCITADOR GLOBULOS ROJOS ADULTO.EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. LIBRE DE PIROGENOS. SIN LATEX DE CAUCHO NATURAL.
2500419	41104913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO DESLEUCOCITADOR PLAQUETAS ADULTO. ESTERIL.	FILTRO DESLEUCOCITADOR PLAQUETAS ADULTO.EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. LIBRE DE PIROGENOS. SIN LATEX DE CAUCHO NATURAL

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504199	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	GUIA DE ALAMBRE HIDROFILICA. FLEXIBLE. RADIOPACA- PARA VIA BILIAR	GUIA HIDROFILICAL DE 0.035" CON LONGITUD MINIMA 4500mm G- G-240-3545S. PARA VIA BILIAR
2504112	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.004.001	GUIA ZEBRA STRAIGHT TIP 0.035in x 150cm	GUIA ZEBRA STRAIGHT TIP 0.035in x 150cm-ALAMBRE HIDROFILICO DE NITINOL CON CUBIERTA RAYADA DISEÑADO PARARA BRINDAR RETROALIMENTACION VISUAL Y MANEJO
2501951	42201809	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	INYECTOR PARA ESCLEROSIS DESECHABLE	INYECTOR PARA ESCLEROSIS DESECHABLE.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.PARA USO UNICO AGUJA DE ESCLEROTERAPIA DE GASTRO PARA REALIZAR HEMOST 200cmS.
2503970	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 0.3ml 3 PARTES CON AGUJA 31GX8mm. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 0.3ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 31Gx8mm- EN ACERO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA
2584763	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 0.5ml 3 PARTES CON AGUJA 25Gx5/8- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL PACK EN PAP	JERINGA DESECHABLE DE 0.5ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 25Gx5/8"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL

								BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. EMPAQUE INDIVIDUAL
2587192	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 0-5ml 3 PARTES CON AGUJA 6X1/25 mm 23 G-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL PACK EN PAPE	JERINGA DESECHABLE DE 0-5 ml AGUJA 0-6X25mm 23GX1"EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO-EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES-EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO-INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA-EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA
2503969	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 0.5ml 3 PARTES CON AGUJA 31GX8mm-LUER LOCK. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 0.5ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR-AGUJA HIPODERMICA 31Gx8mm- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA-CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD-NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584111	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 0.5ml 3 PARTES CON AGUJA 31Gx6mm- LUER lock. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 0.5ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR-AGUJA HIPODERMICA 31Gx6mm- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA-CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA

								ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA
2500001	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 10 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21GX1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL	JERINGA DE 10 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2" - INCORPORADA- TAPA NARANJA. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA
2502242	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 29Gx1/2 INCORPORADA- TAPA NARANJA. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 29G X 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA-- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA

2501270	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 1 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 22Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 22G X1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584761	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 22Gx1 1/4- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 22G X 1/4- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2584760	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 25Gx050x16mm-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR-AGUJA HIPODERMICA 25G X 050X16mm- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA-CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD-NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2500004	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES-CON AGUJA 25GX5/8-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR-AGUJA HIPODERMICA25 GX5/8" - INCORPORADA-TAPA NARANJA. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA- CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2503438	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 26Gx3/8 LUER lock. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 26G X 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2502798	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 26Gx3/8. APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 26G X 3/8"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2503758	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 1ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 29 1X1/2PULGADA- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 29G 1X1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584762	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 30Gx1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2584770	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 27GX1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 27G X 1/2- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584112	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 31Gx6mm- APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 31G X 6"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2503411	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 1/3PULGADA- APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/3"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2502402	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml 3 PARTES CON AGUJA 23Gx1PULGADA APLICACION DE INSULINA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 1ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 29G X 1"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2505563	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 1ml GASES ARTERIA AGUJA23GX25mm	JERINGA 1ml DE TRES PARTES- AGUJA 23Gx25mm- EN ACERO INOXIDEABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO EXACTA PARA RECOLECCION DE GASES ARTER ESCAL HEPAR ANTISOAGULANTE- HEPARINA DE LI CON CA BALANCEADO EN GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2504627	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 1ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 25GX16mm. TOMA DE GASES ARTERIALES. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- TIPO BLISTER PEEL	JERINGA 1ml DE TRES PARTES- AGUJA 25Gx16mm- EN ACERO INOXIDEABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO EXACTA PARA RECOLECCION DE GASES ARTER ESCAL HEPAR ANTISOAGULANTE- HEPARINA DE LI CON CA BALANCEADO EN GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2503780	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 20ml 2 PARTES SIN AGUJA. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 20ml DE 2 PARTES COMPUESTA POR- CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE TIPO LUER EXCENTRICO- ESCALA VOLUMETRICA- CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2502243	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 20 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 20ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2 - EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2502157	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 2 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL	JERINGA DE 2 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21G X1 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2501227	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 3 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 3 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2504628	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 3ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 23GX25mm. TOMA DE GASES ARTERIALES. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- TIPO BLISTER PEEL	JERINGA 3ml DE TRES PARTES- AGUJA 23Gx25mm- EN ACERO INOXIDEABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO EXACTA PARA RECOLECCION DE GASES ARTER ESCAL HEPAR. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- LOTE - REGISTRO INVIMA.
2504666	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 3ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 23GX25mm. TOMA DE GASES ARTERIALES. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- TIPO BLISTER PEEL	LAS JERINGAS SE USAN PARA TOMA DE MUESTRAS EN SANGRE DIRECTAMENTE DE LA LINEA VENOSA O ARTERIAL. EL EMBOLO DE LA JERINGA PUEDE AJUST CAPACIDAD 1 Y 3 ml. ANTISOAGULANTE- HEPARINA DE LI CON CA. MEMBRANA DE VENTILACION EN EL EMBOLO. CODIGO SLIP TIP (1ml). CONECTOR LUER 2017DM-0015812

2584110	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 50 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 50ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2501271	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 50 cc CON ADAPTADOR PARA AGUJA- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 50 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2501228	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 5 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL	JERINGA DE 5 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE

								RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2504382	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 5 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 22GX1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 5ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 22Gx1 1/2mm- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO. CUERPO PLASTICO- EXACTA- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- INCORPORADA- TAPA NARANJA- CON BISELADO PRECISO. CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE CENTRICO- CON DISCO DE EMPUJE- ESCALA VOLUMETRICA VISIBLE (mm-ml) EN TINTA ESPECIAL INDELEBLE- EXACTA- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2502575	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA 60ml 2 PARTES SIN AGUJA- CON PUNTA CATETER- ESTERIL- DE UN SOLO USO	JERINGA DE 60ml SIN AGUJA- DE 2 PARTES COMPUESTA POR- CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO- PIVOTE TIPO LUER LOCK- CENTRICO- ESCALA VOLUMETRICA- CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA
2503704	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 60 ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2PULGADA.	JERINGA DE 60ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO-ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION
2502244	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 60 ml- DE 3 PARTES- CON AGUJA 21Gx1 1/2- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL LUER LOCK	JERINGA DE 60ml DE 3 PARTES COMPUESTA POR- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2"- EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- CON BISELADO PRECISO- ALAS DE SUJECION EN DOS FASES- EMBOLO DE COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION

2503136	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA DE 60mlCON ADAPTADOR PARA AGUJA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	JERINGA DE 60ml DE 2 PARTES CON ADAPTADOR PARA AGUJA- COMPUESTA POR- CUERPO EN PLASTICO TRANSPARENTE GRADO MEDICO-PIVOTE TIPO LUER COLOR BLANCO CON PISTON DE CAUCHO NATURAL GRADO MEDICO- ANILLO DE RETENCION- DISCO DE EMPUJE CORRUGADO. ESTERIL. UN SOLO USO. EMPAQUE POLIETILENO
2503651	42142609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	JERINGA METALICA GUILLON 150ml-EN ACERO INOXIDABLE-CON PUNTA REDONDA- EN ACERO INOXIDABLE. USO- LAVADO DE OIDO	JERINGA METALICA GUILLON 150ml- EN ACERO INOXIDABLE- CON CODIGO REDONDA- EN ACERO INOXIDABLE- EMBOLO EN FORMA DE T-ESTERILIZABLE- PARA USO- LAVADO DE OIDO
2501129	42142535	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT BLOQUEO NERVIO CON CATETER AGUJA 18G	KIT BLOQUEO NERVIO CON CATETER AGUJA 18G. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. CANULA AGUJA 18G. TUBO DE INYECCION TRANSPARENTE CON CONEXIONES TIPO LUER LOCK Y CABLE DE CONEXION. CODIGO TIPO FACETA CON GRADUACION CENTIMETRICA. FILTRO BACTERIAL
2504130	42296212	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DUAL TROCAR OPTISO 100 mm X 12 mm-SISTEMA TROCAR OPTISO SEPARADOR ROSCADO EN Z	SISTEMA OPTISO CON EJE HUECO CON LLAVE DE GAS CON ADAPTADOR LUER LOCK SEPARADOR ROSCADO EN Z DE 12 mm X 100mm (DOS CANULAS ROSCUNIDAD
2504200	42231609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPISA PERCUTANEA N° 20 FR	KIT DE GASTROSTOMIA N° 20. TUBO DE ALIMENTACION DE SILICONA. GUIA DE INSERCION DE LAZO. CABLE SUJETADOR. ADAPTADOR UNIVERSAL. ADAPTADOR REDONDO. FORRO DE SILICONA CON SEGURO. AGUJA GRANDE INTRODUCTORA. ESCALPELO. JERINGA CON AGUJA. AGUJA PEQUEÑA. PAÑO
2501948	42231609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE GASTROSTOMIA ADULTO 24FR	KIT DE GASTROSTOMIA ADULTO 24FR. MATERIAL SILICONA GRADO MEDICO CON ADAPTADOR EN SILICONA CON PUERTO PARA NUTRICION Y MEDICACION. SONDA TRANSPARENTE. ANILLO DE RETENCION EXTERNO CON ORIFISIO Y TOPES INTERNOS. DOMO DE RETENCION INTERNA EN SILICONA Y COLAPSABLE Y RADIOPACO. DE UNICO USO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-

								ETIQUETA CON INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE.
2565524	42271710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTRODUCCION PERCUTANEA PARA CATETER DE SWAN GANS 6.0	KIT DE INTRODUCCION PERCUTANEA PARA CATETER DE SWAN GANS 6.0
2584034	42271710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTRODUCCION PERCUTANEA PARA CATETER DE SWAN GANS 6.0	CATETER INTRODUCTOR CON GUIA DE ALAMBRE DE RESORTE. AGUJA INTRODUCTORA. OBTURADOR. ALMOHADILLA DE GASA. FUNDA
2587225	42271710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT INTRODUCTOR VAINA PERCUTANEA 8.5FR	MANGO Y HOJA DE BISTURI DESCARTABLE. JERINGA DE 5CC. AGUJA INTRODUCTORA DE 18G X 700mm. INTRODUCTOR DE TEFLON 16G X 700mm. CUERDA GUIA- CON EXTREMO PROXIMAL SEMISIRCULAR PREFORMADO Y EXTREMO DISTAL RECTO Y BLANDO DE 450mm. DILATADOR DE POLIPROPILENO. CAMISA INTRODUCTORA DE POLIURETANO- CALIBRE 8-5 FR X 100mm. DE LONGITUD- VALVULA HEMOSTATISA INTEGRADA VIA LATERAL Y LLAVE DE TRES VIAS - FUNDA ANTISONTAMINANTE DE 800mm. DE LONGITUD. ESTERIL- A PIROGENO Y ENVASADO INDIVIDUALMENTE. PRESENTACION CAJA DE 10 UNIDADES
2584168	42271710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT MANUAL DE ACCESO INFUSION INTRAOSEA QUE PERMITA EL ACDESO VASCULAR DE (TIBIA PROXIMAL/DISTAL Y HUMERO PROXIMAL)	KIT CON PISTOLA RECARGABLE. FOAM PARA PRACTISA. MECANISMO PARA RECARGA. CD INSTRUCCION. CLIPS DE SEGURIDAD. DOS DISPOSITIVOS BIG ADULTO Y PEDIATRICO.
2500614	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	LLAVE 3 VIAS CON EXTENSION. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LLAVE DE 3 VIAS CON UNA VIA MACHO Y 2 VIAS HEMBRAS- CON PROTECTORES CON EXTENSION DE ANESTESIA - DE PE (POLIETILENO)- PC (POLICARBONATO)- PVC POLICLORURO-BLISTER TUERCA DE FIJACION MOVIL AXIAL Y RADICALMENTE PARA UNA CONEXION SEGURA

2500615	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	LLAVE 3 VIAS SIN EXTENSION DE ANESTESIA-ESTERIL-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER	LLAVE DE 3 VIAS CON UNA VIA MACHO Y 2 VIAS HEMBRAS- CON PROTECTORES SIN EXTENSION DE ANESTESIA- DE PE (POLIETILENO)- PC (POLICARBONATO)- PVC POLICLORURO DE VI BLISTER TUERCA DE FIJACION MOVIL AXIAL Y RADICALMENTE PARA UNA CONEXION SEGURA
2500616	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	LLAVE DE DOS VIAS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LLAVE DE DOS VIAS ACC PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES POR VIA PARENTERAL DE PLASTICO MEDICO PERIMETRO DE GIRO DE 360° TRASPARENTE Y TRASLUCIDO ESTERIL Y ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS
2503217	42294213	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	MANGUERA/TUBO INSUFLADOR DE CO2 PARA LAPAROSCOPIA - 5MM Ø Y 3M DE LONGITUD	INSUFLADOR DE CO2 PARA LAPAROSCOPIA- TUBO FLEXIBLE DE GRAN CAUDAL- RESISTENTE A LA TRACCION- QUE NO SE COLAPSE- CON ESPIRAL
2587205	42295114	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	PK	A.02.02.01.003.006	PAQUETE DE BOMBA DUAL/FACOEMULSIFISACION	PAQUETE- COLECTOR Y TUBO ENSAMBLABLES- CUBIERTA DE MONITOR- CUBIERTA PARA BANDEJA MAYO Y CAMARA DE ENSAYO. EMPAQUE ESTERILIZADO EN BANDEJA CON CUBIERTA DE BARRERA ESTERIL.
2500426	42221612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PIANO DE TRES LLAVES TRES VIAS	LLAVE DE TRES VIAS. SISTEMA DE CONEXION PLASTICO RIGIDO EN POLICARBONATO CON SISTEMA DE CONECCION ESPECIFICO PARA CUALQUIER CATETER CON UN CONECTOR MACHO (LUER LOK) Y DOS HEMBRAS (LUER SLIP). CONECCION A PRUEBA DE FUGA.DISPOSITIVO MEDICO DESECHABLE QUE SE USA PARA TERAPIA DE INFUSION MULTISANAL Y MONITORIA DE PRESIONES EN COOPERACION CON OTROS DISPOSITIVOS. USO PARA UN SOLO PACIENTE. ALMACENAMIENTO CON TEMPERATURA MENOR A 40 GRADOS CENTIGRADOS SIN GAS CORROSIVO Y BUENA VENTILACION CON HUMEDAD MENOR O IGUAL AL 80%
2504264	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO BILIAR AUTOEXPANDIBLE. PROTESIS DE NINITOL AUTOEXPANDIBLE CON INTRODUCTOR DE 6 FR	PROTESIS DE PASO BILIAR AUTOEXPANDIBLE. PROTESIS DE NINITOL AUTOEXPANDIBLE CON INTRODUCTOR DE 6 FR PARA PALEACION DE NEOPLASIA

2504265	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO BILIAR AUTOEXPANDIBLE. PROTESIS DE NINITOL AUTOEXPANDIBLE CON INTRODUCTOR DE 7 FR	PROTESIS DE PASO BILIAR AUTOEXPANDIBLE. PROTESIS DE NINITOL AUTOEXPANDIBLE CON INTRODUCTOR DE 7 FR PARA PALEACION DE NEOPLASIA
2504268	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO BILIAR DE PLASTICO CON DOBLE COLA DE CERDO 7 FR	PROTESIS DE PASO BILIAR DE PLASTICO CON DOBLE COLA DE CERDO - PROTESIS PLASTICA PARA DRENAR VIA BILIAR DE 7FR
2504267	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO BILIAR DE PLASTICO CON KIT DE INTRODUCCIÓN 7 FR	PROTESIS DE PASO BILIAR DE PLASTICO CON KIT DE INTRODUCCION - PROTESIS PLASTICA PARA DRENAR VIA BILIAR DE 7 FR
2504266	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO ESOFAGICA AUROEXPANDIBLE 20mm LONG+ 8cm	PROTESIS DE PASO ESOFAGICA AUROEXPANDIBLE - STEN RECUBIERTO PARCIALMENTE ESOFAGICA DE 20 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DESDE 8 cm
2504269	42294941	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS DE PASO PANCREATICA DE PLASTICO CON KIT DE INTRODUCTOR 3 FR	PROTESIS DE PASO PANCREATICA DE PLASTICO CON KIT DE INTRODUCTOR - PROTESIS PLASTICA PARA DRENAR VIA PANCREATICA DESDE 2 cm DE LONG 3 FR
2504289	42295114	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PARA FACOEMULSIFISADOR	CODIGOS PARA FACOEMULSIFISADOR. CODIGO RECTAS Y CURVAS PARA INCISIONES DE 2-4 -2-7. CON FUNDA DE IRRIGACION
2500124	42203406	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SENSOR EN LINEA LA TOMA GASTO CARDIACO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	SENSOR EN LINEA CON SISTEMA EN ESPIRAL-JERINGA Y LLAVE DE TRES VIAS- SISTEMA CERRADO PARA LA TOMA DEL GASTO CARDIACO.
2500085	42203406	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SENSOR GASTO CARDIACO MINIMAMENTE INVASIVO. ESTERIL-	SENSOR PARA MEDICION DEL GASTO CARDIACO MINIMAMENTE INVASIVO. MEDICION GASTO CARDIACO INDICE CARDIACO VOLUMEN SISTOLISO INDICE

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504419	42294219	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SET DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION ARTROSCOPIA	SET DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION ARTROSCOPIA. CASSETTE INTUITIVO (UNPASO/UNA MANO). DOS COLORES PARA IDENTIFICACION DE LA MANGUERA
2500617	42221609	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA INTEGRADO CON CATETER PARA TERAPIA INTRAVENOSA- CON DOBLE ENTRADA- EN VIALON- RADIOPACO	SONDA PLASTICA FLEXIBLE- ADAPTADOR PARA ACCESO INTRAVENOSO- CON SISTEMA CERRADO LIBRE DE AGUJA- MENBRANA EXPANDIBLE EN SILICONA. DE FACIL LIMBPIEZA Y ACCESO- FUGAS. ESTERIL- DESECHABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2503903	42231603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROENTERICA YEYUNAL PARA NUTRICION ENTERAL N° 16 FR EN SILICONA	SONDA GASTROENTERICA YEYUNAL PARA NUTRICION ENTERAL N° 16 FR. ELABORADA EN SILICONA 100% GRADO MEDICO- BIOCOMPATIBLE- ATOXICO. ADAPTAPA Y EL PUERTO DEL BALON CON VALVULA UNIDIRECCIONAL E INDICACION DEL CALIBRE Y VOLUMEN DE LLENADO. ANILLO DE RETENCION EXTERNA.
2503552	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROSTOMIA N° 20 FR EN SILICONA	SONDA GASTROSTOMIA N° 20 FR EN SILICONA GRADO MEDICO PARA NUTRICION ENTERAL. BIOCOMPATIBLE- ATOXICO. ADAPTAPA Y EL PUERTO DEL BALON CON VALVULA UNIDIRECCIONAL E INDICACION DEL CALIBRE Y VOLUMEN DE LLENADO. ANILLO DE RETENCION EXTERNA.
2503553	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROSTOMIA N° 22 FR EN SILICONA	SONDA DE GASTROSTOMIA N° 22 FR FABRICADA EN SILICONA TRANSPARENTE 100% GRADO MEDICO - SILICONA DE GRADO MEDICO PARA BIOCOMPATIBILIDAD SUPERIOR. EL TUBO TRANSPARENTE Y LA LINEA RADIOPACA PERMITEN UNA INSPECCION VISUAL. MARCA DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR LA POSICION DEL TUBO. LA CODIGO REDONDA Y ABIERTA AUMENTA EL FLUJO DE LA ALIMENTACION Y DISMINUYE EL TRAUMATISMO DURANTE LA INSERCION. EMBUDO CON MUCHAS ARANDELAS INTERIORES PARA CONECTAR CON OTROS EQUIPOS. CAPUCHON CON TAPA PARA ESTAR BIEN SELLADO Y EVITAR LA CONTAMINACION Y LA ENTRA DEL AIRE. EL ANILLO DE FIJACION PREVIENE EL MOVIMIENTO DEL TUBO Y ELIMINA LA SUTURA O EL USO DEL ESPARADRAPO. PUERTO UNIVERSAL DE MEDICACION. LIBRE DE LATEX/DEHP.

2503554	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROSTOMIA N° 24 FR- EN SILICONA TRANSPARENTE.	SONDA DE GASTROSTOMIA N° 24 FR FABRICADA EN SILICONA TRANSPARENTE 100% GRADO MEDICO - SILICONA DE GRADO MEDICO PARA BIOCOMPATIBILIDAD SUPERIOR. EL TUBO TRANSPARENTE Y LA LINEA RADIOPACA PERMITEN UNA INSPECCION VISUAL. MARCA DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR LA POSICION DEL TUBO. LA CODIGO REDONDA Y ABIERTA AUMENTA EL FLUJO DE LA ALIMENTACION Y DISMINUYE EL TRAUMATISMO DURANTE LA INSERCION. EMBUDO CON MUCHAS ARANDELAS INTERIORES PARA CONECTAR CON OTROS EQUIPOS. CAPUCHON CON TAPA PARA ESTAR BIEN SELLADO Y EVITAR LA CONTAMINACION Y LA ENTRA DEL AIRE. EL ANILLO DE FIJACION PREVIENE EL MOVIMIENTO DEL TUBO Y ELIMINA LA SUTURA O EL USO DEL ESPARADRAPO. PUERTO UNIVERSAL DE MEDICACION. LIBRE DE LATEX/DEHP.
2503555	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROSTOMIA N° 26 FR EN SILICONA.	SONDA DE GASTROSTOMIA N° 26 FR FABRICADA EN SILICONA TRANSPARENTE 100% GRADO MEDICO - SILICONA DE GRADO MEDICO PARA BIOCOMPATIBILIDAD SUPERIOR. EL TUBO TRANSPARENTE Y LA LINEA RADIOPACA PERMITEN UNA INSPECCION VISUAL. MARCA DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR LA POSICION DEL TUBO. LA CODIGO REDONDA Y ABIERTA AUMENTA EL FLUJO DE LA ALIMENTACION Y DISMINUYE EL TRAUMATISMO DURANTE LA INSERCION. EMBUDO CON MUCHAS ARANDELAS INTERIORES PARA CONECTAR CON OTROS EQUIPOS. CAPUCHON CON TAPA PARA ESTAR BIEN SELLADO Y EVITAR LA CONTAMINACION Y LA ENTRA DEL AIRE. EL ANILLO DE FIJACION PREVIENE EL MOVIMIENTO DEL TUBO Y ELIMINA LA SUTURA O EL USO DEL ESPARADRAPO. PUERTO UNIVERSAL DE MEDICACION. LIBRE DE LATEX/DEHP.
2502719	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA GASTROSTOMIA PEDIATRICA N° 18	SONDA DE GASTROSTOMIA PEDIATRICA N° 18 FR FABRICADA EN SILICONA TRANSPARENTE 100% GRADO MEDICO - SILICONA DE GRADO MEDICO PARA BIOCOMPATIBILIDAD SUPERIOR. EL TUBO TRANSPARENTE Y LA LINEA RADIOPACA PERMITEN UNA INSPECCION VISUAL. MARCA DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR LA POSICION DEL TUBO. LA CODIGO REDONDA Y ABIERTA AUMENTA EL FLUJO DE LA ALIMENTACION Y DISMINUYE EL TRAUMATISMO DURANTE LA INSERCION. EMBUDO CON MUCHAS ARANDELAS INTERIORES PARA CONECTAR CON OTROS EQUIPOS. CAPUCHON CON TAPA PARA ESTAR BIEN SELLADO Y EVITAR

								LA CONTAMINACION Y LA ENTRA DEL AIRE. EL ANILLO DE FIJACION PREVIENE EL MOVIMIENTO DEL TUBO Y ELIMINA LA SUTURA O EL USO DEL ESPARADRAPO. PUERTO UNIVERSAL DE MEDICACION. LIBRE DE LATEX/DEHP.
2587146	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE GASTROSTOMIA MIS-KEY	SONDA DE BAJO PERFIL PARA NUTRICION ENTERAL POR GASTROSTOMIA-SILICONA 100% GRADO MEDICO. BIOCOMPATIBLE- ATOXICO NO CANCERIGENO. EXTENSION CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO SECUR-LOK-PIEZA EN "Y" DE 2 PUERTOS Y CLAMP. PERMITE LA ADMON DE ALIMENTACION EN BOLOS. SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE BAJO PERFIL-EXTENSION CON PIEZA EN "Y" CON 2 PUERTOS CON CLAMP- EXTENSION PARA ALIMENTACION POR BOLOS CON CLAMP- 4 GASAS 4X4- JERINGA CON CODIGO TIPO CATETER DE 35CC- JERINGA LUER SLIP DE 6CC.
2500922	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 10 FR PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL CODIGO TUNGSTENO 10 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CON GUIA METALICA. CON CODIGO DE TUNGSTENO Y CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500923	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 12 FR PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL CODIGO TUNGSTENO 12 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CON GUIA METALICA. CON CODIGO DE TUNGSTENO Y CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.

2587052	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 14 FR PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL CODIGO TUNGSTENO 14 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CON GUIA METALICA. CON CODIGO DE TUNGSTENO Y CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500919	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 6 FR PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL CODIGO TUNGSTENO 6 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CON GUIA METALICA. CON CODIGO DE TUNGSTENO Y CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500920	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 8 FR PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL CODIGO TUNGSTENO 8 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CON GUIA METALICA. CON CODIGO DE TUNGSTENO Y CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500926	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 10 FR SIN PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL SIN CODIGO TUNGSTENO 10 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.

2500927	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 12 FR SIN PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL SIN CODIGO TUNGSTENO 12 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500924	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 6 FR SIN PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL SIN CODIGO TUNGSTENO 6 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2500925	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE NUTRICION ENTERAL Nº 8 FR SIN PUNTA TUNGSTENO	SONDA NUTRICION ENTERAL SIN CODIGO TUNGSTENO 8 FR- DE POLIURETANO. ESTERIL. ATOXICO. MATERIAL OPACO A RAYOS X. CERRADA PERFECTAMENTE REDONDA- PARA NO LASTIMAR AL PACIENTE. CUENTA CON UN CONECTOR EN Y- PARA EL FACIL SUMINISTRO DE FORMULACIONES. ESTA LIBRE DE PIROGENOS. DESECHABLE. CONDUCTO TUBULAR ELABORADO DE MATERIAL FLEXIBLE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN SU PARTE PROXIMAL. NO CONSERVA DEFORMACIONES AL EXTENDERSE.
2501949	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA RECAMBIO GASTROSTOMIA ADULTO NO.24- EN MATERIAL DE SILICONA GRADO MEDICO	SONDA SILICONADA DE LARGA PERMANENCIA ADULTO No. 24. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. UNICO USO. LIBRE DE LATEX.
2504251	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA RECAMBIO GASTROSTOMIA ADULTO NO18	SONDA SILICONADA DE LARGA PERMANENCIA ADULTO No.18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. UNICO USO. LIBRE DE LATEX.
2501292	42231601	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA RECAMBIO GASTROSTOMI	SONDA SILICONADA DE LARGA PERMANENCIA PEDIATRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. UNICO USO. LIBRE DE LATEX.

							A PEDIATRICA- EN SILICONA GRADO MEDICO	
2501287	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPON DE NEOPRENO LIBRE DE LATEX. ADAPTADOR PARA TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE Y/O TOMA DE MUESTRAS DESANGRE	ADAPTADOR PARA TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE Y/O TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE- CON CONEXION LUER LOCK (EN ROSCA PARA EL CATETER)- SI VENOSO.SOPORTA APROXIMADAMENTE (100) CODIGOES. GARANTIZA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE EMPATAR EL TAPON AL CATETER- EVITANDO DESCONEXION
2503856	42221602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPON HEPARINIZADO CON MEMBRANA DE GOMA- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	ADAPTADOR PARA TERAPIA ENDOVENOSA INTERMITENTE Y/O TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE- CON CONEXION LUER LOCK (EN ROSCA PARA EL CATETER)- SI INTERNAMENTE CON HEPARINA- ADAPTABLE A TODAS LAS BASES HEMBRA (CATETERES- MICROPERFUSORES). GARANTIZA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DEL EMPATE
2584199	41116106	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.004	TIRA OFTALMICA DE FLUORESCEINA DE SODIO PRSENTACION EN FRASCO	TIRA CON FLUORESCEINA DE SODIO PARA VISUALIZAR DEFECTOS O ANOMALIAS EN EL EPITELIO CORNEAL- MEDIANTE TINCION
2504193	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR PARA MEDICION DE PRESIONES INVASIVAS SENCILLO	TRANSDUCTOR PARA MEDICION DE PRESIONES INVASIVAS SENCILLO NO POSEE ELEMENTOS ELECTRONICOS DESECHABLE CON LLAVE DE TRES VIAS EXTENSION DE 130 cm EN Y - EXTENCION DE 83 CON PUERTO DE INYECTOR
2504191	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR MEDICION PRESION COMPARTIMENTAL	TRANSDUCTOR MEDICION DE PRESIONES COMPARTIMENTAL. DISPOSITIVO COMPATIBLE CON CUALQUIER JERINGA- ESTERIL E INDIVIDUAL CON PANTALLA
2504192	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA DOBLE	TRANSDUCTOR PARA MEDICION DE PRESION INVASIVA DOBLE DISPOSITIVO DE FLUJO- EXTENSIONES PARA MONITORIZAR DOS PRESIONES

2500267	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR MONITOREO 3 PRESIONES	DOS TRANSDUCTORES- DOBLE DISPOSITIVO DE FLUJO- EXTENSIONES Y LLAVES DE TRES VIAS PARA MONITORIZAR TRES PRESIONES ES UN TENSIOMETRO DESECHABLE QUE SE UTILIZA EN LAS UCI Y EN LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA PARA LA MONITORIZACION DE LA PRESION ARTERIAL Y VENOSA
2500134	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR MONITORIZAR 2 PRESIONES - KIT	KIT TRANSDUCTOR- TUBULADURAS DOBLES- EXTENSIONES Y LLAVES DE TRES VIAS PARA MONITORIZAR DOS PRESIONES ADAPTADOR COMPATIBLE KIT DE CANAL SIMPLE O DOBLE
2500142	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTORES PORTAL TOMA DE MUESTRAS	TRANSDUCTOR DE TOMA DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 2 PACIENTES- EN PVC Y ABS RESISTENTE A LA HUMEDAD- ANTIBACTERIAL- ANTIFLUIDOS- NO CORROSIVO
2500292	42221901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-1	C/U	A.02.02.01.003.006	TRANSDUCTOR PRESION DESECHABLE	TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE. ESTERIL INTRODUCTOR DE FACIL Y SUAVE INSERCION AL ENVASE A LA SOLUCION A APLICAR.TRANSDUCTOR DESECHABLE PARA LA MEDICION CONTINUA DE LA PRESION FISIOLOGISA Y LA DETERMINACION DE OTROS PARAMETROS HEMODINAMISOS IMPORTANTES.

GRUPO RECOLECCION DE SANGRE Y SUS COMPONENTES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500247	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA ASPIRACION MEDULA OSEA 15G X 1"	AGUJA PARA ASPIRACION MEDULA OSEA 15GAX1-16GAX1.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. EN ACERO INOXIDABLE.CONECTOR LUER LOOK DE MANGO DE DISEÑO ANATOMICO QUE FACILITA SU MANIOBRA Y SE ADAPTA FACILMENTE AL SITIO DE CODIGO
2500249	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA ASPIRACION MEDULA OSEA ADULTO	AGUJA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE CON FIJADOR Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA ASPIRACION MEDULA OSEA EN ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL
2500248	42142530	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA ASPIRACION MEDULA OSEA PEDIATRICO	AGUJA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE CON FIJADOR Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AJUSTABLE PARA ASPIRACION MEDULA OSEA PEDIATRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

2504549	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA AUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRU-CUT 18G X 20mm-COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO_MAG	AGUJA AUTOMATICA BIOPSIA TIPO TRU CUT 18G x 20mm- COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO MAG. AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDOS ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- CANULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK PARA MULTIPLES BIOPSIAS Y BIOPSIA BAJO GUIA DE TC. ESTILETE EXTRAIBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 mm ESTILETE ADICIONAL CON CODIGO DE TROCAR PARA POSICIONAMIENTO BAJO GUIA DE TC. EMPUÑADURA ABS DE DOS ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO- CON VENTANA PARA VER EL TAMANO DE MUESTRA ELEGIDO 10 O 20 mm MARCADOR ECOGENICO INTERNO. ESPACIADOR ESTEREOTACTICO
2504550	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA AUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRU-CUT 14GX10mm-COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO_MAG	AGUJA AUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRU-CUT 20GX 10 mm- COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO MAG. AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDOS ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- CANULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK PARA MULTIPLES BIOPSIAS Y BIOPSIA BAJO GUIA DE TC. ESTILETE EXTRAIBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 mm ESTILETE ADICIONAL CON CODIGO DE TROCAR PARA POSICIONAMIENTO BAJO GUIA DE TC. EMCODIGOADURA ABS DE DOS ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO- CON VENTANA PARA VER EL TAMANO DE MUESTRA ELEGIDO 10 O 20 mm MARCADOR ECOGENICO INTERNO. ESPACIADOR ESTEREOTACTICO
2504548	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA AUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRU-CUT 14GX9.15mm-COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO_MAG	AGUJA AUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRU-CUT 14GX9.15mm- COMPATIBLE CON PISTOLA AUTOMATICA TIPO PRO MAG. AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDOS ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL- CANULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK PARA MULTIPLES BIOPSIAS Y BIOPSIA BAJO GUIA DE TC. ESTILETE EXTRAIBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 mm ESTILETE ADICIONAL CON CODIGO DE TROCAR PARA POSICIONAMIENTO BAJO GUIA DE TC. EMCODIGOADURA ABS DE DOS ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO- CON VENTANA PARA VER EL TAMANO DE MUESTRA ELEGIDO 10 O 20 mm MARCADOR ECOGENICO INTERNO. ESPACIADOR ESTEREOTACTICO

2503595	42294903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	AGUJA SEMIAUTOMATICA-BIOPSIA TIPO TRUCUT 14G EN ACERO QUIRURGICO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA SEMIAUTOMATICA-PARA BIOPSIA DE TIPO TRUCUT 14Gx100mm-DE BORDE CORTANTE, CON MARCAS CENTIMETRADAS-PROFUNDIDAD DE PENETRACION AJUSTABLE-REUTILIZABLE-UTILIZADA PARA BIOPSIA HISTOLOGICA DE LOS TEJIDOS BLANDOS
2504546	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BIOPSIA POR ASPIRACION TIPO CHIBA CALIBRE 20 G-LONGITUD 20cm.	AGUJA PARA BIOPSIA POR ASPIRACION TIPO CHIBA CALIBRE 20 G- LONGITUD 20cm EMPAQUE INDIVIDUAL. FABRICADA EN ALEACION METALICA GRADO MEDICO NO MAGNETICA BIOPSIA CITOLOGICA- ASPIRACION DE QUISTES Y SUMINISTRO DE ANESTESICOS. CON CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES DESCARTABLE.
2500038	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 18GX100mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 18 G X 100 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500039	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 18GX160mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 18 G X 160 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500040	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 19GX100mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 19 G X 100 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.

2500041	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 19GX160mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 19 G X 160 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500042	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 20GX100mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 20 G X 100 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500043	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 20GX160mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 20 G X 160 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500044	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 21GX100mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 21 G X 100 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2500045	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 21GX160mm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y ASPIRACION DE PARTE DE ESTA DE 21 G X 160 mm EMPAQUE INDIVIDUAL. EN ACERO INOXIDABLE.MATERIAL ESTERIL.CON CONECTOR LUER LOOK PARA AJUSTE SEGURO DE LA JERINGA. AGUJA DE PARADA AJUSTABLE Y REMOVIBLE. MANGO DE DISENO ANATOMICO. AGUJA DE 10 Y 15 cm DE LARGO- EN DOS CALIBRES

								DISTINTOS- G8 Y G11 POR 4 mm Y 3 mm DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE.
2504440	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BIOPSIA PERCUTANEA AUTOMATICA 14G X 9 + - 1cm. CANULA EXTERNA MILIMETRADA	AGUJA PARA BIOPSIA PERCUTANEA AUTOMATICA 14G x 9 MAS- MENOS 1 cm. CANULA EXTERNA MILIMETRADA- MANDRIL O INTRODUCTOR INTERNO DE MAYOR LONGITUD DE LA AGUJA CON MARCADOR ECOGENICO. CODIGO INTERNACIONAL DE COLOR PARA DIFERENCIAR EL DIAMETRO DE LA AGUJA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2504441	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BIOPSIA PERCUTANEA AUTOMATICA 14G X 15 + - 1cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA PERCUTANEA AUTOMATICA 14G x 15 MAS- MENOS 1 cm. CANULA EXTERNA MILIMETRADA- MANDRIL O INTRODUCTOR INTERNO DE MAYOR LONGITUD DE LA AGUJA CON MARCADOR ECOGENICO. CODIGO INTERNACIONAL DE COLOR PARA DIFERENCIAR EL DIAMETRO DE LA AGUJA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2584188	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL 18GAX25cm- MARCADO DE PROFUNDIDAD EN CENTIMETROS CON PUNTA ECOGENICA	AGUJA PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL 18 GA x 25 cm- CON DISENO RETIRA ESPACIADORES- MARCADO DE PROFUNDIDAD EN CENTIMETROS CON CODIGO ECOGENICA. CAJA X 20 UNIDADES
2504442	42294903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	AGUJA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL 18GX30CM-DE CORTE TIPO TRU-CUT- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA TRANSRECTAL 18Gx30cm. AGUJA AUTOMATICA DE CORTE TIPO TRU-CUT PARA BIPOSIA. CENTRIMETRADA PARA FACILITAR LA MEDICION-CALIBRE-PROPORCIONA MUESTRAS HISTOLOGICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE LESIONES SOSPECHOSAS. LA MUESCA DE LA MUESTRA ES DE 19mm
2501169	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 16 G X 10-16 cm- EN ACERO QUIRURGICO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA PARA BIOPSIA DE ACERO QUIRURGICO- DE BORDE CORTANTE- CON MARCAS CENTIMETRADAS RADIOPACAS PARA ORGANOS BLANDOS TIPO TRU-CUT SEM AUTOMATICO CANULA DESMONTABLE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CONECTOR LUER LOCK PARA MULTIPLES BIOPSIAS Y BIOPSIA BAJO GUIA DE TC.ESTILETE EXTRAIBLE CON MUESCA DE MUESTRA DE 20 mm ESTILETE ADICIONAL CON CODIGO DE TROCAR PARA POSICIONAMIENTO BAJO GUIA DE TC- EMPUÑADURA ABS DE DOS

								ANILLOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON UNA SOLA MANO- CON VENTANA PARA VER EL TAMAÑO DE MUESTRA ELEGIDO (10 O 20 mm)- MARCADOR ECOGENICO INTERNO- ESPACIADOR ESTEREOTACTICO
2584159	42142536	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA DESCOMPRESION DE NEUMOTORAX A TENSION 10G X 3.25"	AGUJA PARA DESCOMPRESION DE NEUMOTORAX A TENSION 10G x 3.25 PULGADAS DE LONGITUD- EMPAQUE ESTERIL- EMPAQUE UNIDAD. IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DEL NEUMOTORAX A TENSION.
2584160	42142536	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA DESCOMPRESION DE NEUMOTORAX A TENSION 14G X 3.25"	AGUJA PARA DESCOMPRESION DE NEUMOTORAX A TENSION 14G x 3.25 PULGADAS DE LONGITUD- EMPAQUE ESTERIL- EMPAQUE UNIDAD. IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DEL NEUMOTORAX A TENSION.
2503415	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE SEGURIDAD 21 G X 1"	AGUJA MULTPLE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRIBISELADA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO- ALINEADO AL BISEL Y SE ACTIVA CO SANGRE Y PERFORA EL TUBO AL VACIO- CALIBRE 21G 1"- ESTERIL- APIROGENA- DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL RIGIDO- CON SELLO DE SEGURIDAD
2504498	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE SEGURIDAD 21 G X1.25(21GX 32mm) PARA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACIO- ESTERIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA MULTIPLE EN ACERO INOXIDABLE- AGUJA DOBLE CODIGO- UNA DE ELLAS SE INSERTA AL PACIENTE Y OTRA AL TUBO AL VACIO- PAREDES DELGADAS EXTRACCIONDE SANGRE CON TUBOS AL VACIO. VIDA UTIL 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIONUSO- EXTRACCION DE SANGRE CON TUBOS ALV
2502783	42142523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA MULTIPLE TOMA MUESTRAS 21G X1 1/5 PARA TOMA DE MUESTRAS	AGUJA DE DOBLE CODIGO UNA DE ELLAS SE INSERTA EN EL PACIENTE Y LA OTRA PERFORA LOS TUBOS AL VACIO. PROTEGIDA POR UNA ENVOLTURA EN PLASTICO TAPON DE GOMA CUBRIENDO EL EXTREMO OPUESTO AL QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE PREVINIENDO FUGAS DE SANGRE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2500168	42161505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITRONEAL	BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITRONEAL AUTOMATIZADA- CON CAPACIDAD DE 20 LITROS DE INTERFAZ UNIVERSAL DE USO UNICO.

							AUTOMATIZADA - CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	
2500169	42161505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITRONEAL AUTOMATIZADA - CON CAPACIDAD DE 3 LITROS	BOLSA DE DRENAJE PARA DIALISIS PERITRONEAL AUTOMATIZADA- CON CAPACIDAD DE 3 LITROS DE INTERFAZ UNIVERSAL DE USO UNICO.
2587201	42142704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA UROSTOMIA	BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDO URINARIO CON VALVULA ANTIRREFLUJO Y VALVULA DE DRENAJE - BARRERA PROTECTORA DE LA PIEL- ACOPLE CARGA UNIVERSAL- TAMAÑO 45mm- EMPAQUE INDIVIDUAL
2505155	42142704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA A PIERNA	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA A PIERNA DE 750 ML CON TAPON Y CINTURON AJUSTABLE- ATOXICO- ESTERIL Y DESECHABLE
2503902	42142704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DE PIERNA MULTICANAL- ELBORADA EN POLIPOROPILE NO- POLIETILENO- PVC- POLIESTER. ESTERIL	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO. BOLSA EN PVC FLEXIBLE- TUBO DE DRENAJE- CATETER NELATON. BOLSA DE DRENAJE DE ORINA DE USO CLINICO DE UNA SOLA VIA O DE DOBLE VIA CON VALVULA ANTIRREFLUJO CON PUERTO DE TOMA DE MUESTRAS CON GANCHO REFORZADO PARA COLGAR NO REUTILIZABLE ESTERIL
2501718	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 1000ml. EMPAQUE INDIVIDUAL	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 1000ml. EMPAQUE INDIVIDUAL A BASE DE PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS Y SOLIDIFICANTE-DESECHABLE
2501719	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 1500ml. EMPAQUE INDIVIDUAL	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 1500ml. EMPAQUE INDIVIDUAL A BASE DE PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS Y SOLIDIFICANTE-DESECHABLE

2501720	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 2000ml. EMPAQUE INDIDIVIDUAL	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 2000ml. EMPAQUE INDIVIDUAL A BASE DE PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS Y SOLIDIFICANTE-DESECHABLE
2501721	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 3000ml. EMPAQUE INDIDIVIDUAL	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 3000ml. EMPAQUE INDIVIDUAL A BASE DE PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS Y SOLIDIFICANTE-DESECHABLE
2502687	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA FLUIDO SIN TAPA 1000ml	BOLSA RECOLECTORA FLUIDOS SIN TAPA DE 1000CC. CONECTOR- TIPO UNIVERSAL- COMPATIBLE CON LOS CALIBRES DE LAS SONDAS. PROTECTOR DEL DISPOSITIVO- FABRICADO EN POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO- PROTEGE EL CONECTOR- HASTA SU USO. MANGUERA- FABRICADA EN PVC TRASLUCIDA- PERMITE EL PASO DE LIQUIDO A LA BOLSA. BOLSA DRENAJE URINARIO- FABRICADA EN PVC- SU FUNCION ES ALOJAR Y PERMITIR LA VISUALIZACION ADECUADA DE LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE ORINA ELIMINADA POR EL PACIENTE. ESCALA VOLUMETRICA- IMPRESA EN TINTA DE COLOR PARA FACILITAR SU LECTURA- SU FUNCION ES PERMITIR EL CALCULO EXACTO DE LA DIURESIS DEL PACIENTE. MANGUERA PARA TOMA DE MUESTRAS/VACIAMIENTO- POSEE UN DISPOSITIVO QUE PERMITE LA INTERRUPCION DEL FLUJO- SU FUNCION ES PERMITIR LA TOMA DE MUESTRAS/VACIAMIENTO DE LA BOLSA. EMPAQUE INDIVIDUAL
2504299	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS FLEXIBLE CON CAPACIDAD ENTRE 1000-1500 CC- CON VALVULA ANTIRREFLUJO. EMPAQUE INDIVIDUAL	BOLSA CON TAPA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON CAPACIDAD ENTRE 1000-1500 CC EN POLIETILENO- DESECHABLE- VALVULA ANTIREFLUJO PARA LA ASPIRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES- SELLADO HERMETICO EMPAQUE INDIVIDUAL

2500170	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON CAPACIDAD ENTRE 1500-2000 CC- CON PUERTO ADICIONAL- EMPAQUE INDIVIDUAL	BOLSA RECOLECTORA DESECHO SUCCION 1500 A 2000ml CON PUERTO ADICIONAL Y RED CENTRAL DE VACIO. PARA LA ASPIRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES. EMPAQUE INDIVIDUAL A BASE DE PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS Y SOLIDIFICANTE-DESECHABLE
2503200	41104123	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA DESECHOS POR SUCCION CON SOLIDIFICANTE DE 1500ml	PLASTICO CORRUGABLE- LIBRE DE LATEX- DE ALTA RESISTENCIA-SELLADO HERMETICO- CON SISTEMA DE SEGURIDAD-DESECHABLE- TAMAÑO DE 1500CC-
2504641	41104123	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA FLUIDOS FLEXIBLE1800ml -DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD- TRANSPORTE Y DESECHO- CAPACIDAD DE 1800CC	BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS FLEXIBLE CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD CAPACIDAD 1800 CC DESECHABLES- PRODUCTO DE USO UNICO PARA TRANSPORTE Y DESECHO-LBRE DE LATEX
2587045	41104123	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA RECOLECTORA FLUIDOTAPA AZUL 1000CC A 1500CC CON GEL SOLIDIFICANTE RECOLECCION DE FUIDOS	BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE DESECHABLE - LINER CON CAPACIDADES DE 1000 A 1.500 ML- CON GEL SOLIDIFICANTE PARA USO EN SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS.
2500351	42161505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA UROSTOMIA 57mm ADULTO	BOLSA ADULTO DRENABLE TRANSPARENTE PARA UROSTOMIAS- COFECCIONADA EN TRES LAMINAS DE PVC CORRUGABLE DE ALTA RESISTENCIA- ARO DE ACOPLE DE DESCARGA UNIVERSLA- CON VALVULA ANTIREFLUJO DE TAMAÑO 57 mm
2505851	42142704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA UROSTOMIA 64mm ADULTO	BOLSA PARA UROSTOMIA 64mm ADULTO BOLSA ADULTO DRENABLE TRANSPARENTE PARA UROSTOMIAS- COFECCIONADA EN TRES LAMINAS DE PVC CORRUGABLEDE ALTA RESISTENCIA- ARO DE ACOPL ESCARGA UNIVERSLA- TAMAÑO 64mm

2501053	41104000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CAMISA PARA AGUJA MULTIPLE EN PLASTICO- LIBRE DE LATEX- NO ESTERIL	ACCESORIO REHUSABLE DE PLASTICO- LIBRE DE LATEX- NO ESTERIL- CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD- DE AJUSTE PERFECTO A LA AGUJA MULTIPLE. C VACIO
2501722	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE SUCCION DE YANKAWER EN PVC GRADO MEDICO- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD	CANULA DE SUCCION DE YANKAWER. ELABORADA EN PVC GRADO MEDICO. CON PUERTO DE ASPIRACION Y CONECTOR. USO UNICO. ESTERIL. CODIGO DE BULBO FLEXIBLE. INDICADO PARA ASPIRACION DE SANGRE Y SECRECIONES DURANTE LOS PROCESOS QUIRURGICOS.
2504612	42142712	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER CON BALON DE DILATACION PARA EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES TRILUMEN RADIOPACO	CATETER BALON EXTRA CALCULOS TRILUMEN RX. EL GLOBO SE PUEDE INFLAR A UNO DE TRES DIAMETROS- 8.5mm- 11.5 mm Y 15 mm TRES JERINGAS POR EN EL EXTREMO PROXIMAL SE ESTRECHA A 5 FR. A EL EXTREMO DISTAL - PERMITE UN ACERCAMIENTO FACIL A LA BILIS CONDUCTO Y ACOMODA UNA GUIA I
2504121	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER URETRAL DOBLE J DE 7 FR UNIDAD	CATETER DOBLE J X 7FR CATETER EN POLIURETANO- ALAMBRE DE GUIA EN ACERO INOXIDABLE- VAINAS DE POSICIONAMIENTO CON IDENTIFICADOR UNIDAD
2504120	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER URETRAL DOBLE J 6 FR UNIDAD	CATETER URETRAL DOBLE J 6 FR CATETER EN POLIURETANO- ALAMBRE DE GUIA EN ACERO INOXIDABLE- VAINAS DE POSICIONAMIENTO CON IDENTIFICADOR UNIDAD
2504122	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER URETRAL DOBLE J 4FR UNIDAD	CATETER URETRAL DOBLE J PERC 4FRX15cm EN POLIURETANO DE DERIVACION URINARIA-CONSTA DE UN TUBO FLEXIBLE DE PEQUEÑO CALIBRE-MULTIPERFORADO E INCURVADO EN AMBOS EXTREMOS QUE SE SITUA DEL RIÑON A LA VEJIGA-CON GUIA METALICA-SE COLOCA DE FORMA ENDOSCOPICA A TRAVES DE LA URETRA-USO-FACILITAR LA SALIDA DE LA ORINA DE LA VIA OBSTRUIDA PARA ALIVIAR EL DOLOR O TRATAR LA INFECCION-EMPAQUE INDIVIDUAL

2505269	42142720	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UROCONDON EN SILICONA-DIAMETRO 29 mm	CATETER UROCONDON EN SILICONA Ø 29mm CATETER EXTERNO MASCULINO / CONDON DE SILICONA SUAVE Y TRANSPIRABLE- QUE SE AJUSTA AL PENE DE MANERA PERSONALIZADA. DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE MONITORIZAR LAS CONDICIONES DE LA PIEL. ADHESIVO APTO PARA LA PIEL QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES. LA CODIGO BISELADA REFORZADA- QUE RESISTE EL MOVIMIENTO CONSERVANDO ABIERTO EL TRAYECTO- SE AJUSTA A LA MAYORIA DE LOS RECOLECTORES DE ORINA NOCTURNOS O AMBULATORIOS- GARANTIZANDO UNA CONEXION SEGURA. BRINDA DISCRECION DEBAJO DE LA ROPA. VIENE ESTANDAR- LONGITUD REGULAR- DIFERENTES DIAMETROS
2505270	42142720	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UROCONDON EN SILICONA-DIAMETRO 32 mm	CATETER UROCONDON EN SILICONA Ø 32 mm CATETER EXTERNO MASCULINO / CONDON DE SILICONA SUAVE Y TRANSPIRABLE- QUE SE AJUSTA AL PENE DE MANERA PERSONALIZADA. DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE MONITORIZAR LAS CONDICIONES DE LA PIEL. ADHESIVO APTO PARA LA PIEL QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES. LA CODIGO BISELADA REFORZADA- QUE RESISTE EL MOVIMIENTO CONSERVANDO ABIERTO EL TRAYECTO- SE AJUSTA A LA MAYORIA DE LOS RECOLECTORES DE ORINA NOCTURNOS O AMBULATORIOS- GARANTIZANDO UNA CONEXION SEGURA. BRINDA DISCRECION DEBAJO DE LA ROPA. VIENE ESTANDAR- LONGITUD REGULAR- DIFERENTES DIAMETROS
2505271	42142720	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UROCONDON EN SILICONA-DIAMETRO 36 mm	CATETER UROCONDON EN SILICONA DIAMETRO 36 mm CATETER EXTERNO MASCULINO / CONDON DE SILICONA SUAVE Y TRANSPIRABLE- QUE SE AJUSTA AL PENE DE MANERA PERSONALIZADA. DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE MONITORIZAR LAS CONDICIONES DE LA PIEL. ADHESIVO APTO PARA LA PIEL QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES. LA CODIGO BISELADA REFORZADA- QUE RESISTE EL MOVIMIENTO CONSERVANDO ABIERTO EL TRAYECTO- SE AJUSTA A LA MAYORIA DE LOS RECOLECTORES DE ORINA NOCTURNOS O AMBULATORIOS- GARANTIZANDO UNA CONEXION SEGURA. BRINDA DISCRECION DEBAJO DE LA ROPA. VIENE ESTANDAR- LONGITUD REGULAR- DIFERENTES DIAMETROS

2505268	42142720	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UROCONDON EN SILICONA-DIAMETRO 25 mm	CATETER UROCONDON EN SILICONA DIAMETRO 25mm CATETER EXTERNO MASCULINO / CONDON DE SILICONA SUAVE Y TRANSPIRABLE- QUE SE AJUSTA AL PENE DE MANERA PERSONALIZADA. DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE MONITORIZAR LAS CONDICIONES DE LA PIEL. ADHESIVO APTO PARA LA PIEL QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES. LA CODIGO BISELADA REFORZADA- QUE RESISTE EL MOVIMIENTO CONSERVANDO ABIERTO EL TRAYECTO- SE AJUSTA A LA MAYORIA DE LOS RECOLECTORES DE ORINA NOCTURNOS O AMBULATORIOS- GARANTIZANDO UNA CONEXION SEGURA. BRINDA DISCRECION DEBAJO DE LA ROPA. VIENE ESTANDAR- LONGITUD REGULAR- DIFERENTES DIAMETROS
2505272	42142720	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CATETER UROCONDON EN SILICONA-DIAMETRO 41 mm	CATETER UROCONDON EN SILICONA Ø 41mm CATETER EXTERNO MASCULINO / CONDON DE SILICONA SUAVE Y TRANSPIRABLE- QUE SE AJUSTA AL PENE DE MANERA PERSONALIZADA. DE MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE MONITORIZAR LAS CONDICIONES DE LA PIEL. ADHESIVO APTO PARA LA PIEL QUE AYUDA A PREVENIR DESPRENDIMIENTOS ACCIDENTALES. LA CODIGO BISELADA REFORZADA- QUE RESISTE EL MOVIMIENTO CONSERVANDO ABIETRTO EL TRAYECTO- SE AJUSTA A LA MAYORIA DE LOS RECOLECTORES DE ORINA NOCTURNOS O AMBULATORIOS- GARANTIZANDO UNA CONEXION SEGURA. BRINDA DISCRECION DEBAJO DE LA ROPA. VIENE ESTANDAR- LONGITUD REGULAR- DIFERENTES DIAMETROS
2502784	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	RO	A.02.02.01.003.006	CAUCHO SUCCION SILICONADO 1/4 X 7/16	CAUCHO SUCCION SILICONADO X 30 METROS.ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO. DIAMETRO INTERNO 1/4"- DIAMETRO EXTERNO DE 7/16". ROLLO
2584193	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CAUCHO SUCCION SILICONADO7mmX30M. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO TRANSLUCIDO-NO COLAPSABLE	CAUCHO SUCCION SILICONADO 7mmX30M. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX. PARA ASPIRAR FLUIDOS Y SECRECIONES DEL CUERPO EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

2501690	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO-DIAMETRO (Ø) 6-6.4mmX3-3.5M- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAUCHO SUCCION SILICONADO DIAMETRO (Ø) 6-6.4mmX3-3.5M. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX. PARA ASPIRAR FLUIDOS Y SECRECIONES DEL CUERPO EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
2503279	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CAUCHO DE SUCCION EN PVC DIAMETRO (Ø) DE 6mm-LONGITUD 3M-CON CANULA YANKAUER-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAUCHO SUCCION SILICONADO DIAMETRO (Ø) DE 6mm- LONGITUD 3M. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX. TRANSPARENTE. PARA EVACUAR FLUIDOS Y SECRECIONES DEL CUERPO EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
2502399	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CAUCHO SUCCION SILICONADO 3mm X 3M	CAUCHO SUCCION SILICONADO 3mmX3 METROS. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX. PARA SUCCIONAR FLUIDOS Y SECRECIONES DEL CUERPO EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
2503901	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	COLECTOR URINARIO MASCULINO CON TIRA ADHESIVA. FUNDA ELASTICA QUE SE DESLIZA SOBRE EL PENE- DE 30mm DE DIAMETRO	COLECTOR URINARIO MASCULINO CON TIRA ADHESIVA. FUNDA ELASTICA QUE SE DESLIZA SOBRE EL PENE- EN SU EXTREMO DISTAL SE CONECTA LA BOLSA TIRA ADHESIVA DE DOBLE CARA CON MEMORIA- QUE MANTIENE UN AGARRE FIRME. ELABORADO EN CAUCHO NATURAL DE LATEX- ACRILICO ADHESIVO- POLI OFRECIEN
2500242	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	COLECTOR URINARIO PEDIATRICOx500ml	BOLSA DE RECOLECCION PEDIATRICA. ELABORADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. ADHESIVO HIPOALERGENICO. CAPACIDAD Y ESCALA GRADUADA. CONTENEDOR INDIVIDUAL-ESTERIL. PARA EL CONTROL DE LA DIURESIS.
2500921	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR DE MATERIAL BIOLOGICO (CORTOPUNZANTE) EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD-	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- NO CONTENGA PVC NI METALES PESADOS. TAPA DE SELLADO DEFINITIVO. 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS PARA AGUJAS. 1 BOCA PARA DESACOPLAR HOJAS DE BISTURI. 1 BOCA PARA DESACOPLAR AGUJAS LUER-LOCK. RESISTENTE A RUPTURA. ROTULOS DE LLENADO

							CAPACIDAD X 2 LITROS	
2505280	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 2.5 LITROS CORTOPUNZANTES	CONTENEDOR X 2.5 LITROS CORTOCODIGOZANTES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE LIBRE DE MATERIALES PESADOS COLOR CUERPO ROJO Y ROTULO PARA LLENADO
2503974	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 0.75 LITROS- EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTES	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. -RESISTENTE A RUPTURA Y PERFOR JERINGA Y ORIFICIO PARA DESCARTAR AMPOLLETAS (RIESGO QUIMICO). -ROTULADOS DE ACUERDO CON LA CLASE DE RESIDUO (RIESGO BIOLOGICO O RIES NO
2503281	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 1.0 LITROS- EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTES	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. -RESISTENTE A RUPTURA Y PERFOR JERINGA Y ORIFICIO PARA DESCARTAR AMPOLLETAS (RIESGO QUIMICO). -ROTULADOS DE ACUERDO CON LA CLASE DE RESIDUO (RIESGO BIOLOGICO O RIES NO
2503773	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 1.0 LITROS- EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTES	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. -RESISTENTE A RUPTURA Y PERFOR JERINGA Y ORIFICIO PARA DESCARTAR AMPOLLETAS (RIESGO QUIMICO). -ROTULADOS DE ACUERDO CON LA CLASE DE RESIDUO (RIESGO BIOLOGICO O RIES NO
2502710	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 1.3 LITROS+SOPORTE FIJACION PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES	CONTENEDOR X 1.3 LITROS+SOPORTE FIJACION PARA RESIDUOS CORTOCODIGOZANTES REF 13.5 cm ALTO- 14.3 cm ANCHO- COLOR RECIPIENTE ROJO- TRANSLUCIDO- CON SUBTAPA PARA CIERRE TEMPO VISUALIZACION DE LAS ABERTURAS-TAPA SUPERIOR TRANSLUCIDA- CON PERFORACION ESPECIAL PARA LA EXTRACCION DE AGUJAS ROSCADAS Y A PRESION ANC
2501162	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 1.5 LITROS- EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- PARA	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- NO CONTENGA PVC NI METALES PESADOS. TAPA DE SELLADO DEFINITIVO. 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS PARA AGUJAS. 1 BOCA PARA DESACOPLAR HOJAS DE BISTURI. 1 BOCA

							ELEMENTOS CORTOPUNZANTES	PARA DESACOPLAR AGUJAS LUER-LOCK. RESISTENTE A RUPTURA. ROTULOS DE LLENADO
2502709	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 2.8 LITROS+SOPORTE FIJACION-PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES	CONTENEDOR X 2.8 LITROS+SOPORTE FIJACION-PARA RESIDUOS CORTOCODIGOZANTES REF 20 cm ALTO- 16.2 cm ANCHO- CAPACIDAD 2.8 LTS- EN POLIETILENO-COLOR RECIPIENTE ROJO-TRANSLUCIDO- CON SUBTAPA PARA CIERRE TEMPORA VISUALIZACION DE LAS ABERTURAS-TAPA SUPERIOR TRANSLUCIDA- CON PERFORACION ESPECIAL PARA LA EXTRACCION DE AGUJAS ROSCADAS Y A PRESION ANC
2502240	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR DE MATERIAL CORTOPUNZANTE- FORMA CILINDRICA DE COLOR ROJO. POR 2.9/3 LITROS	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO CAPACIDAD X 2.9 LT. DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO. QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. - RESISTENTE A RUPTURA Y PERFORADA- JERINGA Y ORIFICIO PARA DESCARTAR AMPOLLETAS (RIESGO QUIMICO). TAPA SELLADO DEFINITIVO 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS DE AGUJAS CONVENCIONAL. 01 BOCA PARA DESCARTAR AGUJA LUER LOCK - ROTULADOS DE ACUERDO CON LA CLASE DE RESIDUO.
2584179	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR DE MATERIAL BIOLOGICO (CORTOPUNZANTES)CAPACIDAD ENTRE 0.1 LITRO/300ML	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- NO CONTENGA PVC NI METALES PESADOS. TAPA DE SELLADO DEFINITIVO. 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS PARA AGUJAS. 1 BOCA PARA DESACOPLAR HOJAS DE BISTURI. 1 BOCA PARA DESACOPLAR AGUJAS LUER-LOCK. RESISTENTE A RUPTURA. ROTULOS DE LLENADO
2501110	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR DE MATERIAL BIOLOGICO (CORTOPUNZANTES)CAPACIDAD ENTRE 0.2 A 0.4 LITROS	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- NO CONTENGA PVC NI METALES PESADOS. TAPA DE SELLADO DEFINITIVO. 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS PARA AGUJAS. 1 BOCA PARA DESACOPLAR HOJAS DE BISTURI. 1 BOCA PARA DESACOPLAR AGUJAS LUER-LOCK. RESISTENTE A RUPTURA. ROTULOS DE LLENADO
2584155	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR X 2.8 LITROS PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE- EN POLIPROPILENO- RESISTENTE A LA RUPTURA	RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD- NO CONTENGA PVC NI METALES PESADOS. TAPA DE SELLADO DEFINITIVO. 2 BOCAS AUTOEXPULSORAS PARA AGUJAS. 1 BOCA PARA DESACOPLAR HOJAS DE BISTURI. 1 BOCA PARA DESACOPLAR AGUJAS LUER-LOCK. RESISTENTE A RUPTURA. ROTULOS DE LLENADO

2503872	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR MEDIANO 3.5L- RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS	CONTENEDOR MEDIANO 3.5L- RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. RESIS CONTENEDOR- EVITANDO LA PROPAGA CION DE OLORES Y SER FOCO DE MOSQUITOS)- ORIFICIO DE DESCARTE CON ANCLAJANCLAJE PARA AGUJAS CONVENCI CORREADE
2503873	42142531	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR MEDIANO 4.9L- RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS	CONTENEDOR MEDIANO 4.9 5L- RECIPIENTE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC- NI METALES PESADOS. RES CONTENEDOR- EVITANDO LA PROPAGA CION DE OLORES Y SER FOCO DE MOSQUITOS)- ORIFICIO DE DESCARTE CON ANCLAJANCLAJE PARA AGUJAS CONVENCI CORREA
2503911	42311900	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE MEDIANO DE 1/8". ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL- UNA SOLA LUZ- TAMAÑO MEDIANO DE 11.5-12.5mm- LARGO 450mm	DREN DE PENROSE MEDIANO DE 1/8". ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL- UNA SOLA LUZ- TAMAÑO MEDIANO DE 11.5-12.5mm- LARGO 450mm + o - 1 INDIVIDUAL
2500647	42311903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE ANGOSTO 1/2 - ELABORADO EN CAUCHO LATEX O SILICONA - ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	DREN DE PENROSE ANGOSTO 1/2- TUBO PLANO - SUAVE- FLEXIBLE Y DURABILIDAD ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL O SILICONADE ALTA CALIDAD - UNA SOLA LUZ- ESTERIL- DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA FACILITAR LA ELIMINACION EFECTIVA DE LOS EXUDADOS DE LA CARROCERIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2502269	42311903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE DELGADO 1/2	DREN DE PENROSE DELGADO 1/2 - TUBO PLANO - SUAVE Y FLEXIBLE ELABORADO EN CAUCHO

							DE 8-10mm DE ANCHO x 35cm DE LARGO O MAS. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LATEX NATURAL O SILICONA - UNA SOLA LUZ- ESTERIL- EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2565529	42311903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE MEDIANO 1" x 35cm DE LARGO O MAS- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	DREN DE PENROSE DIAMETRO 1" ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502270	42311903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE MEDIANO 1/4 - ELABORADO EN CAUCHO LATEX O SILICONA - ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	DREN DE PENROSE MEDIANO 1/4- TUBO PLANO - SUAVE- FLEXIBLE Y DURABILIDAD ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL O SILICONADE ALTA CALIDAD - UNA SOLA LUZ- ESTERIL- DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA FACILITAR LA ELIMINACION EFECTIVA DE LOS EXUDADOS DE LA CARROCERIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2584136	42311903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	DREN DE PENROSE MEDIANO 2" x 35cm DE LARGO O MAS- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	DREN DE PENROSE MEDIANO 2- TUBO PLANO - SUAVE Y FLEXIBLE ELABORADO EN CAUCHO LATEX NATURAL O SILICONA - UNA SOLA LUZ- ESTERIL- EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2501098	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO ALADO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO N° 21 G X 3/4 X 7	EQUIPO CONSTA- AGUJA CON MANGUERA Y ALETAS FIJADORAS. SAFETY LOCK. CONEXION A SOPORTE PARA AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO N° 21 G X 3/4" X 7". ADULTO
2501099	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO ALADO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO N° 23 G X 3/4 X 7 mm (0.6 X 19 mm) PEDIATRICO	EQUIPO CONSTA- AGUJA CON MANGUERA Y ALETAS FIJADORAS. SAFETY LOCK. CONEXION A SOPORTE PARA AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO N° 23 G X 3/4" x 7". PEDIATRICO
2501100	42142507	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO ALADO PARA EXTRACCION	EQUIPO CONSTA- AGUJA CON MANGUERA Y ALETAS FIJADORAS. SAFETY LOCK. CONEXION A SOPORTE PARA AGUJA PARA EXTRACCION DE

							DE SANGRE AL VACIO N° 25 G X 19 mm X 7	SANGRE AL VACIO N° 25 G X 19 mm X 7". PEDIATRICO
2503187	42294213	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	EQUIPO/SISTEMA DE IRRIGACION-SUCCION PARA LAPAROSCOPIA - ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EQUIPO/SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION DE FLUJO REGULADO PARA LAPAROSCOPIA E HISTEROSCOPIA. SILICONADO EXENTO DE LATEX. LIBRE DE DEHP. ESTERIL. UN SOLO USO. ASA DE MANGO ERGONOMICO. ADAPTACION FLEXIBLE Y UNIVERSAL PARA FRASCOS DE ASPIRACION. CON ESCALA DE VISUALIZACION DE VAL CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION
2502930	42142712	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	EXTRACTOR DE CALCULOS 10mmØ 2.5CHARR. ESTERIL- DE UN SOLO USO-LONG 100-120 cm	EXTRACTOR DE CALCULOS DE 10mm2.5CHARR. ESTERIL- DESCAERTABLE-COMPATIBLE CON URETERORENOSCOPIO ANTERIOR. USO CX ENDOUROLOGICA PARA EX LONG100-120-cm
2500896	41104118	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	FRASCO PARA RECOLECCION Y EXTRACCION DE MUESTRAS DE PATOLOGIA	FRASCO PLASTICO ESTERIL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE BOCA ANCHA CON TAPA ROSCA A PRUEBA DE FUGAS E IDENTIFICADOR.
2504640	41104107	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	FRASCO PARA RECOLECCION Y EXTRACCION DE MUESTRAS DE 30 A 35 ML EN POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE ALTA TRANSPARENCIA	FRASCO RECOLECCION DE MUESTRAS 30-35ML EN POLIETILENO
2505845	41104017	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	FRASCO RECOLECCION MUESTRA 150ml/NO ROSCA	FRASCO RECOLECCION MUESTRA 150ml MATERIAL EN POLIPROPILENO NO ROSCADO DE ALTA TRANSPARENCIA
2505718	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	LINER SEMIRIGIDO FLUIDOS/TAPAROJA 1000ml	LINER SEMIRIGIDO FLUIDOS/TAPAROJA 1000ML CON SISTEMA FLEXIBLE PARA SUCCION DE FLUIDOS HOSPITALARIOS

2584048	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	MANGUERA (TUBO) /CAUCHO PARA SUCCION 8 mm X 3 METROS	MANGUERA (TUBO)/CAUCHO PARA SUCCION EN PVC SILICONADO (MANGUERA DE TRES METROS). DIAMETRO 8 mm- CON CONECTORES EN LSO EXTREMOS- ESTE INDIVIDUAL
2584051	42271715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	MANGUERA EXTENSION PARA OXIGENO (LONGITUD 2 METROS)- CONECTORES ESTANDAR	MANGUERA LISA- PARA EXTENSIONDE OXIGENO- CON CONECTORES ESTANDAR- DE 4 CANALES- QUE GARANTIZA EL FLUJO DE OXIGENO- AUN CUANDO LA MA INDIVIDUAL
2584052	42271715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA- CON ADAPTADOR DE 22 mm- USO ADULTO	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA- EN PLASTICO GRADO MEDICO- TRANSPARENTE- CON BANDA ELASTICA CON BROCHE- ADPATADOR DE 22 mm- CON ROTACION3 ADULTO
2584178	41104118	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	PERILLA DE SUCCION- ELABORADA EN CAUCHO	PERILLA DE SUCCION- ELABORADA EN CAUCHO NATURAL CON UNA FORMA CONTORNEADA- REUTILIZABLE- PARA LA SUCCION Y EXTRACCION DE LIQUIDOS EN EL ORGANISMO
2502235	42294213	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BIOPSIA DESC/COPA OVALADA.ABERTURA BIL.DE 7.3mm COMPATIBLE CON FIBROGASTROSCOPIO CANAL DE 2.8mm.P.ACT. 0.3mm.LONG170-200cm	PINZA DE BIOPSIA DESCARTABLE OVALADA CON FILO EN LA COPA. ABERTURA BILATERAL DE 7.3mm FLEXIBLE ATRAUMATICA.AGUJERO INCORPORADO EN E BIOPSIAS DEL TEJIDO GASTRICO.COMPATIBLE CON FIBROGASTROSCOPIOS. CANAL DE 2.8mm.P.ACT.0.3mm LONG170-200cm
2502234	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA EN CUCHARA OVAL PEQUEÑA SIN AGUJA 1.8mm Ø DESCARTABLE. PARA BIOPSIA.EN COLONOSCOPIA LONG 160-180 cm	PINZA EN CUCHARA OVAL PEQUEÑA SIN AGUJA 1.8mm DE DIAMETRO. MANGO CON CONECTOR UNIVERSAL AF DE 3mm. DESCARTABLE. USO- PROCEDIMIENTOS DE COLONOSCOPIA LONG160-180cm

2504532	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE PEREZ CASTRO 4 CHARR LONG 60cm. RIGIDA CON MANDIBULAS LARGAS- ABERTURA BILATERAL	PINZA DE PEREZ CASTRO 4 CHARR LONG 60cm. RIGIDA CON MANDIBULAS LARGAS PARA CALCULOS DISPUESTOS EN SECUENCIA-MODELO RIGIDO. ABERTURA BILATERAL.
2501369	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	RECIPIENTE HERMETICO PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES 1.0 LITRO SIN TAPA	RECIPIENTE HERMETICO PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES 1.0 LITRO SIN TAPA CON SOLIDIFICANTE
2501372	42281509	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL Y NO ESTERIL	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL Y NO ESTERIL
2504470	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	RECIPIENTEN RIGIDO CON TAPA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS. CAPACIDAD 1500ML. CON FILTRO HIDROFOBICO.	RECIPIENTEN RIGIDO CON TAPA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS. CAPACIDAD 1500ml. CON FILTRO HIDROFOBICO. EFICIENCIA DE FILTRACI TAPA SUPERIOR QUE DETIENE GOTAS O DERRAMES. FACILIDAD DE USO- GRADUACION DE FACIL LECTURA.INCLUYE CONECTOR UNIVERSAL EN ANGULO.
2502944	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	RESERVORIO FRASCO PARA SUCCIONADOR SEGUN MODELO DE LA INSTITUCION	RESERVORIO FRASCO PARA SUCCIONADOR CON TAPA EN CAUCHO REUTILIZABLE
2503691	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE DRENAJE DE SILICONA ESTERIL DE 10 FR - 15F - 10FR Y 24 FR CON RESERVORIO	SISTEMA DE DRENAJE DE SILICONA ESTERIL DE 10 FR - 15F - 10FR Y 24 FR CON RESERVORIO DE 150 ML - 300ML Y BULBO DE SUCCION DE 100 ML

							DE 150 ML - 300ML Y BULBO DE SUCCION DE 100 ML	
2500906	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 2 CAMARAS 1200 CC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON DOS CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 1200- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable
2500907	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 2 CAMARAS 2000 CC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON DOS CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 2000 CC- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable
2500908	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 2 CAMARAS 2400 CC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON DOS CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 2400- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable
2500909	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 3 CAMARAS 1000/1400 CC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON TRES CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 1000/1400CC- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable
2500910	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 3 CAMARAS 2000 CC- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON TRES CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 2000 CC- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable

							PAPEL GRADO MEDICO	
2500911	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE TORAX 3 CAMARAS 2400 CC- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO/CERRADO CON TRES CAMARAS- CAPACIDAD DE LA CAMARA DE 2400 CC- PARA RECOLECCION DE LIQUIDO PLEURAL. ESTERIL GRADO MEDICO CON Indicador visual de funcionamiento y escapes de aire Soporte para colocar en piso y agarraderas para colgar en cama 100 % libre de lAtex- EstEril y descartable
2502329	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 1/4 O 18FR-EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO DE 1/4 O 18FR. QUE FUNCIONA CON PRESION NEGATIVA. RESERVORIO DE 400 ML. DISEÑO RESERVORIO +-3 RESORTES VALVULA ANTIFLUJO TUBO CONECTOR- VALVULA DE ACOPLE- PARED TRANSPARENTE LIBRE DE LATEX. CON TUBO DE DRENAJO REDONDO. TUBO EVACUADOR. ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO- FECHA VENCIMIENTO Y LOTE.
2502330	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 1/8 O 10FR-EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO DE 1/8 O 10FR. QUE FUNCIONA CON PRESION NEGATIVA. RESERVORIO DE 400 ML. DISEÑO RESERVORIO +-3 RESORTES VALVULA ANTIFLUJO TUBO CONECTOR- VALVULA DE ACOPLE- PARED TRANSPARENTE LIBRE DE LATEX. CON TUBO DE DRENAJO REDONDO TUBO EVACUADOR. ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO. PRESENTACION EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO- FECHA VENCIMIENTO Y LOTE.
2500296	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC.LLAVE DE DRENAJE QUE E VITA EL GOTEO CUANDO ESTE CERRADA.ESCALA DE MEDICION.FONDOB ATRAPABACTERIAS- CON SISTEMA CERRADO (CONECCION SONDA FOLEY)-PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS. ESTERIL-DESCARTABLE. VALVULA ANTIRREFLUJO- CON EMPAQUE INDIVIDUAL
2500429	42142710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DRENAJE URINARIO 2000ml	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO 2000CC.LLAVE DE DRENAJE QUE EVITA EL GOTEO CUANDO ESTE CERRADA.ESCALA DE MEDICION.FONDO BLANCO QUE ATRAPA BACTERIAS-ESCALA DE 5 CC- POSEE SISTEMA CERRADO- CONECCION A SONDA FOLEY- PUERTO

								PARA TOMA DE MUESTRAS- CON VALVULA ANTIRREFLUJO INDIVIDUAL
2584036	42142710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DRENAJE URINARIO PEDIATRICO DE 500 CC CON VALVULA ANTIRREFLUJO	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO DE 500 CC LLAVE DE DRENAJE QUE EVITA EL GOTEO CUANDO ESTE CERRADA. ESCALA DE MEDICION EXTERNA. FONDO BLANCO CON ESCALA DE 5 CC- POSEE SISTEMA CERRADO CON CONECCION A SONDA FOLEY- PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS- CON VALVULA ANTIRREFLUJO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2500294	42142710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DRENAJE URINARIO DE 2000ml SIN VALVULA ANTIRREFLUJO	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO DE 2000 CC LLAVE DE DRENAJE QUE EVITA EL GOTEO CUANDO ESTE CERRADA. ESCALA DE MEDICION EXTERNA. FONDO BLANCO CON ESCALA DE 5 CC- POSEE SISTEMA CERRADO CON CONECCION A SONDA FOLEY- PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS- SIN VALVULA ANTIRREFLUJO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2500295	42142710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA CERRADO DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500ml SIN VALVULA ANTIRREFLUJO	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE URINARIO DE 500 CC LLAVE DE DRENAJE QUE EVITA EL GOTEO CUANDO ESTE CERRADA. ESCALA DE MEDICION EXTERNA. FONDO BLANCO CON ESCALA DE 5 CC- POSEE SISTEMA CERRADO CON CONECCION A SONDA FOLEY- PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS- SIN VALVULA ANTIRREFLUJO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2500900	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 350 ML 3.2X1/8 VACIO- CON CONECTOR- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DRENAJE 350 ml 3.2mmx1/8" EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON RESERVORIO DE VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR EN ACERO INOXIDAB CON MANIPULACION
2500901	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 350 ML 4.8X3/16 VACIO- CON CONECTOR- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DRENAJE 350 ml 4.8mmx3/16". EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL RESERVO RIO DE VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR EN ACERO INOXIDABLE CON MANIPULACION
2500902	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 350 ML 6.4X1/4 VACIO- CON CONECTOR-	SISTEMA DRENAJE 350 ml 6.4mmx1/4". EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON RESERVORIO DE VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR EN ACERO INOXIDA CON MANIPULACION

							ESTEROL-EMPAQUE INDIVIDUAL	
2500903	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 400 ML 3.2X1/8 VACIO- CON CONECTOR-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DRENAJE 400 ml 3.2mmx1/8" EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON RESERVORIO VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR ACERO INOXIDABLE CON MANIPULACION
2500904	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 450 ML 4.8X3/16 VACIO- CON CONECTOR-EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DRENAJE 450 ml 4.8mmx3/16". EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON RESERVORIO DE VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR EN ACERO INOXIDO CON MANIPULACION
2500905	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE 450 ML CON 6.4X1/4 VACIO CON CONECTOR-EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DRENAJE 450 ml 6.4mmx1/4". EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON RESERVORIO DE VACIO EN PVC TRANSPARENTE TROCAR EN ACERO INOXIDA CON MANIPULACION
2587072	41104105	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 10mm. DISPOSITIVO DESECHABLE PARA SER COMO RECEPTACULO DE RECOGIDA Y EXTRACCION D	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 10mm. DISPOSITIVO DESECHABLE NO POROSO- RESISTENTE A LA TRACCION Y DESGARRO- ANILLO DESMONTABLE PARA BOLSA DE EXTRACCION- CON VARILLA DE ACCIONAMIENTO CON FUNDA DE INSERCION CON MANGO ERGONOMICO- ANILLO METALICO DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICOS- BOLSA DE MUESTRA DE POLIURETANO INDIVIDUAL
2587073	41104105	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 12mm. DISPOSITIVO DESECHABLE PARA SER COMO	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 12mm. DISPOSITIVO DESECHABLE NO POROSO- RESISTENTE A LA TRACCION Y DESGARRO- ANILLO DESMONTABLE PARA BOLSA DE EXTRACCION- CON VARILLA DE ACCIONAMIENTO CON FUNDA DE INSERCION CON MANGO ERGONOMICO- ANILLO METALICO DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICOS- BOLSA DE MUESTRA DE POLIURETANO INDIVIDUAL

							RECEPTACULO DE RECOGIDA Y EXTRACCION D	
2587074	41104105	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 15mm. DISPOSITIVO DESECHABLE PARA SER COMO RECEPTACULO DE RECOGIDA Y EXTRACCION D	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 15mm. DISPOSITIVO DESECHABLE NO POROSO- RESISTENTE A LA TRACCION Y DESGARRO- ANILLO DESMONTABLE PARA BOLSA DE EXTRACCION- CON VARILLA DE ACCIONAMIENTO CON FUNDA DE INSERCION CON MANGO ERGONOMICO- ANILLO METALICO DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICOS- BOLSA DE MUESTRA DE POLIURETANO INDIVIDUAL
2587071	42294954	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 5mm. DISPOSITIVO DESECHABLE PARA SER COMO RECEPTACULO DE RECOGIDA Y EXTRACCION DE	SISTEMA DE RETIRADA DE ESPECIMENES DE LAPAROSCOPIA 5mm. DISPOSITIVO DESECHABLE NO POROSO- RESISTENTE A LA TRACCION Y DESGARRO- ANILLO DESMONTABLE PARA BOLSA DE EXTRACCION- CON VARILLA DE ACCIONAMIENTO CON FUNDA DE INSERCION CON MANGO ERGONOMICO- ANILLO METALICO DE APERTURA Y CIERRE AUTOMATICOS- BOLSA DE MUESTRA DE POLIURETANO INDIVIDUAL
2504448	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DEL ADULTO Nº 14. COMPONENTES - SONDA TRANSPARENT FLEXIBLE- PUNTA ROMA- 3 ORIFICIOS- NUMERADA C/2C	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DEL ADULTO Nº 14. COMPONENTES- SONDA TRANSPARENT FLEXIBLE- CODIGO ROMA- 3 ORIFICIOS- NUMERADA C/2cm- ATRAU RESISTENTE A LA TRACCION. VALVULA DE SUCCION CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. ADAPTADOR PARA CAUCHO DE SUCCION ESCALONADO CON TAPA
2501685	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 12 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 12 FR- CON CODIGO-ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE

								INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501681	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 6 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 6 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501684	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 10 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 10 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501686	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 14 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 14 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501687	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 16 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 16 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2503402	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 4 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 4 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501680	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 5 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 5 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE

								INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501682	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 7 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 7 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2501683	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 8 FR	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO N° 8 FR- CON CODIGO ATRAUMATICA- ANTIESTATICO- CON 2 ORIFICIOS LATERALES Y UNO CENTRAL- CONECTOR GIRATORIO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL- VALVULA DIGIVENT CON PUERTO DE ENTRADA PARA LA JERINGA DE INSTILACION- SONDA CON PROTECCION INDIVIDUAL.
2500025	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 10	SONDA DE SUCCION N°10 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE
2500026	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 12	SONDA DE SUCCION N°12 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE
2500027	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 14	SONDA DE SUCCION N°14 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON

								SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE
2500028	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 16	SONDA DE SUCCION N°16 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE
2500023	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 6	SONDA DE SUCCION N°6 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE
2500024	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA DE SUCCION NO. 8	SONDA DE SUCCION N°8 EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE- GRADO MEDICO- TUBO DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO PLASTICO EN SU PARTE ANTERIOR- CON CODIGO CERRADA Y REDONDA- NO TRAUMATICA- FLUIDOS ORGANICOS- FLEXIBLE Y RESISTENTE- CON SISTEMA DE VALVULA DE PASO ACCIONADO CON EL DEDO. ATOXICA- EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEÑAL APERTURA- LIBRE DE LATEX- CON IDENTIFICACION DE COLORES POR TAMAÑO. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE

2587227	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA FOLEY 16 FR DE TRES VIAS	SONDA VESICAL 16 FR DE 3 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. EL EXTREMO PROXIMAL DE DOBLE ESTANDAR PUEDE SER DE 5/20ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40cmS DE LONGITUD- EN CAUCHO LATEX GRADO MEDICO- CODIGO RESALTADO PARA FACILITAR LA VISUALIZACION. POSEE UN BALON PARA SU FIJACION VESICAL. PRODUCTO ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
2501168	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA FOLEY 18 FR DE TRES VIAS	SONDA VESICAL 18 FR DE 3 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. EL EXTREMO PROXIMAL DE DOBLE ESTANDAR PUEDE SER DE 5/20ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40cmS DE LONGITUDD- EN CAUCHO LATEX GRADO MEDICO- CODIGO RESALTADO PARA FACILITAR LA VISUALIZACION. POSEE UN BALON PARA SU FIJACION VESICAL. PRODUCTO ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
2503814	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR EN SILICONA	SONDA VESICAL 12 FR DE 2 VIAS 100% SILICONA- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. EL EXTREMO PROXIMAL DE DOBLE ESTANDAR- PUEDE SER DE 5/15ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40cmS DE LONGITUD
2587197	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA LUBRICADA CATETERIZACION URINARIA 45cm	SONDA URINARIA LUBRICADA DE 45 cm ESTERIL- DE BAJA FRICCION- LISTA PARA SU USO- PARA LA CATETERIZACION URINARIA INTERMITENTE. COMPOSICION EN PVC. LUBRICANTE EN HIDROGEL DE GLICERINA. SUAVES ORIFICIOS- OJOS ATRAUMATICOS- PULIDOS Y SIN ARISTAS- QUE PERMITEN EL FLUJO DE ORINA. CONECTOR UNIVERSAL ADAPTADO PARA TODAS LAS BOLSAS DE ORINA. CADA DIAMETRO ESTA IDENTIFICADO POR EL COLOR DEL CONECTOR. EMBALAJE- CUBIERTA PROTECTORA INDIVIDUAL ESTERIL. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA FACILITAR SU MANIPULACION- APERTURA DE LOS EXTREMOS DISTAL Y PROXIMAL- ASI COMO- LAS MANIOBRAS DE INSERCION Y RETIRADA DE LA SONDA.
2500933	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON # 6	SONDA SILICONADA NELATON DE 6 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA

								EN PVC DE 40 cm DE LONGITUDD- PROVISTA DE UN EMBUDO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500934	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON # 8	SONDA SILICONADA NELATON DE 8 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO -ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500935	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON #10	SONDA SILICONADA NELATON DE 10 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500936	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON #12	SONDA SILICONADA NELATON DE 12 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO -ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500937	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON #14	SONDA SILICONADA NELATON DE 14 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO - PAQUETE ESTERIL- CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2500938	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON #16	SONDA SILICONADA NELATON DE 16 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500939	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SILICONIZADA NELATON #18	SONDA SILICONADA NELATON DE 18 FR EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO TRANSPARENTE- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE-ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- PROVISTA DE UN EMBUDO -ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501688	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SISTEMA SUCCION CERRADO #14 FR X 580mm	SONDA DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO # 14 FR X 580mm.CALIBRE 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON CODIGO ROMA.CON CONECTOR GIRATORIO.SONDA DE INHALACION

2500190	42142402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA SUCCION CERRADA TRAQUEOSTOMIA #14- ESTERIL. DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA SUCCION CERRADA TRAQUEOSTOMIA #14 EMPAQUE INDIVIDUAL RECUBIERTO DE UNA BOLSA PROTECTOREA DE UN POLIMERO ESPECIAL ESTERIL.DESECHABLE CON CODIGO ROMA Y MATERIAL FLEXIBLE CON CONECTOR GIRATORIO EN LOS PACIENTES REDUCE EL PORCENTAGE DE INFECCION NOSOCOMIAL
2503084	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY EN SILICONA 20X5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY EN SILICONA 20X5-15CC DE 2 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. EL EXTREMO PROXIMAL DE DOBLE ESTANDAR PUEDE SER DE 5/15ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40cmS DE LONGITUD
2500942	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 10 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 10 X 5-15 CC DE 2 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500943	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 12 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 12 X 5-15CC DE 2 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500944	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 14 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No 14 X 5-15 CC DE 2 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20ML- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500945	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 16 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No 16 X 5-15 CC DE 2 VIAS- CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml- DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD

2500946	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 18 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No.18 X 5-15 CC DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500950	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 20 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 20 X 30 CC DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500953	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 20 X 30CC 3 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 20 X 30 CC DE 3 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500947	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 20 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 20 X 5-15 CC DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500951	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 22 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 22 X 30 CC DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500954	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 22 X 30CC 3 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 22 X 30 CC DE 3 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD

2500948	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 22 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 22 X 5-15CC DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/2 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500952	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 24 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 24 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500955	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 24 X 30CC 3 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 24 X 30 ml DE 3 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500949	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 24 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 24 X 5-15 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500956	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 26 X 30CC 3 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 26 X 30 ml DE 3 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2500940	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 6 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 6 X 5-15 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD

2500941	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY 8 X 5-15CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 8 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2505588	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY No. 12 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 12 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2505704	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY No. 14 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 14 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2505589	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY No. 16 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 16 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD
2505590	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA VESICAL FOLEY No. 18 X 30CC 2 VIAS	SONDA VESICAL FOLEY No. 18 X 30 ml DE 2 VIAS-CON EXTREMO DISTAL RECTO Y CODIGO CILINDRICA CERRADA- CON 2 ORIFICIOS LATERALES. CON BALON INTERNO CON CAPACIDAD QUE PUEDE SER DE 5/20 ml-DEPENDIENDO DEL CALIBRE DEL CATETER- ES RESISTENTE Y SIMETRICO- DE 40 cmS DE LONGITUD

2503347	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 20FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 20 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2503348	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 22FR- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO	SONDA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO. PVC SILICONIZADO. ATOXICO. LIBRE DE LATEX. LIBRE DE DOP. LIBRE DE DEHP. FLEXIBLE. ESTERIL. CON EMBUDO EN PARTE SUPERIOR. EXTREMO INFERIOR CERRADO.
2503349	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 24FR.	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 24 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUDD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2504669	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 4FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 4 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y

								MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2503346	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 6FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 6 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2500913	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 8FR.	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 8 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2500914	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 10FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 10 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.

2500915	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 12FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 12 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2500916	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 14FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 14 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANIPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA.
2500917	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 16 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANPULACION- ESTERIL- EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA
2500918	42231701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 18FR	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 18 TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- LIBRE DE LATEX- BIOCOMPATIBLE- ANTIADHERENTE- TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- TERMOSENSIBLE- DE 85/115cm DE

								LONGITUD- ALTERNANDO POR TAMAÑOS ADECUADOS-EXTREMO PROXIMAL CON ADAPTADOR QUE FACILITE ACOPLAR A LAS NECESIDADES- DE FACIL MANPULACION- ESTERIL-EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE- CON CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA- Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA SONDA
2584113	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 10	SONDA NELATON N°10 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL- SILICONA-NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"-TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS
2584114	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 12	SONDA NELATON N°12 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL-SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS
2584115	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 14	SONDA NELATON N°14 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL-SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS

2584116	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 16	SONDA NELATON N°16 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL-SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS
2584117	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 18	SONDA NELATON N°18 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL-SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS
2504188	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 20	SONDA NELATON N°20 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE-ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL-SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS

2504642	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 4	SONDA NELATON N°4 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE- ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL- SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584118	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 6	SONDA NELATON N°6 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE- ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL- SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA
2584119	42142702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	SONDA NELATON N° 8	SONDA NELATON N°8 EN MATERIAL PLASTICO SILICONIZADO GRADO MEDICO- TERMOSENSIBLE- ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 cm DE LONGITUD- ESTERIL. EMPAQUE IDIVIDUAL EN PAPEL GRADO MEDICO- MATERIAL- SILICONA- NO CONTIENE LATEX- CODIGO ENVASADA UNITARIAMENTE EN ENVASE TIPO "PEEL-PACK"- TEXTURA UNIFORME Y TRANSPARENTE- EL EXTREMO DE LA SONDA ES CERRADO- ACABADO EN CODIGO ROMA SIN ORIFICIO- TIENE DOS ORIFICIOS LATERALES CON CANTOS REDONDEADOS- CON CAPUCHON ADAPTABLE A BOLSAS COLECTORAS. CON IDENTIFICACION DE FECHA DE CADUCIDAD- NUMERO DE LOTE- REGISTRO INVIMA

2500970	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 38 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 38 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500971	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 40 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 40 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2505751	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO TORAX No.10 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 10 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500957	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 12 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 12 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.

2500958	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 14 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 14 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500959	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 16 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 16 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500960	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 18 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 18 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500961	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 20 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 20 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.

2500962	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 22POR 45 cm	TUBO TORAX No. 22 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500963	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 24 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 24 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500964	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 26 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 26 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500965	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 28 POR 45cm	TUBO TORAX No. 28 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.

2500966	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 30 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 30 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500967	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 32 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 32 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD-CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500968	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 34 POR 45 cm	TUBO TORAX No. 34 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD-CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500969	42144102	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE TORAX N° 36 POR 45cm	TUBO TORAX No. 36 TUBO DE POLIVINILO/PVC-TERMOSENSIBLE- SILICONADO- TRANSPARENTE-CON ACABADO DESLIZANTE PARA FACILITAR SU PASO. CON 6 ORIFICIOS DE 45 cm DE LONGITUD-CODIGOTO EN FORMA DE BISEL. EXTREMO DISTAL ABIERTO EXTREMO PROXIMAL EN FORMA DE BURBUJA.CALIBRADO EN cmS- CON LINEA RADIOPACA- SIRVE PARA DRENAR AIRE- LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL. USO UNICO.DESCARTABLE- ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.

2505445	42142403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-2	C/U	A.02.02.01.003.006	VALVULAS DE SUCCION AIRE/AGUA ENDOSCOPIO	VALVULAS DE SUCCION AIRE/AGUA ENDOSCOPIO DE UN SOLO USO ELIMINAN LA NECESIDAD DE LIMPIEZA Y REPROCESAMIENTO MANUAL. EL DISPOSITIVO ESTA DESTINADO COMO PARTE DEL PROCESO DE LIMPIEZA PREVIA- AYUDA A LIMPIAR EL CANAL DE AIRE/AGUA DE LOS ENDOSCOPIOS. EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE. DESECHABLE-DE UN SOLO USO PARA EVITAR LA CONTAMINACION CRUZADA
GRUPO ADMINISTRACION DE OXIGENO Y TERAPIA RESPIRATORIA								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2501698	42271906	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	AGUJA TRANSTRAQUEAL 5 FR ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL- NO COLAPSABLE REFORZADO- DIAMETRO INTERNO 2-3 mm-AGUJA DE CODIGO NO.15- CATETER FR 5 CON UNA LONGITUD DE 5 O 7-5 CM. ESTE CATETER TIENE UN ANILLADO QUE LE CONFIERE CIERTA RIGIDEZ PARA EVITAR ACODADURAS Y UN CONECTOR LUER-LOCK
2501699	42271906	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	AGUJA TRANSTRAQUEAL 6 FR-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL- NO COLAPSABLE REFORZADO- DIAMETRO INTERNO 2-3 mm-AGUJA DE CODIGO NO.15- CATETER 6FR CON UNA LONGITUD DE 5 O 7-5 CM. ESTE CATETER TIENE UN ANILLADO QUE LE CONFIERE CIERTA RIGIDEZ PARA EVITAR ACODADURAS Y UN CONECTOR LUER-LOCK
2500293	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR CON PUERTO DE CAPNOGRAFIA-ESTERIL-COMPATIBLE CON MASCARA DE OXIGENO ADULTO INDIVIDUAL	ADAPTADOR DE VIA AEREA PARA CAPNOGRAFO EMPAQUE INDIVIDUAL- ESTERIL-COMPATIBLE CON MASCARA DE OXIGENO ADULTO- CON TUBO EN T-CABLE DE EXTENSION A CAPNOGRAFO ADAPTABLE SEGUN EL EQUIPO- CON EMPATE PARA CADA EQUIPO
2500618	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR PLASTICO EN T PARA OXIGENOTERAPIA	ADAPTADOR PARA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y AEROSOLTERAPIA ELABORADO EN PVC- FACIL INSTALACION-ADAPTADOR DE TUBO O2 PARA MANGUERA DE MAQUINA DE RESPIRACION- EMPAQUE INDIVIDUAL

2505495	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR NASAL DE NCPAP-PS GRANDE	EL ADAPTADOR NASAL CPAP UNA CANULA- A CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA RESPIRATORIA) CONSTA DE UN CODO INSPIRATORIO Y UNO ESPIRATORIO- EL ADAPTADOR FUNCIONARA ENTRE CUALQUIER MAQUINA Y TUBO O LIMPIADOR Y TUBO- ASI COMO CONECTAR UN TUBO O MANGUERA A OTRO- ADAPTADOR ESTANDAR-
2505494	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR NASAL DE NCPAP-PS MEDIANO	EL ADAPTADOR NASAL CPAP UNA CANULA- A CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA RESPIRATORIA) CONSTA DE UN CODO INSPIRATORIO Y UNO ESPIRATORIO- EL ADAPTADOR FUNCIONARA ENTRE CUALQUIER MAQUINA Y TUBO O LIMPIADOR Y TUBO- ASI COMO CONECTAR UN TUBO O MANGUERA A OTRO- ADAPTADOR ESTANDAR
2505493	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR NASAL DE NCPAP-PS PEQUEÑO	EL ADAPTADOR NASAL CPAP UNA CANULA- A CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA RESPIRATORIA) CONSTA DE UN CODO INSPIRATORIO Y UNO ESPIRATORIO- EL ADAPTADOR FUNCIONARA ENTRE CUALQUIER MAQUINA Y TUBO O LIMPIADOR Y TUBO- ASI COMO CONECTAR UN TUBO O MANGUERA A OTRO- ADAPTADOR ESTANDAR
2505496	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	ADAPTADOR NASAL DE NCPAP-PS XL	EL ADAPTADOR NASAL CPAP UNA CANULA- A CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA RESPIRATORIA) CONSTA DE UN CODO INSPIRATORIO Y UNO ESPIRATORIO- EL ADAPTADOR FUNCIONARA ENTRE CUALQUIER MAQUINA Y TUBO O LIMPIADOR Y TUBO- ASI COMO CONECTAR UN TUBO O MANGUERA A OTRO- ADAPTADOR ESTANDAR
2504250	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	GLN	A.02.02.01.003.006	ARNES PARA SUJECION DE MASCARA FACIAL DE ANESTESIA Y VENTILACION DEL ADULTO. FABRICADO EN SILICONA. REUTILIZABLE	ARNES PARA SUJECION DE MASCARA FACIAL DE ANESTESIA Y VENTILACION DEL ADULTO. FABRICADO EN SILICONA. REUTILIZABLE
2584769	42272302	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR ADULTO- AUTOCLAVABLE	RESUCITADOR MANUAL ADULTO COMPUESTO POR MASCARA - VALVULA UNIDIRECCIONAL - BOLSA DE SILICONA (REUTILIZABLE) O PVC CONECTOR DE TUBO EN POLICARBONATO O POLISULFONA - ANGULO GIRO DE 360° - BOLSA

								RECIRCULANTE Y MANGUERA PARA LA CONEXION DE OXIGENO.
2584167	42272302	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR NEONATAL-AUTOCLAVABLE	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL COMPUESTO POR MASCARA - VALVULA UNIDIRECCIONAL - BOLSA DE SILICONA (REUTILIZABLE) O PVC CONECTOR DE TUBO EN POLICARBONATO O POLISULFONA - ANGULO GIRO DE 360° - BOLSA RECIRCULANTE Y MANGUERA PARA LA CONEXION DE OXIGENO.
2565527	42272302	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR PEDIATRICO-AUTOCLAVABLE	BALON DE VENTILACION/RESUCITADOR-CON SUS ACCESORIOS (BOLSA DE SILICONA- CONECTOR DEL PACIENTE- CONECTOR ESPIRATORIO-CONECTOR DEL MA AUTOCLAVE
2502683	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	BOQUILLAS PARA ESPIROMETRO DESCARTABLE PARA SENSOR SP-20	BOQUILLA PARA ESPIROMETRIA- COMPATIBLE CON EQUIPO SCHILLER SP-20 PARA SOFTWARE CS-200- CON LARGO DE 6 cms Y DIAMETRO De 2-7cms- MAT PLASTIIFCADO
2503598	42270000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.004	CAL SODADA GRADO MEDICO CANECA POR 33 LIBRAS-DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE	LA CAL SODADA ES UN DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE- MEZCLA DE HIDROXIDOS ACTIVOS (CALCIO Y SODIO)-INODORO- LEVEMENTE SOLUBLE- ASPECTO CONTENIDO EN EL AIRE ESPIRADO DEL PACIENTE. DE ELEVADA CAPACIDAD DE ABSORCION- ESCASA FORMACION DE POLVO. CAL SODADA GRADO MEDICO.R LIBRAS
2504522	42270000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.004	CAL SODADA GRADO MEDICO CONTENEDOR POR 37 LIBRAS-DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE	LA CAL SODADA ES UN DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE- MEZCLA DE HIDROXIDOS ACTIVOS (CALCIO Y SODIO)-INODORO- LEVEMENTE SOLUBLE- ASPECTO CONTENIDO EN EL AIRE ESPIRADO DEL PACIENTE. DE ELEVADA CAPACIDAD DE ABSORCION- ESCASA FORMACION DE POLVO. CAL SODADA GRADO MEDICO.C LIBRAS
2503808	42270000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.004	CAL SODADA GRADO MEDICO x 5 LITROS-DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE	LA CAL SODADA ES UN DIOXIDO DE CARBONO ABSORBENTE- MEZCLA DE HIDROXIDOS ACTIVOS (CALCIO Y SODIO)-INODORO- LEVEMENTE SOLUBLE- ASPECTO CONTENIDO EN EL AIRE ESPIRADO DEL PACIENTE. DE ELEVADA CAPACIDAD DE ABSORCION- ESCASA FORMACION DE POLVO. CAL SODADA GRADO MEDICO- POR 5 LITROS
2501727	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL-	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #4 EN CLORO DE PLIVINILO-EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO-BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA

							EMPAQUE INDIVIDUAL	RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501735	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #4 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501728	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4.5 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #4.5 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501729	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 5 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #5 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501730	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 5.5 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #5.5 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501731	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #6 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2500019	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6 CON NEUMATOPONA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR EN PVC SILICONIZADA N° 6 - EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- PAQUETE

							DOR EMPAQUE INDIVIDUAL	INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2501732	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6.5 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #6.5 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501218	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7 CON NEUMATOPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR ELABORADA EN PVC SILICONIZADA N° 7 - EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2500017	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7-5 CON NEUMATOPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR ELABORADA EN PVC SILICONIZADA N° 7.5- EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2501733	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8.5 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #8.5 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501175	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 9 CON NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON ELABORADA EN PVC DE GRADO MEDICO SILICONIZADA #9 EN CLORO DE PLIVINILO- EMPAQUE INDIVIDUAL placa de fijaciOn al cuello flexible y anatOmica ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- LINEA RADIOPACA- BORDE SUAVE- INDIVIDUAL- ATOXICO.
2501183	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6 SIN NEUMATOPONADOR- EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMATOPONADOR- NO FENESTRADA N° 6- CON ENDOCANULA-EN PVC. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL

2504445	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR- NO FENESTRADA N°7- CON ENDOCANULA. ESTERIL. EMPAQUE INFDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR- NO FENESTRADA N°7- CON ENDOCANULA- EN PVC. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2500018	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7.5 SIN NEUMATOPONADOR- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMO TAPONADOR CON BALON ELABORADA EN PVC SILICONIZADA #7.5. EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE: FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2501080	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 9 SIN NEUMATOPONADOR- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMO TAPONADOR CON BALON ELABORADA EN PVC SILICONIZADA #7.5. EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE: FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2500073	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL/MAYO PEDIATRICA N°2- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE (GUEDEL O MAYO N 2) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500072	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL/MAYO ADULTO N°3. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE (GUEDEL O MAYO N 3) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500076	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL/MAYO ADULTO N°4. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE (GUEDEL O MAYO N 4) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500071	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL/MAYO ADULTO N°5. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE (GUEDEL O MAYO N 5) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.

2502305	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL/MAYO ADULTO N°6. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE (GUEDEL O MAYO N° 6) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500075	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL MAYO PEDIATRICA N°0- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE PEDIATRICA (GUEDEL O MAYO N° 0) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500077	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL MAYO PEDIATRICA N°00- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE PEDIATRICA (GUEDEL O MAYO N° 00) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2504870	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL MAYO PEDIATRICA N°000- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE PEDIATRICA (GUEDEL O MAYO N° 000) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500074	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL MAYO PEDIATRICA N°1- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE PEDIATRICA (GUEDEL O MAYO N° 1) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2504871	42271705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA GUEDELL MAYO PEDIATRICA N°1.5- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA OROFARINGE PEDIATRICA (GUEDEL O MAYO N° 1.5) FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ATOXICO- TRANSPARENTE- CON SUPERFICIE LISA- ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSION ACCIDENTAL- EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500185	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL ADULTO- EMPAQUE INDIVIDUAL.	CANULA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO ADULTO- AJUSTABLE SOBRE EL OIDO- DE CODIGOS SILICONIZADAS (ATRAUMATICAS)-EN MATERIAL PLASTICO NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES- LUMEN NO COLAPSABLE- ATOXICA- LIBRE DE LATEX. SISTEMA DE AGARRE DEL MISMO MATERIAL DEL MEDICO

42271709	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL NEONATAL-EMPAQUE INDIVIDUAL.	CANULA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO NEONATAL- AJUSTABLE SOBRE EL OIDO- DE CODIGOS SILICONIZADAS (ATRAUMATICAS)-EN MATERIAL PLASTICO NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES- LUMEN NO COLAPSABLE-ATOXICA- LIBRE DE LATEX. SISTEMA DE AGARRE DEL MISMO MATERIAL DEL MEDICO
42271709	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL PEDIATRICA-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO PEDIATRICO- AJUSTABLE SOBRE EL OIDO- DE CODIGOS SILICONIZADAS (ATRAUMATICAS)-EN MATERIAL PLASTICO NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES- LUMEN NO COLAPSABLE-ATOXICA- LIBRE DE LATEX. SISTEMA DE AGARRE DEL MISMO MATERIAL DEL MEDICO
42271709	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL TERAPIA ALTO FLUJO T/M	CANULA NASAL TERAPIA ALTO FLUJO T/M LA GAMA DE CANULAS NASALES DE FLUJO ALTO PROPORCIONA SOPORTE RESPIRATORIO PARA PACIENTES ADULTOS Y ES ADECUADA PARA LA TERAPIA DE FLUJO ALTO CON RESPIRADORES DE HAMILTON MEDICAL. LA CANULA NASAL PROPORCIONA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MAGNITUDES DE FLUJO DE GAS DIRECTAMENTE EN LAS FOSAS NASALES. GRACIAS A LOS SUAVES Y FLEXIBLES ADAPTADORES NASALES- LA COMODIDAD DEL PACIENTE Y- POR LO TANTO- LA COMPLIANCE RESULTAN EXCELENTES. LA BANDA A LA CABEZA ES TOTALMENTE AJUSTABLE Y SE COLOCA SOBRE LAS OREJAS DEL PACIENTE. ADEMAS- EL LIGERO Y FLEXIBLE TUBO DE LA INTERFAZ PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTOS PARA EL PACIENTE Y REDUCE EL RIESGO DE DESPLAZAMIENTO DEL DISPOSITIVO DURANTE EL USO. EL TUBO DE SUMINISTRO UNICO INCORPORA UNA PELICULA TRANSPIRABLE QUE AYUDA A REDUCIR LA FORMACION DE CONDENSACION MOVIL. LA CANULA NASAL DE FLUJO ALTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS- (S-M Y L) PARA PACIENTES ADULTOS.
42271709	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL TERAPIA ALTO FLUJO T/S	CANULA NASAL TERAPIA ALTO FLUJO T/S LA GAMA DE CANULAS NASALES DE FLUJO ALTO PROPORCIONA SOPORTE RESPIRATORIO PARA PACIENTES ADULTOS Y ES ADECUADA PARA LA TERAPIA DE FLUJO ALTO CON RESPIRADORES DE HAMILTON MEDICAL. LA CANULA NASAL PROPORCIONA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MAGNITUDES DE FLUJO DE GAS DIRECTAMENTE EN LAS FOSAS NASALES. GRACIAS A LOS SUAVES Y FLEXIBLES ADAPTADORES NASALES- LA

								COMODIDAD DEL PACIENTE Y- POR LO TANTO- LA COMPLIANCE RESULTAN EXCELENTES. LA BANDA A LA CABEZA ES TOTALMENTE AJUSTABLE Y SE COLOCA SOBRE LAS OREJAS DEL PACIENTE. ADEMAS- EL LIGERO Y FLEXIBLE TUBO DE LA INTERFAZ PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTOS PARA EL PACIENTE Y REDUCE EL RIESGO DE DESPLAZAMIENTO DEL DISPOSITIVO DURANTE EL USO. EL TUBO DE SUMINISTRO UNICO INCORPORA UNA PELICULA TRANSPIRABLE QUE AYUDA A REDUCIR LA FORMACION DE CONDENSACION MOVIL. LA CANULA NASAL DE FLUJO ALTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS- (S-M Y L) PARA PACIENTES ADULTOS.
2505431	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL ALTO FLUJO NEONATO T/M-KIT	KIT CANULA NASAL ALTO FLUJO NEONATO T/M INCLUYE FIJADORES LAS CANULAS HIGH-FLOW MEDIN NUFLOW DE SILICONA BLANDA NO IRRITANTE REPRESENTAN EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TERAPIA EFICAZ Y MAXIMA COMODIDAD DE USO. INCLUSO LA CANULA NASAL MAS PEQUEÑA ENTREGA FLUJO HASTA 8 LPM Y CUMPLE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEONATOLOGIA (ROEHR 2016). ASI MISMO- LAS CANULAS SE PUEDEN COMBINAR CON ALGUNOS RESPIRADORES COMO, POR EJEMPLO: DE HAMILTON MEDICAL GRAN COMODIDAD PARA EL PACIENTE BAJO NIVEL DE RUIDO Y PRESION DINAMICA DEL SISTEMA REDUCIDA FIJACION INDIVIDUAL- DELICADA CON LA PIEL FORMA AJUSTADA A LA ANATOMIA DE LAS HORQUILLAS
2505430	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASAL TERAPIA ALTO FLUJO T/S	SET CANULA NASAL ALTO FLUJO NEONATO T/S INCLUYE FIJADORES LAS CANULAS HIGH-FLOW MEDIN NUFLOW DE SILICONA BLANDA NO IRRITANTE REPRESENTAN EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TERAPIA EFICAZ Y MAXIMA COMODIDAD DE USO INCLUSO LA CANULA NASAL MAS PEQUEÑA ENTREGA FLUJO HASTA 8 LPM Y CUMPLE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEONATOLOGIA (ROEHR 2016). ASI MISMO- LAS CANULAS SE PUEDEN COMBINAR CON ALGUNOS RESPIRADORES COMO- POR EJEMPLO- DE HAMILTON MEDICAL GRAN COMODIDAD PARA EL PACIENTE BAJO NIVEL DE RUIDO Y PRESION DINAMICA DEL SISTEMA REDUCIDA FIJACION INDIVIDUAL DELICADA CON LA PIEL FORMA AJUSTADA A LA ANATOMIA DE LAS HORQUILLAS

2587155	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA	CANULA NASOFARINGEA PARA PROPORCIONAR UNA VIA AEREA PERMEABLE PARA LOS PACIENTES CON UNA OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA ANATOMICA NORMAL. CANULA NASOFARINGEA ROBERTAZZI. FLEXIBLE PARA CONTRIBUIR A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. MATERIAL BLANDO PARA UNA MAYOR COMODIDAD DEL CONDUCTO NASAL. LA CODIGO REDONDEADA PERMITE UNA INSERCION SUAVE. DISEÑO DE TROMPETA PARA UN POSICIONAMIENTO SEGURO. KITS DE EMERGENCIA DISPONIBLES. INCLUYEN PAQUETES DE LAMINAS DE GEL LUBRICANTE. PRODUCTO DE USO UNICO. NO ESTA FABRICADO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL.
2504486	42271709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA ORO NASAL PROFLUJO PARA ADULTO 5PK	CANULA ORO NASAL PROFLUJO PARA ADULTO CON CONECTOR TIPO ROSCA- AJUSTE GRADUABLE - DE 2 VIAS ORAL Y NASAL PARA FACILITAR OXIGENACION DEL PACIENTE
2500015	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8 CON NEUMATOPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON NEUMOTAPONADOR ELABORADA EN PVC SILICONIZADA N° 8- EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2501765	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRAD CON NEUMOTAPONADOR N|8.5	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 8.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501759	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRAD CON NEUMON°5.5-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 5.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.

2501757	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRAD CON NEUMOTAPONADOR N°4.5-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 4.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501758	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUOMOTAPONADOR N°5-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 5. ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501760	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N°6-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 6. ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501761	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRAD CON NEUMOTAPONADOR N°6.5-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 6.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501762	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N°7-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 7. ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.

2501763	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N°7.5- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 7.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501736	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°4.5- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 4.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501738	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°5.5 ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 5.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501740	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°6.5 ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 6.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501742	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°7.5 ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 7.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501743	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°8 ESTERIL-	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 8 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15

							EMPAQUE INDIVIDUAL	MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501764	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N°8- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 8. ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501756	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N°4	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 4. ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501766	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR N.9	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No.9 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2500016	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR N°8- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR ELABORADA EN PVC SILICONIZADA N° 8- EN PAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO- PAQUETE INDIVIDUAL- CON INFORMACION DE FECHA VENCIMEINTO- LOTE Y REGISTRO INVIMA
2501737	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°5 ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No.5 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.

2501739	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°6 ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 6 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501741	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°7 ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No.7 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501744	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR N°9 ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN NEUMOTAPONADOR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UN SOLO USO DESECHABLE CALIBRE No. 9 ELABORADA EN PVC SILICONIZADO- CON CAMISA INTERNA- BALON RESISTENTE Y SIMETRICO- TRASPARENTE CON CONECTOR DE 15 MM Y MUELLE DE CONECCION DE SEGURIDAD ENTRE CANULAS.
2501749	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.4	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No.4 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE

2501750	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.4.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No.4-5 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE
2501751	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No.5 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE
2501752	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.5.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No.5-5 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE

2501753	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.6.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No.6-5 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE
2501754	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.8	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No. 8 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE
2501755	42271904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR NO.8.5	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN NEUMOTAPONADOR CALIBRE No. 8-5 DISENADA PARA PERMITIR LA COMUNICACION DIRECTA DE LA TRAQUEA Y VIAS RESPIRATO- RIAS BAJAS CON EL EXTERIOR A TRAVES DE UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL SEGUNDO O TERCER ANILLO TRAQUEAL – FABRICADO EN PVC SUAVE – LIBRE DE LATEX – OBTURADOR Y TUBO CLARAMENTE MARCADOS – CONECTOR ADAPTADOR GIRATORIO DE 15 mm – RETENEDOR DE BANDA PARA CUELLO SEGURA- MENTE FIJADO – OPACO A RAYOS X – MANGA DE BAJA PRESION – BANDA DE CUELLO COMODA ACOLCHADA – DE UN SOLO USO-DESECHABLE
2502557	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DE ANESTESIA PULMONETIC SIN PEEP REF. 10822	CIRCUITO DE RESPIRACION CORRUGADO EN POLIPROPILENO. CON BOLSA RESERVORIA. CON DOS CONECTORES PLASTICOS. LIBRE DE LATEX. PARA USO EN SALA DE CIRUGIA

2503706	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO CORRUGADO ANESTESIA ADULTO 3 L- DE LONGITUD 1.50M- EN LATEX- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CIRCUITO ANESTESIA MECANICA ADULTO.CIRCULAR. ELABORADO EN PVC.EMPAQUE ESTERIL.LIBRE DE LATEX.LONGITUD 150 CMS O MAS.COMPUESTO POR D ENLATEX- DE CAPACIDAD 3 LITCONECTOR DE PRESION EN LAS 2 MANGUERAS- Y RIGIDA PARALELA EN PLASTICO CON 2 PUERTOS PARA PRESION Y TEMPER MECANICA
2500080	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO	CIRCUITO ANESTESIA MECANICA ADULTO. CIRCULAR. ELABORADO EN PVC. TUBO CORRUGADO. DESECHABLE. FLEXIBLE. EMPAQUE ESTERIL- LIBRE DE LATEX. LONGITUD 150 CMS. VENTILACION MECANICA MODO CPAP. CON BALON- FILTRO ANTIBACTERIAL/VIRAL Y PUERTO PARA CAPNOGRAFIA
2500079	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO	CIRCUITO ANESTESIA MECANICA ADULTO. CIRCULAR. ELABORADO EN PVC. TUBO CORRUGADO. DESECHABLE. FLEXIBLE. EMPAQUE ESTERIL- LIBRE DE LATEX. LONGITUD 100 CMS. VENTILACION MECANICA MODO CPAP. CON BALON- FILTRO ANTIBACTERIAL/VIRAL Y PUERTO PARA CAPNOGRAFIA
2565523	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO CORRUGADO COAXIAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE COAXIAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO CON FILTRO ANTIBACTERIAL Y PUERTO PARA CAPNOGRAFIA. DOS MANG ANES-TESIA EL DISEÑO COMPACTO DE UNA SOLA EXTREMIDAD PERMITE UN ESPACIO MAS CLARO PARA EL PACIENTE-RIESGO REDUCIDO DE INFECCION CRUZADA YA QUE LOS CIRCUITOS SON DE UN SOLO USO. MAYOR EFICIENCIA DE TIEMPO Y COSTO A MEDIDA QUE SE ELIMINA EL REPROCESAMIENTO. EL DISEÑO COAXIAL PROPORCIONA CALENTAMIENTO PASIVO DE GASES INSPIRATORIOS POR INTERCAMBIO DE CALOR CON FLUJO ESPIRATORIO.
2502304	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO CORRUGADO COAXIAL MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICA	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE COAXIAL. CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS. CON DOS CONECTORES TIPO Y

2584164	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA-ADULTO-MANGUERAS CORRUGADAS	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA. USO ADULTO. MANGUERAS CORRUGADAS. ADAPTADOR EN Y. CODO CON ENTRADA PARA GAS. ABRAZADERAS. DE USO UNICO. CON TRAMPA DE AGUA DEDECHABLE
2584165	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA-NEONATAL-MANGUERAS CORRUGADAS	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA. USO NEONATO. MANGUERAS CORRUGADAS. ADAPTADOR EN Y. CODO CON ENTRADA PARA GAS. ABRAZADERAS. CONECTORES A PRESION. DE USO UNICO. CON DOS TRAMPAS DE AGUA DEDECHABLE COMPATIBLESD CON VENTILADORES.
2505755	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABL JACKSON REES BALON 1L	CIRCUITO DESECHABL JACKSON REES BALON 1L. MANGUERA CORRUGADA. MANGUERA LISA. CONECTOR NORMAN. VALVULA ALIVIO. BALON PARA ANESTESIA DE 0.5 LITROS Y MANOMETRO PARA CONTROLAR LA PRESION. CON ACOPLE. PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL.
2505756	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABL JACKSON REES BALON 2L	CIRCUITO DESECHABL JACKSON REES BALON 2L. MANGUERA CORRUGADA. MANGUERA LISA. CONECTOR NORMAN. VALVULA ALIVIO. BALON PARA ANESTESIA DE 0.5 LITRO Y MANOMETRO PARA CONTROLAR LA PRESION. CON ACOPLE. PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL
2502556	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR DE ACUERDO CON MARCA REQUERIDA POR LA INSTITUCION	CIRCUITO DESECHABLE. MANGUERA CORRUGADA. VALVULA DE EXHALACION. CON LINEA DE PRESION CON PUERTO. CONECTORES A PRESION COMPATIBLE CON VENTILADOR DE ACUERDO CON MARCA REQUERIDA POR LA INSTITUCION
2502303	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO DESECHABLE VENTILACION UNIVENT MOD 754	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION UNIVENT MOD 754. DISPOSITIVO MEDICO DESECHABLE UNICO USO. EN POLIPROPILENO LIBRE DE LATEX NO ESTERIL. COMPUESTO POR TUBO CORRUGADO DE 180 CM DIVIDIDO EN SEGMENTOS DE 15 CM Y SUJETADOR DE TUBO. DOS MANGUERAS CORRUGADAS CON BIFURCACION EN "Y". CONECTORES UNIVERSALES LIBRES DE ESCAPE. PUERTO TEMPERATURA Y CAPNOGRAFIA. LINEA DE

								PRESION SOPORTE SUJETADOR DE MANGUERAS. EMPAQUE PRESENTACION INDIVIDUAL DE MEDIDA DE ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO- FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE
2503934	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO PARA PACIENTE VENTILADOR BIR AVIAN- KIT	CIRCUITO PARA PACIENTE VENTILADOR BIRD AVIAN 10333. PATIENT CIRCUIT KIT INCLUDES THE FOLLOWING: 2516 TUBING- SMOOTH BOR. 33687 PEEPV
2505556	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO RESPIRATORIO COAXILAL ADUL180CM	CIRCUITO RESPIRATORIO COAXIAL ADULTO 180cm. CON SENSOR DE FLUJO Y VALVULA ESPIRATORIA DESECHABLE. CON PUERTO DE CAPNOGRAFIA. MANGUERAS CORRUGADAS. ADAPTADOR Y CODO DE ENTRADA PARA GAS. MASCARIALLA Y BOLSA DE REINHALACION DE FILTRO ANTIBACTERIAL
2505432	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO RESPIRATORIO DOS RAMAS ADUL/PED	CIRCUITO RESPIRATORIO DOS RAMAS ADUL/PED UN CONJUNTO DE DISPOSITIVOS NO ESTERILES DISEÑADOS PARA CONDUCIR GASES ENRIQUECIDOS CON AIRE U OXIGENO (O2) Y GASES ADICIONALES [POR EJEMPLO- OXIDO NITROSO (N2O)- GASES HALOGENADOS] DESDE UN VENTILADOR HASTA UN PACIENTE. INCLUYE TUBOS DE RESPIRACION- UN CONECTOR DE PIEZA EN Y PROPORCIONA CONEXIONES PARA DISPOSITIVOS QUE HUMIDIFICAN- ADMINISTRAN MEDICAMENTOS Y MONITOREAN LA CONCENTRACION O PRESION DE GAS DENTRO DEL CIRCUITO DE RESPIRACION- ALGUNOS TIPOS PUEDEN INCLUIR UN CABLE CALEFACTOR INTEGRADO ALIMENTADO POR UN HUMIDIFICADOR CONECTADO DESTINADO A CALENTAR GASES DE RESPIRACION A MEDIDA QUE INGRESAN A LAS VIAS RESPIRATORIAS DEL PACIENTE. ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UN SOLO USO.
2505419	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO RESPIRATORIO DOS RAMAS NEONATAL	CIRCUITO RESPIRATORIO DOS RAMAS NEONATAL LOS EQUIPOS RESPIRATORIOS PREMONTADOS PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIATRICOS SE HAN DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LOS PACIENTES MAS PEQUEÑOS- DE HASTA 15KG. SE PUEDEN USAR HASTA 28 DIAS POR PACIENTE E INCLUYEN SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO- TUBO DE LLENADO DE AGUA- PIEZA EN Y CAMARA DE AGUA. LA AMPLIACION EXTRAIBLE- SIN CALEFACCION- PERMITE EL USO EN LA INCUBADORA. HAY DISPONIBLES EQUIPOS DE UNA O DOS RAMAS CON CALEFACCION COMO

								ARTICULOS DESECHABLES O ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
2505492	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO RESPIRATORIO DUAL NEONATAL 150CM	CIRCUITO RESPIRATORIO DUAL NEONATA 150cm. CON SENSOR DE FLUJO Y VALVULA ESPIRATORIA DESECHABLE. CON PUERTO DE CAPNOGRAFIA. MANGUERAS CORRUGADAS. ADAPTADOR Y CODO DE ENTRADA PARA GAS. MASCARIALLA Y BOLSA DE REINHALACION DE FILTRO ANTIBACTERIAL
2500186	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CIRCUITO VENTILACION MECANICA NEONATAL	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL. TUBO CORRUGADO. DESECHABLE. CONEXIONES A SISTEMA DE HUMIDIFICACION. TRAMPAS DE AGUA. EMPAQUE EN CASCADA
2502682	42271908	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CLIP NASAL DESCARTABLE	CLIP NASAL DESECHABLE ELABORADO EN PVC-USO ADULTO-PEDIATRICO. DISEÑADO PARA OCLUSION NASAL- BORDES PROTEGIDOS EN ESPUMA Y SUPERFICIE LISA
2502946	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	COMBITUBO TUBO ESOFAGO/TRAQUEAL-TUBO DE MATERIAL PLASTICO (GRADO MEDICO) DE DOBLE LUMEN CON DOS NEUMOTAPONADORES	COMBITUBO TUBO ESOFAGO/TRAQUEAL. DE DOBLE LUMEN CON DOS NEUMOTAPONADORES LUMEN FARINGEO CON EXTREMO DISTAL CIEGO
2505434	42271621	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CONJUNTO VALVULA ESPIRATORIA ADUL/PEDIA	CONJUNTO VALVULA RESPIRATORIA ADULTO/PEDIATRICA. ELEMENTO CLAVE DE CUALQUIER SISTEMA DE VENTILACION. DESECHABLES Y ESTERILIZABLES. CARCASA MEMBRANA Y ANILLO DE BLOQUEO. VALVULA EXHALATORIA. ALMOHADILLA DE FILTRO. ADAPTADO EN Y BOQUILLA. CON PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA RESPIRACION (PEEP). DISEÑO QUE EVITA EL CONTACTO CON EL GAS EXHALADO POR EL PACIENTE CON QUE LOS COMPONENTES INTERNOS DEL RESPIRADOR.
2505433	42271621	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CONJUNTO VALVULA ESPIRATORIA NEONATAL	CONJUNTO VALVULA ESPIRATORIA NEONATAL EL CONJUNTO DE VALVULA ESPIRATORIA ES UN ELEMENTO CLAVE DE CUALQUIER SISTEMA DE VENTILACION- LOS CONJUNTOS DE VALVULA ESPIRATORIA DESECHABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

2500638	42271621	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	CPAP NASAL NEONATAL CON CANULA.	CPAP NASAL NEONATAL CON CANULA NASAL. CON CODO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. UNA LINEA DE MONITOREO DE PRESION ADAPTADOR PARA GORRO- MALE LUER LOOK. ADAPTADOR CORRUGADO.
2500599	42272223	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	EXTENSION DE CAPNOGRAFIA/ TUBO LINEA CAPNOGRAFIA. ESTERI. EMPAQUE INDIVIDUAL	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MANGUERA/CABLE DE CAPNOGRAFIA CON TERMINACIONES MACHO LUER LOOK. LIBRE DE LATEX.
2584180	42271909	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FIJADOR TUBO ENDOTRAQUEA L ADULTO- CON SOPORTE ESTABILIZADOR	DISPOSITIVO SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO. MASCARA LARINGEA O TRAQUEOTOMIA. ACOMODABLE A DIVERSOS TAMAÑOS DE DISPOSITIVOS DE INTUBACION. CON BLOQUEO DE MORDIDA. ACOLCHADO INTERNO. DESECHABLE. EMPAQUE ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX
2584181	42271909	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FIJADOR TUBO ENDOTRAQUEA L PEDIATRICO- CON SOPORTE ESTABILIZADOR	DISPOSITIVO SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO. MASCARA LARINGEA O TRAQUEOTOMIA. ACOMODABLE A DIVERSOS TAMAÑOS DE DISPOSITIVOS DE INTUBACION. CON BLOQUEO DE MORDIDA. ACOLCHADO INTERNO. DESECHABLE. EMPAQUE ESTERIL. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX
2504209	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO 0-2µm RETENEDOR DE BACTERIAS-ENDOTOXINAS Y PARTICULAS SOLUCIONES DE INFUSION	MEMRANA DE NYLON. CON CUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO. FILTRO 0-2µm. EN FIBRA DE VIDRIO. CON LUE BLOCK. NO ESTERIL.
2584080	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO ANTIBACTRERI AL/ANTIVIRAL-INTERCAMBIAD OR DE CALOR Y HUMEDAD-PARA CIRCUITO VENTILACION	FILTRO ANTIBACTEIANO/ANTIVIRAL E INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HUMEDAD-PARA CIRCUITOS DE VENTILACION (HME)Y ANESTESIA. CON CARCASA EN HUMEDAD. NO ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2504127	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO ANTIBACTERIA NO PARA ESPIROMETRIA COMPATIBLE CON EQUIPO	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA ESPIROMETRIA COMPATIBLE CON EQUIPO SPIROLAB III UNIDAD

							SPIROLAB III UNIDAD	
2503188	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO COMBINADO ELECTROSTATICO CON HME DEL ADULTO-CON PUERTO PARA CAPNOGRAFIA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	FILTRO RESPIRATORIO COMBINADO CON HUMIDIFICADOR/HUMIDIFICA Y FILTRA AL MISMO TIEMPO. INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (HME)- DE ALT CONUN ALTO NIVEL DE PROTECCION- PROPORCIONADO POR EL FILTRO ELECTROSTATICO HIDROFOBO. EFICACIA DE FILTRACION DEL 99%- BAJO ESPACIOM INDIVIDUAL
2502945	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO HIDROFOBICO UNIVERSAL PARA SUCCIONADOR	FILTRO HIDROFOBICO UNIVERSAL PARA SUCCIONADOR. SEGURIDAD ADICIONAL Y CONTROL DE INFECCIONES MICROBIANAS ADAPATABLE CON EQUIPOS DE LA INSTITUCION
2587060	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO DE HIGIENE EN EMBALAJE ESTERIL PARA CO2 COMPATIBLE CON CONSOLA NEUMOINSUFLADOR DE CO2. DESECHABLE UNIDAD.	FILTRO DE HIGIENE EN EMBALAJE ESTERIL. DESCARTABLE. UN SOLO USO. HIDROFOBO EN AMBOS EXTREMOS. PARA CO2 COMPATIBLE CON CONSOLA NEUMOINSUFLADOR DE CO2 INSTITUCIONAL.
2503177	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO-ELABORADO EN POLIPROPILENO- ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	FILTRO NARIZ DE CAMELLO (DE VOLUMEN REDUCIDO) PARA CIRCUITO DE VENTILACION ANESTESICA DEL ADULTO. CON RENDICION MAXIMA DE HUMEDAD LA CONDENSACION DE AGUA O SECRECIONES. CON PUESTO LUER LOCK HEMBRA PARA CONEXION DE CAPNOGRAFIA. ELABORADO EN POLIPROPILENO. ESTERIL INDIVIDUAL
2500642	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO INTERCAMBIADOR CALOR Y HUMEDAD NEONATAL CON FILTRACION ELECTROSTATICA	FILTRO COMBINADO ELECTROSTATICO (MICROFIBRA DE POLIPROPILENO) CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD NEONATAL (CELULOSA HIDROFILICA). DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL Y VIRAL. CON CARCASA Y TAPA LUER. ESTERIL.

2500641	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO INTERCAMBIADOR CALOR HUMEDAD PEDIATRICO-CON FILTRACION ELECTROSTATICA	FILTRO COMBINADO ELECTROSTATICO (MICROFIBRA DE POLIPROPILENO) CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD PEDIATRICO (CELULOSA HIDROFILICA). DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL Y VIRAL. CON CARCASA Y TAPA LUER. ESTERIL.
2500640	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO INTERCAMBIADOR CALOR Y HUMEDAD	FILTRO COMBINADO ELECTROSTATICO (MICROFIBRA DE POLIPROPILENO) CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (CELULOSA HIDROFILICA). DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL Y VIRAL. CON CARCASA Y TAPA LUER. ESTERIL.
2505491	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO PARA SISTEMA RESPIRACION DESECHAB	FILTRO EN POLIPROPILENO DESECHABLE. HIDROFOBICO HEPA. NO ESTERILIZABLE. UN SOLO USO. LIBRE DE LATEX
2500639	42271907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTRO PARA SUCCIONADOR PORTATIL	FILTROS HIDROFOBICOS HEPA. FABRICADOS EN PLASTICO GRADO MEDICO. DESECHABLES.
2505422	42271909	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	GENERADOR UNIVERSAL NCPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA NASAL) TERAPIA DE VENTILACION NO INVASIVA	GENERADOR nCPAP/VENTILACION NO INVASIVA ES UN PRODUCTO DE-SECHABLE PARA LA TERAPIA DE NCPAP/ VENTILACION NO INVASIVA EN EL TRATA¬MIENTO DE NEONATOS Y NEONATOS PREMATUROS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS JUNTO CON UN RESPIRADOR MECANICO
2505426	42272223	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	GORRO DE FIJACION DESECHABLE NCPAP T/S	GORRO DE FIJACION DESECHABLE nCPAP T/S GORROS DE FIJACION ESTAN FABRICADOS EN MICROFIBRA BIOCOMPATIBLE- ENVASADOS INDIVIDUALMENTE YDISPONIBLES EN OCHO TALLAS. EL MATERIAL ESPECIALMENTE BLANDO Y ELASTICO PROTEGE LA CABEZA SIN DEFORMARLA. LAS CINTAS DE FIJACION PARA HORQUILLAS Y MASCARAS SE ADHIEREN A CUALQUIER CODIGOTO DEL GORRO-PERMITIENDO SU COLOCACION INDIVIDUAL.
2502799	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.004	GUIA DE TUNGSTENO INTUBACION PEDIATRICA	GUIA DE TUNGSTENO PARA INTUBACION PEDIATRICA DE 11 x 6 fr RECUBIERTA DE PLASTICO PARA FACILITAR EL INGRESO AL TUBO ENDOTRAQUEAL CON CODIGO FLEXIBLE PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION EN PACIENTE

2503025	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.004	GUIA TUNGSTENO INTUBACION ADULTO	GUIA DE TUNGSTENO PARA INTUBACION ADULTO DE 14 FR DE 4.9 RECUBIERTA DE PLASTICO PARA FACILITAR EL INGRESO AL TUBO ENDOTRAQUEAL CON CODIGO FLEXIBLE PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESION EN PACIENTE
2503404	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.004.001	GUIA INTUBACION EN ALUMINIO+RECUBIERTA MATERIAL SATINADO-PEDIATRICA 10FR	GUIA/ESTILETE EN ALUMINIO RECUBIERTA-SATINADA LIBRE DE PVC Y LATEX- MALEABLE-CODIGO RECTA- CON MARCAS DE GRADUACION CADA 5cm- CODIFI PEDIATRICA
2503403	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.004.001	GUIA INTUBACION EN ALUMINIO CON CUBIERTA SATINADA PARA FACIL DESLIZAMIENTO- 10FR	GUIA/ESTILETE EN ALUMINIO RECUBIERTA-SATINADA LIBRE DE PVC Y LATEX- MALEABLE-CODIGO RECTA- CON MARCAS DE GRADUACION CADA 5cm- CODIFI INDIVIDUAL
2503201	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	GUIA INTUBACION EN PVC SILICONADO ADULTO-DIAMETRO 5MM- LONGITUD 60CM-AUTOCLAVABLE - EMPAQUE INDIVIDUAL	GUIA EN ALUMINIO RECUBIERTO CON PLASTICO SILICONADO MALEABLE. LIBRE DE LATEX. USO UNICO.
2503202	42272004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	GUIA INTUBACION EN PVC SILICONADO PEDIATRICO	GUIA EN ALUMINIO RECUBIERTO CON PLASTICO SILICONADO MALEABLE. LIBRE DE LATEX. USO UNICO.
2584187	42271801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	HUMIDIFICADOR 200ML PVC GRADO MEDICO- EN PVC DE ALTA DENSIDAD EMPAQUE INDIVIDUAL	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO CON FRASCO DE 200ML. DESECHABLE. TRANSPARENTE. VALVULA DE SOBREPRESION. TAPA EN FORMA DE DOMO QUE EVITA GOTEOS. FRASCO EN POLIPROPILENO. DIFUSOR EN CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO DE ALTO O BAJO FLUJO.

2500561	42271801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	HUMIDIFICADOR 300ML PVC GRADO MEDICO- EN PVC DE ALTA DENSIDAD EMPAQUE INDIVIDUAL	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO CON FRASCO DE 300ML. DESECHABLE. TRANSPARENTE. VALVULA DE SOBREPRESION. TAPA EN FORMA DE DOMO QUE EVITA GOTEOS. FRASCO EN POLIPROPILENO. DIFUSOR EN CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO DE ALTO O BAJO FLUJO.
2500562	42271801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	HUMIDIFICADOR 400ML PVC GRADO MEDICO-EMPAQUE INDIVIDUAL	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO CON FRASCO DE 400ML. DESECHABLE. TRANSPARENTE. VALVULA DE SOBREPRESION. TAPA EN FORMA DE DOMO QUE EVITA GOTEOS. FRASCO EN POLIPROPILENO. DIFUSOR EN CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO DE ALTO O BAJO FLUJO.
2500563	42271801	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	HUMIDIFICADOR 500ML PVC GRADO MEDICO- EN PVC DE ALTA DENSIDAD-EMPAQUE INDIVIDUAL	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO CON FRASCO DE 500ML. DESECHABLE. TRANSPARENTE. VALVULA DE SOBREPRESION. TAPA EN FORMA DE DOMO QUE EVITA GOTEOS. FRASCO EN POLIPROPILENO. DIFUSOR EN CLORURO DE POLIVINILO. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO DE ALTO O BAJO FLUJO.
2501116	42251622	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	INCENTIVO RESPIRATORIO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	INCENTIVO RESPIRATORIO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. MARCACIONES EN CMS O MM. VALVULA EXALA O INHALA. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL. BOQUILLA. CAMARAS DE AIRE. BALON DE ESTIMULO. MANGUERA FLEXIBLE. NO REUTILIZABLE.
2500420	42271712	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	INHALOCAMARA PARA VENTILACION MECANICA	DISPOSITIVO MEDICO PARA SUMINISTRAR MEDICAMENTO EN AEROSOL. EMPAQUE INDIVIDUAL. ORIFICIO PARA RECIPIENTE DOSIFICADOR. CAMARA ESPACIADORA. ADAPTABLE A VENTILADOR.
2500421	42271712	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	INHALOCAMARA PERSONAL ADULTO	DISPOSITIVO MEDICO PERSONAL PARA SUMINISTRAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL. MASCARA ERGONOMICA. SUAVE Y FLEXIBLE. ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE. USO DE UN SOLO PACIENTE. VALVULA DE FLUJO. BOLSA DE POLIETILENO O CAJA PLEGADIZA IMPRESA. DESECHABLE
2502675	42271712	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	INHALOCAMARA PERSONAL PEDIATRICA.	INHALOCAMARA O AEROCAMARA: DISPOSITIVO MEDICO ANTIESTATICO-ELABORADO EN POLIPROPILENO- CON VALVULA REGULADORA-QUE PERMTE LA ENTREGA OBOQUILLA-COMPATIBLE CON EL INHALADOR. EMPAQUE INDIVIDUAL

2503178	42271906	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	INTERCAMBIADOR DE TUBO DEL ADULTO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CATETER DE 12 A 16 Fr. LONGITUD DE 80-90. DIAMETRO INTERIOR: 1.5-2mm CON ADAPTADOR PLASTICO. CONECTOR PROXIMAL DE 15mm PARA EMPAT PERMITIR LA ADMINISTRACION DEL OXIGENO. CODIGO ATRAUMATICO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2584144	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT AEROSOLTERAPIA USO ADULTO DESCARTABLE - EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA UTILIZADO PARA ADMINISTRAR AEROSOLES ADULTO. EN PVC GRADO MEDICO. CARETA. CANULA Y MICRONEBULIZADOR. MANGUERA LISA. CON MASCARA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON ADAPTADOR NASAL. BANDA ELASTICA PA. BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SELLADA. NO ESTERIL. UNICO USO. LIBRE DE LATEX. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2584145	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT AEROSOLTERAPIA USO PEDIATRICO DESCARTABLE - EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA UTILIZADO PARA ADMINISTRAR AEROSOLES PEDIATRICO. EN PVC GRADO MEDICO. CARETA. CANULA Y MICRONEBULIZADOR. MANGUERA LISA. CON MASCARA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON ADAPTADOR NASAL. BANDA ELASTICA PA. BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SELLADA. NO ESTERIL. UNICO USO. LIBRE DE LATEX. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2501130	42171804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT CRICOTIROTOMIA EMERGENCIA CON BALON	DISPOSITIVO DE EMERGENCIA. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. JERINGA PARA CODIGO. AGUJA INTRODUCTORA. CATETER PARA VIA AEREA. BISTURI. JERINGA. DILATADOR CURVADO. CANULA CON TOPE Y CLIP DE SEGURIDAD. BALON
2501131	42171804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT CRICOTIROTOMIA EMERGENCIA SIN BALON	DISPOSITIVO DE EMERGENCIA. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. JERINGA PARA CODIGO. AGUJA INTRODUCTORA. CATETER PARA VIA AEREA. BISTURI. JERINGA. DILATADOR CURVADO. CANULA CON TOPE Y CLIP DE SEGURIDAD.
2504482	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE 2 BANDAS DE ESFUERZO RESPIRATORIO CON SENSOR ZRIP DURABELT PARA ADULTO CON CONECTOR DE SENSOR PARA MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS	KIT DE2 BANDAS DE ESFUERZO RESPIRATORIO CON SENSOR ZRIP DURABELT PARA ADULTO CON CONECTOR DE SENSOR PARA MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS

2501276	42271906	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA.EMPAQUE INDIVIUAL ESTERIL.ELABORADO EN POLIURETANO COMPUESTO POR MATERIAL MEDICO HOSPITALARIO DESECHABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CANULA DE TRAQUOSTOMIA CONTIENE 1. CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 1. CORDON DE FIJACION 1 HOJA DE VISTURI CON MAGO DESECHABLE 1. JERINGA DE 10CC 01 YELCO 14 01 ALAMBRE GUIA METALICO 01 DILATADOR 01 PINZA DILATADORA (OPCIONAL)
2584169	42171804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DISPOSITIVO PARA VENTILACION TRANSTRAQUEAL PERCUTANEA-CRICOTIROIDECTOMIA	ADAPTADOR DE CONO LIVIANO Y TRANSPARENTE. PUERTO DE IRRIGACION CON VALVULA UNIDIRECCIONAL. CUBIERTA PROTECTORA. SONDA DE POLIVINILO DE CLORO CON SUSTANCIA ANTIMICROBIANA. SONDA FLEXIBLE CON CODIGO ROMA. FUNDA DE MATERIAL RESISTENTE Y TRANSPARENTE. VALVULA DE SUCCION CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EXTENSION CORTA CORRUGADA. ESTERIL.
2503023	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO- EN PVC LIBRE DE LATEX. MASCARILLA BLANDA CON NEBULIZADOR DE OXIGENO MAS MICRONEBULIZADOR ADAPTABLE ANATOMICAMENTE- LIGA ELASTICA AJUSTABLE- LIBRE DE LATEX- DE COMPOSICION POLIVINIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2503033	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO-EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO- EN PVC LIBRE DE LATEX. MASCARILLA BLANDA CON NEBULIZADOR DE OXIGENO MAS MICRONEBULIZADOR ADAPTABLE BANDA ELASTICA AJUSTABLE- LI-BRE DE LATEX- DE COMPOSICION POLIVINIL- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVI- DUAL
2502676	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT VENTURY ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MEDICO- UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS- DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO- CONSISTE EN UNA MASCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCION AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES- UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI- QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO- SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA- DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CODIGO DE COLORES- CADA

								UNO INDICA UNA FRACCION INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASI COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACION ADECUADA. ENTREGA UNA FIO2 ENTRE EL 24-50% COMPOSICION MASCARILLA FACIAL ALARGADA. 100% VINILO TRANSPARENTE EXTRA SUAVE 12X6X5 11X5X4 CM. BANDA ELASTICA- CLIP METALICO. ELASTONE- ALUMINIO 50 CM.- 6 CM. TUBO CORRUGADO DE 22 MM DIAMETRO INT. PVC GRADO MEDICO DE 22MM DE DIAMETRO 15 CM. SEIS DISYUNTORES CON CODIGO COLOR (C/U). PVC GRADO MEDICO DE 20 MM DE DIAMETRO 6 CM. C/U ADAPTADOR PARA ENTRADA DE ALTA HUMEDAD. PVC GRADO MEDICO 40- 33 Y 20 DIAMETROS 6 X 3 CM. TUBO O MANGUERA PARA OXIGENO.
2503556	42271503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	LINEA MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA HEMBRA-HEMBRA-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LINEA MUESTREO PARA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA (CO2)- EN MATERIAL PVC/PE- MEDIDA MAXIMA 3 MTS- SISTEMA LUER- CONEXION HEMBRA-HEMB MQ10031/MQ10032
2503558	42271503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	LINEA MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA MACHO-HEMBRA-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LINEA MUESTREO PARA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA (CO2)- EN MATERIAL PVC/PE- MEDIDA MAXIMA 3 MTS- SISTEMA LUER- CONEXION MACHO-HEMBR MQ10026/MQ10029
2503557	42271503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	LINEA MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA MACHO-MACHO-ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	LINEA MUESTREO PARA LA MEDICION DE LA CAPNOGRAFIA (CO2)- EN MATERIAL PVC/PE- MEDIDA MAXIMA 3 MTS- SISTEMA LUER- CONEXION MACHO-MACHO MQ10020/MQ10021

2504006	42271913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MALETIN PARA VIA AEREA CON INSUMOS	MALETIN PARA VIA AEREA. CONTENIDO: LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN CON HOJAS ADULTO RECTRA 1- CURVA 2- PEDIATRICAS CURVAS 2. CANULAS OROTRAQUEALES CON BALON: 6mm 2- 7mm 2- 7.5mm 4- 8mm 2. JERINGAS 10ml 5- LUBRICANTE QUIRURGICO SOBRE 1- BAJALENGUAS 5- KIT DE CR VENCIMIENTO.
2500183	42272209	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MANGUERA CORRUGADA PARA APLICACION DE TERAPIA RESPIRATORIA	MANGUERA CORRUGADA PARA APLICACIONES DE TERAPIA RESPIRATORIA SEGMENTADA EN SECCIONES CORTABLES CADA 14CMS O 15CMS LIVIANA Y FLEXIBLE PVC
2505782	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MANGUERA EXTENSION OXIGENO CONECTOR. MT	MANGUERA EXTENSION OXIGENO CONECTOR. 7MT
2502314	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO CON LINEA DE 200 CMS COMO MINIMO	MASCARA ADULTO EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ADAPTABLE ANATOMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACION MEDIA INDIVIDUAL ATOXICA Y APIROGENICA CON LINEA SUPERIOR A 200 CM
2502313	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA CON LINEA DE 200 CMS COMO MINIMO	MASCARA ADULTO EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- ADAPTABLE ANATOMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACION MEDIA INDIVIDUAL ATOXICA Y APIROGENICA CON LINEA SUPERIOR A 200 CM
2504788	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA DE RESUCITACION BOCA A BOCA ELABORADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO	MASCARA DE RESUCITACION BOCA A BOCA ELABORTADA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO (LIBRE DE LATEX) - CON VALVULA UNIDIRECCIONAL NO RE RESPIRATORIO
2504518	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA NASAL PARA APNEA DE SUEÑO FITPACK/DUOPACK CON ARNES Y SOPORTE DE MENTON-CON ALMOHADILLAS NASALES	MASCARA NASAL CPAP +ARNES+ALMODILLA+CUNA. MASCARA NASAL REF-1036802 OPTILIFE FITPACK/DUOPACK CON ARNES Y SOPORTE DE MENTON- CON ALMO AREA ABIERTA. - BANDA DE SOPORTE DEL MENTON PROPORCIONA LA ESTABILIDAD DE LA MASCARA Y UN AJUSTE SEGURO. - MAS LARGO- 18 "/ 45.7 CM EXHALACION

2505425	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA NASAL TERAPIA NCPAP T/L	MASCARA NASAL TERAPIA nCPAP T/L NUESTRAS MASCARILLAS NASALES- DISPONIBLES EN CINCO TALLAS- DESTACAN POR SU GRAN COMODIDAD DE USO. ALMOHADILLA DE APOYO CON FORMA ANATOMICA- PARA MINIMIZAR LESIONES CUTANEAS Y MAGULLADURAS. EL INTERCAMBIO PERIODICO CON HORQUILLAS BINASALES FAVORECE ADEMAS LA REGENERACION DE LA PIEL.
2505424	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA NASAL TERAPIA NCPAP T/M	MASCARA NASAL TERAPIA nCPAP T/M NUESTRAS MASCARILLAS NASALES- DISPONIBLES EN CINCO TALLAS- DESTACAN POR SU GRAN COMODIDAD DE USO. ALMOHADILLA DE APOYO CON FORMA ANATOMICA- PARA MINIMIZAR LESIONES CUTANEAS Y MAGULLADURAS. EL INTERCAMBIO PERIODICO CON HORQUILLAS BINASALES FAVORECE ADEMAS LA REGENERACION DE LA PIEL.
2505423	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA NASAL TERAPIA NCPAP T/S NEONATAL	MASCARA NASAL TERAPIA nCPAP T/S NEONATAL NUESTRAS MASCARILLAS NASALES- DISPONIBLES EN CINCO TALLAS- DESTACAN POR SU GRAN COMODIDAD DE USO. ALMOHADILLA DE APOYO CON FORMA ANATOMICA- PARA MINIMIZAR LESIONES CUTANEAS Y MAGULLADURAS. EL INTERCAMBIO PERIODICO CON HORQUILLAS BINASALES FAVORECE ADEMAS LA REGENERACION DE LA PIEL.
2504240	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA ORONASAL FULL LIFE	MASCARA ORONASAL FULL LIFE CON 1 MARCO Y 3 TAMAÑOS DE ALMOHADILLA Y SISTEMA DE ARNES CON BANDA PARA BARBILLA Y CUELLO
2584035	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICO	MASCARA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ANATOMICA PEDIATRICA- CON CLIP AJUSTABLE A LA NARIZ- CON VALVULA DE NO REINALACION PROBABILIDADES DE REINALACION DEL CO2- CORREA ELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501121	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DE NO REHINALACION ALARGADA DEL ADULTO	MASCARA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ALARGADA- CON VALVULA DE NO REINALACION- RESERVORIO EN MATERIAL TR CORREAELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502583	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DE NO REHINALACION	MASCARA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ANATOMICA ADULTO- CON VALVULA DE NO REINALACION- RESERVORIO EN MATERIAL TR-

							ALARGADA DEL ADULTO	CORREA ELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502584	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA- CON RESERVORIO	MASCARA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ANATOMICA- CON VALVULA DE NO REINALACION- RESERVORIO EN MATERIAL T CORREA ELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501122	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO REINHALACION PARCIAL DEL ADULTO- CON RESERVORIO Y CLIP AJUSTABLE A LA NARIZ	MASCARA TRANSPARENTE EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ANATOMICA- CON CLIP AJUSTABLE A LA NARIZ- CON VALVULA DE REINALACION PROBABILIDADES DE REINALACION DEL CO2- CORREA ELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2502311	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO DE REINHALACION PARCIAL	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO RESPIRAR OXIGENO A TRAVES DE UNA MASCARILLA CON UNA BOLSA DE ALMACENAMIENTO: ES UNA TECNICA PARA AUMENTAR LA CONCENTRACION DE OXIGENO RESPIRABLE (FIO2) CON UNA MASCARILLA CON UNA BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE OXIGENO PARA PROPORCIONAR SUFICIENTE OXIGENO PARA LAS NECESIDADES METABOLICAS DEL CUERPO MATENER EN LUGARES FRESCOS Y SECOS INFERIORES A LOS 30 GRADOS CENTIGRADOS
2502312	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA DE REINHALACION PARCIAL	MASCARA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO PEDIATRICA EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO- CON FORMA ANATOMICA- CON VALVULA DE NO REINALACION- RESERVORIO EN MATERIAL T- CORREA ELASTICA AJUSTABLE A LAS OREJAS- TUBO DE EXTENSION PLASTICO- DESCARTABLE- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501119	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO- EMPAQUE INDIVIDUAL	LA MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTA SE UTILIZA PARA ADMINISTRAR HUMIDIFICACION Y/O OXIGENOTERAPIA EN PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CON VENTILACION MECANICA. LA MASCARILLA ES DESECHABLE- DE VINILO- DE MATERIAL SUAVE Y TRANSPARENTE- NO TOXICO Y FLEXIBLE. DISPONE DE UN CONECTOR GIRATORIO DE 22MM (360°) Y UNA BANDA ELASTICA DE CAUCHO SINTETICO AJUSTABLE Y FACIL DE PONER.

2501120	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO-EMPAQUE INDIVIDUAL	LA MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA SE UTILIZA PARA ADMINISTRAR HUMIDIFICACION Y/O OXIGENOTERAPIA EN PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CON VENTILACION MECANICA. LA MASCARILLA ES DESECHABLE- DE VINILO- DE MATERIAL SUAVE Y TRANSPARENTE-NO TOXICO Y FLEXIBLE. DISPONE DE UN CONECTOR GIRATORIO DE 22MM (360°) Y UNA BANDA ELASTICA DE CAUCHO SINTETICO AJUSTABLE Y FACIL DE PONER.
2504288	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARAS PARA VENTILACION NO INVASIVA-TRANSPARENTE- COJIN EN SILICONA-CODO CON VALVULA ANTIASFIXIANTE	MASCARAS PARA VENTILACION NO INVASIVA-TRANSPARENTE- COJIN EN SILICONA- CODO CON VALVULA ANTIASFIXIANTE- CODO ESTANDAR-GIRATORIO 360 ADULTOFACIAL TOTAL LAVABLE-ESTAS MASCARILLAS CUBREN LA NARIZ Y LA BOCA- POR LO QUE GARANTIZAN LA NIV EFECTIVA INCLUSO EN CASO DE RESPIRACION BUCAL
2504239	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARILLA NASAL WISP CON MARCO DE SILICONA Y UN PAQUETE DE 3 ALMOHADILLAS TAMAÑO P/S-M-L REF 1094060	MASCARILLA NASAL WISP CON MARCO DE SILICONA Y UN PAQUETE DE 3 ALMOHADILLAS COMODA CON DOBLE CORREAS RETRACTILES PARA VARIOS USOS TAMAÑO S-M-L REF 1094060
2584050	42271708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA VENTURY PEDIATRICO	SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MEDICO-UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO EN CONCENTRACIONES EXACTAS- DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO-CONSISTE EN UNA MASCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCION AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES-PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO-DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CODIGO DE COLORES- CADA UNO INDICA UNA FRACCION INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASI COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACION ADECUADA-ENTREGA UNA FIO2 ENTRE EL 24-50%-COMPOSICION: MASCARILLA FACIAL ALARGADA.

								100% VINILO TRANSPARENTE EXTRA SUAVE. BANDA ELASTICA- CLIP METALICO. ELASTONE-ALUMINIO. TUBO CORRUGADO. PVC GRADO MEDICO. SEIS DISYUNTORES CON CODIGO COLOR (C/U). PVC GRADO MEDICO ADAPTADOR PARA ENTRADA DE ALTA HUMEDAD. TUBO O MANGUERA PARA OXIGENO.
2504483	42271909	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MENTONERA O CORREA TIPO BARBILLA ARNES PARA USO DE MASCARA NASAL	MENTONERA O CORREA TIPO BARBILLA ARNES PARA USO DE MASCARA NASAL REFERENCIA AC302175B- DE COLOR NEGRO CON CORREA EN LA BARBILLA
2501383	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	MICRONEBULIZADOR ADULTO-DESCARTABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL	MICRONEBULIZADOR ADULTO- SISTEMA NEBULIZADOR CON MASCARA. INDICADO PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR MEDIO DEL NEBULIZADOR- EL CUAL INGRESA POR LA VIA RESPIRATORIA. COMPUESTO POR: MASCARA- PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO- TIENEN CLIP NASAL AJUSTABLE Y BANDAS ELASTICAS DE SUJECION. PARA REALIZAR NEBULIZACIONES- LAS CUALES CONSISTEN EN LA INHALACION DE GASES MEDICINALES PARA TRATAR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO. MAGUERA- CUENTA CON ADAPTADOR UNIVERSAL EN AMBOS EXTREMOS- PERMITE LA CONEXION ENTRE EL OXIGENO Y EL VASO NEBULIZADOR. TAMAÑO: ADULTO.
2584175	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA (TIPO HUMIDIFICADOR) CON PUERTO DE SALIDA A MANGUERA CORRUGADA - CAPACIDAD DE 40 BAJOS.
2500084	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	NEBULIZADORE DE 500 ML	NEBULIZADORES DE 500ML DE VOLUMEN-TRANSPARENTE CON SEÑALIZACION MAXIMO Y MINIMO DE NIVEL DE AGUA.PUERTO PARA CALENTADOR DE INMERSION- CONSTA DE UNA MASCARA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON ADAPTADOR NASAL- BANDA ELASTICA PARA SUJECION- MANGUERA LISA DE CONEXION PARA ADAPTADOR UNIVERSAL MICRONEBULIZADOR-INCENTIVO ADAPTABLE A LOS ACCESORIOS-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SELLADA CONTENIENDO CADA UNIDAD.

2501144	42271802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	NEBULIZADOR INFANTE TRAQUEOSTOMIA DOBLE	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO EN TERAPIA DE AEROSOL- USADO EN PACIENTES INFANTES- EN UNIDAD- Y DESECHABLE
2500029	42271908	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	NIPLE O RACORD PARA SALIDA DE OXIGENO	NIPLE MANOMETRO OXIGENO. CONECTOR UNIVERSAL (ADAPTADOR)PARA SALIDAS DE OXIGENO. TUERCA PLASTICA DE 1/8 NPT PARA FLUJO MANGUERA- EMPAQUE INDIVIDUAL- 100% PLASTICO- PVC RIGIDO- CONICO DE GRADO MEDICO- 5CM DE LARGO- 1.5 CM DE DIMETRO INFERIOR- 0-5CM DE DIMETRO SUPERIOR.
2504484	42312402	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTECTOR NASAL Y ORONASAL EN SILICONA	PROTECTOR NASAL Y ORONASAL EN SILICONA DE FACIL LAVADO- COLOCACION EN MASCARAS NASALES Y ORONASAL
2505850	42271908	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	SELLO TORAX DESECHABLE CON VALVULA	SELLO TORAX DESECHABLE CON VALVULA SELLO TORAX DESECHABLE CON VALVULA- DISEÑADO PARA TRATAR HERIDAS ABIERTAS EN EL TORAX- PARA USO EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS
2565530	42144101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA DRENAJE DE TORAX DE TRES CAMARAS- CAPACIDAD 1500/200 CC	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO CON TRES CAMARAS- CAPACIDAD DE 1000 - 1500 m EN ELASTOMERO TERMOPLASTICO LIBRE LA LATEX Y PVC
2503179	42292501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPON NASAL DE 10CM DE ESPONJA DE POLIVINIL ACETATO- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	TAPON NASAL DE ESPONJA CON CELULAS CONTINUAS E INTERCONECTADAS- ABSORBENTE- FLEXIBLE-FACIL DE HUMEDECER- CON CORDON DE REFERENCIA PAQUETE INDIVIDUAL
2504481	42271505	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TERMISTOR ORONASAL PARA ADULTO 249 DE 1 CANAL- PLEGABLE DE FACIL REMOCION	TERMISTOR ORONASAL PARA ADULTO 249 DE 1 CANAL PLEGABLE DE FACIL REMOCION- PARA DETECCION DE FLUJO RESPIRATORIO
2500022	42143513	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE VENTILACION CORTA DURACION OIDO- ESTERIL-	TUBO DE VENTILACION CORTA DURACION PARA OIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL- ELABORADO EN SILICONA O FLUOROPLASTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL.

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2500021	42143513	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE VENTILACION LARGA DURACION PARA OIDO	TUBO DE VENTILACION LARGA DURACION PARA OIDO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-ELABORADO EN SILICONA O FLUOROPLASTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2502585	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2503119	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPON2.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR (CON BALON DE INFLADO) Y VALVULA ABTIRRETORNO DE INFLADO- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSP DIAMETRO INTERNO- CON EXTREMO DISTAL ABIERTO- BICELADO CON CODIGO ATRAUMATICA Y LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSI BLISTER
2504446	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº 37- ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº 37- ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO- TRANSPARENTE-TERMOSENSIBLE- ALTAMENTE FLEXIBLE-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER
2504447	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº 39- ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO Nº 39- ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO- TRANSPARENTE-TERMOSENSIBLE- ALTAMENTE FLEXIBLE-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER
2504585	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR Nº6- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE- CON ESPIRAL DE ACER EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BICELADO- TIPO MURPHY-ATRAUMATICO- AUTO-RETENTIVO- CENTRAL-RESISTENTE DE FACIL INFLAMDO

2504586	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR N°7.0-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERE SU FOR CONLINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUA BLISTER
2503708	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONAPONADOR 4.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE-TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERE FORMA O LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO BLISTER
2503762	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOANILLADO CON NEUMOTAPONADOR 7.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOANILLADO CON NEUMOTAPONADOR- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE-TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE-BICELADO-CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2503763	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOANILLADO CON NEUMOTAPONADOR 8.5MM-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOANILLADO CON NEUMOTAPONADOR- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE-TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RE BICELADO- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
2501010	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 35 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 35 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA-CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO
2501011	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 37 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 37 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA-CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO

2501012	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 39 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO 39 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA- CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO
2501007	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 35 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 35 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA- CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO
2501008	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 37 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 37 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA- CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO
2501009	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 39 FR	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO 39 FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC SILICONIZADO. DOBLE LUMEN. CON EMPATES UNIDIRECCIONALES Y TIRA RADIOPACA- CON MARCAS DE PROFUNDIDAD EXTERNO
2501000	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 5.5 MM-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501001	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 6.0 MM-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501002	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 6.5 MM-EMPAQUE INDIVIDUAL

2501003	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 7.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 7.0 MM-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501021	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 5.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 5.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN METAL ARGOLLADO DESDE CONEXION ESTANDAR HASTA PARTE DISTAL. PERMITE EL PASO DE MEZCLAS GASEOSAS O AIRE DIRECTAMENTE A LOS PULMONES Y MANTIENE PERMEABLES LAS VIAS RESPIRATORIAS DURANTE LA ANESTESIA. DISEÑADO PARA CIRUGIAS CON CO2 Y LASER CERCANAS A LA VIA AEREA
2501022	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 6.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 6.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN METAL ARGOLLADO DESDE CONEXION ESTANDAR HAST DISTAL. PERMITE EL PASO DE MEZCLAS GASEOSAS O AIRE DIRECTAMENTE A LOS PULMONES Y MANTIENE PERMEABLES LAS VIAS RESPIRATORIAS DURANTE LA ANESTESIA. DISEÑADO PARA CIRUGIAS CON CO2 Y LASER CERCANAS A LA VIA AEREA
2501004	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 6.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 6.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN METAL ARGOLLADO DESDE CONEXION ESTANDAR HAST DISTAL. PERMITE EL PASO DE MEZCLAS GASEOSAS O AIRE DIRECTAMENTE A LOS PULMONES Y MANTIENE PERMEABLES LAS VIAS RESPIRATORIAS DURANTE LA ANESTESIA. DISEÑADO PARA CIRUGIAS CON CO2 Y LASER CERCANAS A LA VIA AEREA
2501005	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 7.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 7.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN METAL ARGOLLADO DESDE CONEXION ESTANDAR HAST DISTAL. PERMITE EL PASO DE MEZCLAS GASEOSAS O AIRE DIRECTAMENTE A LOS PULMONES Y MANTIENE PERMEABLES LAS VIAS RESPIRATORIAS DURANTE LA ANESTESIA. DISEÑADO PARA CIRUGIAS CON CO2 Y LASER CERCANAS A LA VIA AEREA

2501006	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER7.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL METALICO CIRUGIA LASER 7.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN METAL ARGOLLADO DESDE CONEXION ESTANDAR HAST DISTAL. PERMITE EL PASO DE MEZCLAS GASEOSAS O AIRE DIRECTAMENTE A LOS PULMONES Y MANTIENE PERMEABLES LAS VIAS RESPIRATORIAS DURANTE LA ANESTESIA. DISEÑADO PARA CIRUGIAS CON CO2 Y LASER CERCANAS A LA VIA AEREA
2503414	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR- EN PVC- NO COLAPSABLE- 10.0MM	TTUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERE SU FOCON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUA BLISTER
2500972	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500973	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500974	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500975	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.

2500976	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500977	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500978	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500979	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500980	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500981	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500982	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 8.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-

								ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500983	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 9.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500984	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 9.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2584191	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 2.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2500989	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 MM CON NEUMOTAPONADOR (BALON TIPO BAJA PRESION)-ELABORADO EN PVC SILICONIZADO-TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSA ABIERTO Y BICELADO- CON LINEA RADIOPACA-ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION.
2501013	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 5.5 M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 5.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2500993	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 6.0 M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 6.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2500994	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 6.5 M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 6.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL

2500995	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 7.0 M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 7.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2500996	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 7.5 M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 7.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2500997	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 8.0M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON NEUMOTAPONADOR 8.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2501015	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 3.0M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 3.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2501016	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 3.5M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 3.5 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2501017	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 4.0M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 4.0 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2501018	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPANODOR 4.5M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 4.5MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2501019	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 5.0M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 5.0MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL

2501020	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 5.5M	TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO SIN NEUMOTAPONADOR 5.5MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL ELABORADO EN PVC PREFORMADO EN FORMA DE ANGULO 75° DIAMETRO. DISEÑADOS PARA USO EN CIRUGIA MAXILOFACIAL
2500991	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5.0 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2505757	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 6.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 6.5 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500985	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2.0 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500986	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 2.5 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500987	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3.0MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3.0 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.

2500988	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3.5 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500990	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4.5 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2500992	42271903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5.5 MM- ELABORADO EN PVC SILICONIZADO- TRANSPARENTE- TERMOSENSIBLE- NO COLAPSABLE. QUE RECUPERA SU FORMA- CON LINEA RADIOPACA- ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACION. ESCALA EXTERNA DE INSPECCION. ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2504196	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO QUIRURGICO EN T 12 FR	TUBO QUIRURGICO EN T 12 FR PARA DRENAJE DE SILICONA CON LINEA RADIOPACA. CONSISTE EN UN VASTAGO Y UNA PISTA CRUZADA. UTILIZADO DESPUES DE LA CIRUGIA DE VIA BILIAR PARA DRENAJE BILIAR. ESTERIL DE UNICO USO.
2504197	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO QUIRURGICO EN T 14 FR	TUBO QUIRURGICO EN T 14 FR PARA DRENAJE DE SILICONA CON LINEA RADIOPACA. CONSISTE EN UN VASTAGO Y UNA PISTA CRUZADA. UTILIZADO DESPUES DE LA CIRUGIA DE VIA BILIAR PARA DRENAJE BILIAR. ESTERIL DE UNICO USO.
2504216	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO QUIRURGICO EN T 16 FR PARA DRENAJE DE LATEX RECUBIERTO DE SILICONA. CONSISTE EN UN VASTAGO Y UNA PISTA CRUZADA	TUBO QUIRURGICO EN T 16 FR PARA DRENAJE DE LATEX RECUBIERTO DE SILICONA.
2504665	42311901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-3	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO QUIRURGICO EN FORMA DE T	TUBO QUIRURGICO EN T 12 FR PARA DRENAJE DE LATEX RECUBIERTO DE SILICONA. CONSISTE EN

							NO. 10 FR PARA DRENAJE DE FLUIDOS BIOLOGICOS	UN VASTAGO Y UNA PISTA CRUZADA. SE UTILIZA PARA QUIRURGICAMENTE.
GRUPO SUTURAS E INSUMOS PARA SINTESIS								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2500674	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	ACERO QUIRURGICO No. 5 ADULTO-SUTURA QUIRURGICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE ACERO INOXIDABLE	SUTURA QUIRURGICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE UNA ALEACION 316L DE COLOR PLATA METALICA-CALIBRE DE LA HEBRA 5 DE 4X45cm DE LONGITUD CON AGUJA CORTANTE DE ½ CIRCULO DE 48 mm O SIMILAR
2501285	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	AGUJA CON OJO PARA MONTAR SUTURA1/2 CIRCULO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	AGUJA MEDIO CIRCULO- AHUSADA- CON OJO CUADRADO U OVAL PARA MONTAR SUTURA EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- CON UNA ALEACION DE CROMO.
2500680	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 1 AGUJA CURVA. SUTURA ABSORBIBLE AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA LONG 36-37mm. HEBRA LONGITUD 90 cm DE LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 1 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 36 A 37 mm DE 90 cm DE LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME.

2500681	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 0 AGUJA CURVA. SUTURA ABSORBIBLE AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA LONG 36-37mm. HEBRA LONGITUD 90 cm LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 0 AGUJA DE 1/2 CÌRCULO DE 36 A 37 mm- DE 90 cm DE LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500683	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 2/0 AGUJA CURVA. SUTURA ABSORBIBLE AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA LONG 36-37mm. HEBRA LONGITUD 90 cm LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 2/0 AGUJA DE 1/2 CÌRCULO DE 36 A 37 mm DE 90 cm LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500683	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 2/0 AGUJA CURVA SUTURA ABSORBIBLE PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36 A 37 mm DE 90 cm DE LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 2/0 AGUJA DE 1/2 CÌRCULO DE 36 A 37 mm DE 90 cm LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME

2500685	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 3/0 AGUJA CURVA SUTURA ABSORBIBLE PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26 mm DE 70-75 cm DE LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 3/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO CODIGO REDONDA DE 26 mm Y DE 70 A 75 cm DE LONGITUD DEL HILO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500688	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 4/0 AGUJA CURVA SUTURA ABSORBIBLE PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 17 mm DE 70-75 cm DE LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 4/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO CODIGO REDONDA DE 17 mm Y LONGITUD DE HILO 70 A 75 cm DE LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500689	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 5/0 AGUJA CURVA SUTURA ABSORBIBLE PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 17 mm DE 70-75 cm DE LARGO	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL- COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS- CATGUT CROMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCION- SOBRE CON SOLUCION CONSERVANTE CALIBRE 5/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO CODIGO REDONDA DE 17.0 mm Y LONGITUD DEL HILO DE 70 A 75 cm DE LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME

2500700	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CATGUT CROMADO NO. 9/0 DOBLE AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA DE 3/8 DE CIRULO DE 17 mm DE 5.5-6.5 mm DE 30 cm DE LARGO	MONOFILAMENTO DE POLIMERO ALIPATICO DE CADENA LARGA DE NYLON 6 Y NYLON 6-6 - NO ABSORBIBLE- CALIBRE 9/0- DOBLE AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA DE 3/8 CIRCULO DE 5-5 A 6-5 mm DE 30 cm DE LARGO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2503782	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CINTA PARA TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA TVT/TOT DE POLIPROPILENO CON CONECTORES INCORPORADOS	CINTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA. BANDA LIBRE DE TENSION. CON DOS PASADORES TIPO AGUJA DE ACERO INOXIDABLE.
2503694	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CLIP EN POLIMERO DE SEGURIDAD BIOCOMPATIBLE NO ABSORBIBLE PARA LIGAR ESTRUCTURAS DE 5 A 10 mm	CLIP EN POLIMERO DE SEGURIDAD BIOCOMPATIBLE NO ABSORBIBLE PARA LIGAR ESTRUCTURAS DE 5 A 10 mm NO ABSORBIBLE- NO CONDUCTIVO- COMPAT VASOSMAYORES A 16mm
2503695	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	CLIP EN POLIMERO DE SEGURIDAD BIOCOMPATIBLE NO ABSORBIBLE PARA LIGAR ESTRUCTURAS DE 8 A 16 mm	CLIP EN POLIMERO DE SEGURIDAD BIOCOMPATIBLE NO ABSORBIBLE PARA LIGAR ESTRUCTURAS DE 8 A 16 mm NO ABSORBIBLE- NO CONDUCTIVO- COMPAT VASOSMAYORES A 16mm

2503676	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	DISPOSITIVO ABSORBIBLE DE FIJACION CON SUJETADOR-CORREA DE BAJO PERFIL QUE DEJA MINIMO MATERIAL EXTRAÑO EXPUESTO A LAS VISCERAS	DISPOSITIVO ABSORBIBLE DE FIJACION CON SUJETADOR- CORREA DE BAJO PERFIL QUE DEJA MINIMO MATERIAL EXTRAÑO EXPUESTO A LAS VISCERAS- UT PERIODO DE INTEGRACION DE LOS TEJIDOS Y AYUDA A EVITAR LAMIGRACION DE LA MALLA. PRESENTACION- DISPOSITIVO DE USO UNICO
2503677	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	DISPOSITIVO ABSORBIBLE DE FIJACION CON SUJETADOR-CORREA DE BAJO PERFIL QUE DEJA MINIMO MATERIAL EXTRAÑO EXPUESTO A LAS VISCERAS	DISPOSITIVO ABSORBIBLE DE FIJACION CON SUJETADOR- CORREA DE BAJO PERFIL QUE DEJA MINIMO MATERIAL EXTRAÑO EXPUESTO A LAS VISCERAS- UT PERIODO DE INTEGRACION DE LOS TEJIDOS Y AYUDA A EVITAR LAMIGRACION DE LA MALLA. PRESENTACION- DISPOSITIVO DE USO UNICO
2503682	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	ENDOCORTADORA MECANICA ARTICULADA DE LONGITUD DE 45-60mm- INSTRUMENTO ARTICULADO	ENDOCORTADORA MECANICA ARTICULADA DE LONGITUD DE 45-60mm- INSTRUMENTO ARTICULADO QUE APLICA GRAPAS Y SIMULTANEAMENTE DIVIDE LOS TEJI TOTAL DE LAS MANIDIBULAS- OPERACION CON UNA SOLA MANO- BLOQUEO DE SEGURIDAD- RETORNO AUTOMATICO DE LA CUCHILLA- FACIL MANIPULACION
2503689	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA CIRCULA INTRALUMINALES CON LONGITUD DE EJE DE 18 Y 28 mm	GRAPADORA CIRCULA INTRALUMINALES CON LONGITUD DE EJE DE 18 Y 28 mm- DISEÑADA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS ABIERTOS. COMPRESION D CONCLUIDO- FACIL INSERCION-OPERACION Y REMOCION- DISEÑO ERGONOMICO.
2503687	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA CURVA CORTANTE DE 40mm EN ESPACIO DE 30mm DE ANCHO- DISPOSITIVO	GRAPADORA CURVA CORTANTE DE 40mm EN ESPACIO DE 30mm DE ANCHO- DISPOSITIVO DE MULTIPLES DISPAROS- CABEZA CURVA QUE CORTA Y GRAPA. DE4 UNESPACIO DE 30mm-GRAPADO-CORTE SIMULTANEO- LONGITUD DE VASTAGO LARGO- DISEÑO ERGONOMICO. PARA PROCEDIMIENTOS COLORECTALES-

							DE MULTIPLES DISPAROS	
2503690	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA HEMORROIDAL CIRCULAR DE 33mm ALTURA DE GRAPA CERRADA DE 0.75 Y 1.5 mm	GRAPADORA HEMORROIDAL CIRCULAR DE 33mm ALTURA DE GRAPA CERRADA DE 0.75 Y 1.5mm. DIAMETRO DE 33mm- ALTURA DE LA GRAPA (CERRADA) DE 0. TRANSPARENTE-YUNQUE FIJO. PARA PROCEDIMIENTOS DE PROLAPSOS Y HEMORROIDES.
2503684	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 35-45mm- CON 2-6-FILAS DOBLES DE GRAPAS ESCALONADAS	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 35-45mm- CON 2-6-FILAS DOBLES DEGRAPAS ESCALONADAS-DIVIDE EL TEJIDO ENTRE LAS FILAS. LONGITUDES DE LIN TAMAÑOS.SE PUEDE UTILIZAR EN CIRUGIA-CIRUGIA GENERAL- GINECOLOGICA- PEDIATRICA-UROLOGICA. ESTERIL. DE UN SOLO USO.
2503678	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55-75mm- CON 6-FILAS DE GRAPAS QUIRURGICAS CON EXCELENTE HEMOSTASIA	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55-75mm- CON 6-FILAS DE GRAPAS QUIRURGICAS CON EXCELENTE HEMOSTASIA- FUNCION DE ALTURA DE GRAPA SELECCI ANTIDESLIZANTE-HOJA DE CUCHILLA INTEGRADA. SE PUEDE UTILIZAR EN CIRUGIA BARIATRICA- COLORRECTAL-GASTROINTESTINAL- CIRUGIA GENERAL
2503679	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA LINEAL CORTANTE PROXIMAL DE 55-75mm CON 6 GRUPOS DE GRAPAS QUIRURGICAS	GRAPADORA LINEAL CORTANTE PROXIMAL DE 55-75mm- CON 6-FILAS DE GRAPAS QUIRURGICAS CON EXCELENTE HEMOSTASIA- FUNCION DE ALTURA DE GRAP SUPERFICIE DE AGARRE ANTIDESLIZANTE- HOJA DE CUCHILLA INTEGRADA. SE PUEDE UTILIZAR EN CIRUGIA BARIATRICA-COLORRECTAL- GASTROINTESTI USO
2502685	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE 10X15CMS, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD, ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE 10x15cms, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALE MANEJABILIDAD USO EN CIRUGIA ABDOMINAL COMO REFUERZO DE LA PARED ABDOMINAL.EMPAQUE CAJA X1UNIDAD. ESTERIL. IMPERMEABLE. FACIL APERTURA ILUSTRATIVA.

2504893	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA SINTETICA DE POLIESTER CON AUTOFIJACION, PARA REPARACION ABIERTA DE LA HERNIA INGUINAL. LONG 15X15CM	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE 15x15cms, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALE MANEJABILIDAD USO EN CIRUGIA ABDOMINAL COMO REFUERZO DE LA PARED ABDOMINAL.EMPAQUE CAJA X 1UNIDAD ESTERIL IMPERMEABLE FACIL APERTURA ILUSTRATIVA.LONG15X15CM
2565521	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA PLANA DE POLIESTER CAJA X 1 UNIDAD LONG 30X30CM	MALLA PLANA DE POLIESTER NO ABSORBIBLE MALEABLE PARA LA REPARACION DE LA PARED ABDOMINAL.LONG30X30CM.EMPAQUE CAJA X1 UNIDAD.ESTERI ILUSTRATIVA
2582850	42140000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIESTER HIDROFILICA TRIDIMENSIONAL 15 CM X 15 CM	MALLA DE POLIESTER MONOFILAMENTO TRIDIMENSIONAL-UNO DE SUS LADOS ESTA CUBIERTO DE UNAPELICULA ABSORBIBLE-CONTINUA E HIDROFILICA MACRO Y MICRO POROSA-REFUERZA LOS TEJIDOS BLANDOS A LARGO PLAZO
2565520	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIGLAGTINA910 L/30X30CM	MALLA EN POLIGLACTINA 910 EN TEJIDO DE CODIGOTO ABSORBIBLE DE BAJA DENSIDAD. PARA REPARACIONES Y SOPORTE TEMPORAL DE ORGANOS. LONG30X3 ILUSTRATIVA.
2565518	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA (UHS)TRIDIMENSIONAL L1/6X12X 10CM	MALLA/SISTEMA PARA HERNIA (UHS)DISPOSITIVO ESTERIL PREFORMADO Y TRIDIMENSIONAL EN POLIPROPILENO COMPUESTO POR UN PARCHE SUPERIOR U PELICULA ABSORBIBLE PLANA Y SIN TINTA DE POLIGLECAPRONE 25 LIGERA FUERTE FLEXIBLE CONFORTABLE Y ABSORBIBLE.LONG 6X12X10CM.CAJAX1UNI ILUSTRATIVA.
2565519	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA (UHS)TRIDIMENSIONAL M1/6X12X 10CM	MALLA/SISTEMA PARA HERNIA (UHS)DISPOSITIVO ESTERIL PREFORMADO Y TRIDIMENSIONAL EN POLIPROPILENO COMPUESTO POR UN PARCHE SUPERIOR UN PELICULAABSORBIBLE PLANA Y SIN TINTA DE POLIGLECAPRONE 25. LIGERA FUERTE FLEXIBLE CONFORTABLE Y A ABSORBIBLE.LONG 6X12X7.5CM UNIDAD ILUSTRATIVA.
2503600	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA EN POLIPROPILENO LONG 7.6CMX15CM	MALLA QUIRURGICA PLANA COMPUESTA POR POLIPROPILENO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE BAJA DENSIDAD BLANCA, LONGITUD 7.6cmx15cm, CON PRO CONRAYOS GAMA. INDICADA PARA LA REPARACION DE HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL Y OTROS DEFECTOS FASCIALES. EMPAQUE INDIVIDUAL.

2504790	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA SIN PASADORES. LIBRE DE TENSION. MALLA 100% POLIPROPILENO, MONOFILAMENTO	MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA SIN PASADORES. LIBRE DE TENSION. MALLA 100% POLIPROPILENO, MONOFILAMENTO, MACROPORO TIPOLOS LADOS DE LA INGLE)
2504624	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA DERECHA 3"x5" (8.5cm x 13.7cm). MEDIANA	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL
2504625	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA DERECHA 4"x6" (10.8cm x 16cm) GRANDE	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL
2504626	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA DERECHA 5"x7" (12.4cm x 17.3cm) EXTRA-GRANDE	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL
2504623	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA IZQUIERDA 5"X7" (12.4CM X 17.3CM) EXTRA-GRANDE	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL

2504621	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA IZQUIERDA 3"x5" (8.5cm x 13.7cm). MEDIANA	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL
2504622	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA TRIDIMENSIONAL, PREFORMADA, MACROPOROSA IZQUIERDA 4"x6" (10.8cm x 16cm) GRANDE	MALLA TRIDIMENSIONAL PREFORMADA-ANATOMICA MACROPOROSA (PORO MAYOR DE 75µm) Y/O RETICULAR TIPO I, A BASE DE POLIPROPILENO (PP), NO CO INDIVIDUAL
2501164	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA MONOFILAMENTO PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MAS POLIGLECAPRONE, DE 15 X 15 O SU EQUIVALENTE	MALLA MONOFILAMENTO PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MAS POLIGLECAPRONE, DE 15 X 15 O SU EQUIVALENTE ESTA MALLA ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS FISIOLÓGICOS A LOS QUE ESTÁ SOMETIDA LA PARED ABDOMINAL
2504894	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA MONOFILAMENTO BAJA DENSIDAD 15X30	MALLA QUIRURGICA COMPUESTA DE DOS PARTES IGUALES DE MONOCRIL POLIGLECAPRONE 25 ABSORBIBLE+PROLENE. POLIPROPILENO MONOFILAMENTO ABSOR CAJA X 1 UNIDAD ESTERIL IMPERMEABLE DE FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACIONN ILUSTRATIVA.
2565516	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPIL/POLIGLECAPRONE 25 /6X11	MALLA QUIRURGICA COMPUESTA DE DOS PARTES IGUALES DE MONOCRIL POLIGLECAPRONE 25 ABSORBIBLE+PROLENE. POLIPROPILENO MONOFILAMENTO ABSOR CAJA X 1 UNIDAD ESTERIL IMPERMEABLE DE FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACION ILUSTRATIVA.
2503195	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPIL/POLIGLECAPRONE 25 /6X11	MALLA QUIRURGICA COMPUESTA DE DOS PARTES IGUALES DE MONOCRIL, POLIGLECAPRONE 25 ABSORBIBLE+PROLENE. POLIPROPILENO MONOFILAMENTO ABSO CAJA X 1 UNIDA. ESTERIL, IMPERMEABLE, FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACION ILUSTRATIVA

2503675	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA QUIRURGICA COMPUESTA DE DOS PARTES IGUALES DE MONOCRIL, POLIGLECAPRONE 25, TAMAÑO 15X20CM	MALLA QUIRURGICA COMPUESTA DE DOS PARTES IGUALES DE MONOCRIL, POLIGLECAPRONE 25, TAMAÑO 15x20cm. MALLLA DE POLIPROPILENO NO ABSORBIB
2505088	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE LONGITUD 30X30CM, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE, LONGITUD 30x30cm, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD, PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALES DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE Y COPOLIMERO DE GLICOLIDA ABSORBIBLE. AMBOS MONOFILAMENTOS SE ENTRELAZAN PARA FORMAR LA MALLA. EXCELENTE MANEJABILIDAD, USO EN CIRUGIA ABDOMINAL (ABIERTA O LAPAROSCOPICA) COMO REFUERZO DE LA PARED ABDOMINAL. PUEDE SER CORTADA Y ADAPTADA A LA FORMA REQUERIDA SIN PERDER LA SEGURIDAD DE SU TEJIDO. PROVEE ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL SIMILAR A LA PARED ABDOMINAL, ADAPTANDOSE A LA ANATOMIA. EMPAQUE CAJA X 1 UNIDAD. ESTERIL. IMPERMEABLE. FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACION ILUSTRATIVA
2505089	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPIL/POLIGLECAPRONE 25 /10X12	MALLA POLIPROPILENO/POLIGLECAPRONE, LONGITUD 6x11cm, MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD, PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALES DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE Y COPOLIMERO DE GLICOLIDA ABSORBIBLE. AMBOS MONOFILAMENTOS SE ENTRELAZAN PARA FORMAR LA MALLA. EXCELENTE MANEJABILIDAD, USO EN CIRUGIA ABDOMINAL (ABIERTA O LAPAROSCOPICA) COMO REFUERZO DE LA PARED ABDOMINAL. PUEDE SER CORTADA Y ADAPTADA A LA FORMA REQUERIDA SIN PERDER LA SEGURIDAD DE SU TEJIDO. PROVEE ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL SIMILAR A LA PARED ABDOMINAL, ADAPTANDOSE A LA ANATOMIA. EMPAQUE CAJA X 1 UNIDAD. ESTERIL. IMPERMEABLE. FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACION ILUSTRATIVA
2565517	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA POLIPROPILEN	MALLA QUIRURGICA PLANA COMPUESTA POR POLIPROPILENO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE BAJA DENSIDAD BLANCA

							O LONG 30 X30CM	SINTETICA TAMAÑO DEL PORO 1 IMPERMEABLEDE FACIL APERTURA Y ADECUADA INFORMACION ILUSTRATIVA.
2503544	42182706	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MALLA SINTETICA DE POLIESTER CON AUTOFIJACION, PARA REPARACION ABIERTA DE LA HERNIA INGUINAL. LONG 15X15CM	MALLA SINTETICA DE POLIESTER + SISTEMA DE AGARRE REABSORBIBLE, CON AUTOFIJACION; DE PESO LIGERO, POROSIDAD OPTIMA PARA POTENICIAR EL HERNIA INGUINAL. LONGITUD: MALLA CUADRADA 15x15cm
2500702	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.006	NYLON No. 10/0 AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA DOBLE ARMADA-3/8 CIRCULO-LONG 5.5-6.5 mm-LONGITUD DE LA HEBRA 30 cm	NYLON MONOFILAMENTO 10-0 AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA- DOBLE ARMADA- DE 5-5 A 6.5mm- 3/8 CIRCULO- LONGITUD DE LA HEBRA DE 30cm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2503693	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	PINZA APLICADORA DE CLIP DEL SISTEMA LIGADURA A PRECISION PARA ENDOSCOPIA DE 10mm TAMAÑO LARGA XL	PINZA APLICADORA DE CLIP DEL SISTEMA LIGADURA A PRECISION PARA ENDOSCOPIA DE 10mm TAMAÑO LARGA XL

2500707	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIDIOXANONA No. 1 AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRC DE 60 mm MINIMO LONG HEBRA VIOLETA EN ASA LONG 70 cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA SIN MEMORIA CALIBRE 1 ANTIBACTERIAL. LONGITUD DEL HILO 120 cm CON AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 60 mm MINIMO EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA
2500715	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIDIOXANONA No. 4/0 AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRC DE 17 mm MINIMO LONG HEBRA VIOLETA EN ASA LONG 120-125cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO VIOLETA SIN MEMORIA CALIBRE 4/0. ANTIBACTERIAL LONGITUD DEL HILO 70 cm CON AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA
2500716	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIESTER CINTA AGUJA CURVA-SUTURA SINTETICA NO ABSORB. DOS AGUJ 1/2 CIRC ROMA LONG 65-70mm. CINTA POLIESTER BLANCO ANCH 5mm LONG 30-35cm	SUTURA DE POLIESTER ESPECIALIZADA PARA EL CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO ESTILO CINTA DE 5 mm MATRIAL NO ABSORBIBLE
2500737	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N°1 AGUJA 1/2 CIRCULO DE 36-37mm-LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 1 LONGITUD DE HEBRA DE 90 cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO- DE 36 A 37 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-

2500738	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 0 AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36-37mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 36 A 37 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 0 LONGITUD DE HEBRA DE 90 cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO- DE 36 - 37 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500740	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 2/0 AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36-37mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA DE 90cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO- DE 36-37 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500741	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 2/0 AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO- DE 26mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500742	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 3/0 AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO- DE 26mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-

2500743	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 3/0 REVERSA CORTANTE REDONDA 3/8 CIRCULO DE 19-20 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO- VIOLETA TRENZADO- CALIBRE 3/0 LONGITUD DE 70cm MINIMO- CON AGUJA REVERSA CORTANTE REDONDA DE 3/8 CIRCULO 19 A 20 mm MINIMO EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500747	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 4/0 PUNTA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO- VIOLETA TRENZADO- CALIBRE 4-0 AGUJA CODIGO REDONDA DE 1/2 CIRCULO 15mm HASTA 17mm LONGITUD MINIMO 70 cm O SU EQUIVALENTE. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500748	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 4/0 REVERSA CORTANTE REDONDA 3/8 CIRCULO DE 13 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA MULTIFILAMENTO ABSORBIBLE TRENZADO POLIGLACTINA 910 CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 REVERSO CORTANTE DESDE 13 mm - LONGITUD HILO 45 cm MINIMO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500749	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 5/0 AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA 1/2 CIRCULO DE 15-17 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO- VIOLETA TRENZADO- CALIBRE 5/0 LONGITUD DE 45cm MINIMO- CON AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 1/2 CIRCULO- DE 15mm A 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500751	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 5/0 AGUJA PUNTA CORTANTE PLASTICA DE 3/8 DE CIRCULO	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATO DE CALCIO- VIOLETA TRENZADO- CALIBRE 5-0 AGUJA CODIGO CORTANTE PLASTICA DE 3/8 CIRCULO DE 13 mm-LONGITUD DEL HILO MINIMO 45 cm O SU

							DE 13 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	EQUIVALENTE. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME
2500753	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 6/0 AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA 1/2 CIRCULO DE 15-17 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO- VIOLETA TRENZADO- CALIBRE 6/0 LONGITUD DE 45cm MINIMO- CON AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 1/2 CIRCULO- DE 15mm A 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500754	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 6/0 REVERSA CORTANTE REDONDA 3/8 CIRCULO DE 11 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	MULTIFILAMENTO ABSORBIBLE TRENZADO POLIGLACTINA 910- CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE DE 11 mm-LONGITUD HILO 45 cm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500758	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLECAPRONE 25 N° 3/0 AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO-3/8 CIRCULO DE 24 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRONE 25 ANTIBACTERIAL PREPARADA DE UN COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON- CAPROLACTONA MONOFILAMENTO INCOLORA SIN MEMORIA CALIBRE 3/0 DE 45 cm DE LONGITUD DEL HILO CON AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO 3/8 CIRCULO DE 24 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA

2500761	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLECAPRONE 25 N° 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO-3/8 CIRCULO DE 19 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRONE 25 ANTIBACTERIAL PREPARADA DE UN COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON- CAPROLACTONA MONOFILAMENTO INCOLORA SIN MEMORIA RECUBIERTA ANTIBACTERIAL CALIBRE 4/0 DE 45 cm DE LONGITUD DEL HILO CON AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO 3/8 CIRCULO DE 19 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA
2500763	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLECAPRONE 25 N° 5/0 AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO-3/8 CIRCULO DE 11 mm-LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRONE 25 ANTIBACTERIAL PREPARADA DE UN COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON- CAPROLACTONA MONOFILAMENTO INCOLORA SIN MEMORIA RECUBIERTA ANTIBACTERIAL CALIBRE 5/0 DE 45 cm DE LONGITUD DEL HILO CON AGUJA REVERSO CORTANTE PLASTICO 3/8 CIRCULO DE 11 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA
2500764	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 1 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO LONGITUD 36-37mm. HEBRA LONGITUD 70-75	SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL DE POLIPROPILENO COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 1 LONGITUD DE 70 A 75cm- AGUJA CODIGO REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 A 37mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.

2500765	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO LONGITUD 36-37mm. HEBRA LONGITUD 70-75	SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL DE POLIPROPILENO COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 0 LONGITUD DE 70 A 75cm- AGUJA CODIGO REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 A 37 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500768	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO No. 2/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE LONGITUD 24-26mm. LONGITUD DE LAHEBRA 45 cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 45cm- AGUJA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO DE 24 A 26-0mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500769	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 2/0 CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA REDONDA LONG9-10 mm HEBRA LONG 90-95cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HILO DE 90cm- DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO DE 26-0mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500772	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 3/0 LONGITUD DE 45cm- AGUJA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO DESDE 24 A 26-0mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA

							LONG 23-26mm. HEBRA LONG 45-50cm	MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500773	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 25-27mm. HEBRA LONG 90-95	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 3/0 LONGITUD HILO DE 90 cm- DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO DE 26mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500775	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO No. 3/0 AGUJA RECTA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA RECTA REVERSO CORTANTE LONG 60-62mm. HEBRA LONG 75-80cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 3/0 LONGITUD HILO DE 75cm- AGUJA RECTA CORTANTE DE 60-0mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500776	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE LONG 19-21 mm HEBRA LONG 45-50cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 4/0 LONGITUD HILO DE 45 cm- AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA

2500779	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO No. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 15-17mm. HEBRA LONG 75-80	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 4/0 LONGITUD HILO DE 90 cm- DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO DE 15mm A 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500780	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 4/0 AGUJA CURVA-SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 3/8 CIRCULO CORTANTE LONG 13-19mm. HEBRA LONG 45-50cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 4/0 LONGITUD HILO DE 45 cm- AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500782	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CIRC REVERSO CORTANTE LONG 13-15mm. HEBRA LONG 45-5	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 5/0 LONGITUD HILO DE 45 cm- AGUJA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO DE 11 A 13mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500783	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO No. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO- CALIBRE 5/0 LONGITUD HILO DE 75 cm- DOBLE AGUJA REDODNDA DE 1/2 CIRCULO DE 15mm A 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA

							15-17mm. HEBRA LONG 75-80	AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500787	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO No. 6/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO AHUSADA LONG 9.0-10mm. HEBRA LONG 60-65cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO 6-0 DOBLE AGUJA REDONDA DE 9 A 10 mm- 3/8 CIRCULO-LONGITUD DE LA HEBRA 60cm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500788	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIPROPILENO NO. 7/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO AHUSADA LONG 9.0-10mm. HEBRA LONG 60-65cm	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO- ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA- AZUL MONOFILAMENTO 7-0 DOBLE AGUJA REDONDA DE 9 A 10 mm- 3/8 CIRCULO-LONGITUD DE LA HEBRA 60cm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA.
2500792	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 25mm-27mm. HEBRA LONGITUD 75cm-80cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA- DE LONGITUD DE HILO 75 cm - CALIBRE 0 CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 26mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-

2500794	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA No. 2/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 25mm-27mm. HEBRA LONGITUD 75cm-80cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA-CALIBRE 2/0 DE LONGITUD 75 cm- CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 26-mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2500795	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA No. 2/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 25mm-27mm. HEBRA LONGITUD 45cm-50cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA-CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 45 cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA CORTANTE 3/8 CIRCULO HASTA 26 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2502281	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 25-27mm. HEBRA LONGITUD 75-80cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA-CALIBRE 3/0 DE LONGITUD 75 cm- CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 26-0mm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2502287	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 15mm-17mm.	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA CALIBRE 4/0 - AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17 mm-LONGITUD HILO 75 cm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL

							HEBRA LONGITUD 75cm-80cm	TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2502290	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONGITUD 15mm-17mm. HEBRA LONGITUD 75cm-80cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA CALIBRE 5/0 - AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17 mm-LONGITUD HILO 75 cm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME.
2502294	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 0 SIN AGUJA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE (LIGADURA DE TEJIDOS). OCHO A DIEZ HEBRAS LONGITUD 75 cm - 80 cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA-CALIBRE 0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 cm MINIMO. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO.
2502295	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO.2/ 0 SIN AGUJA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE (LIGADURA DE TEJIDOS). OCHO A DIEZ HEBRAS LONGITUD 75 cm - 80 cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA-CALIBRE 2/0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 cm. EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO.
2502296	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SEDA NO. 3/0 SIN AGUJA. SUTURA ORGANICA NO ABSORBIBLE (LIGADURA DE TEJIDOS). OCHO A DIEZ HEBRAS LONGITUD 75 cm - 80 cm	SUTURA NO ABSORBIBLE- ESTERIL- TRENZADA-TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL- COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA- E 3/0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 cm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO

2503692	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTEMA DE DRENAJE DE SILICONA ESTERIL DE 10 FR - 15F - 10FR Y 24 FR CON RESERVORIO DE 150 ML - 300ML Y BULBO DE SUCCION DE 100 ML	PINZA APLICADORA DE CLIP DEL SISTEMA LIGADURA A PRECISION TAMAÑO ML DE 5 mm
2504053	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIDIOXANONA NO. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA LONG 15-17mm. HEBRA PDS VIOLETA. LONG 70-75cm	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA VIOLETA SIN MEMORIA CALIBRE 5/0. LONGITUD DE LA HEBRA 70 cm. AGUJA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 17 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-EMPAQUE QUE PERMITA MINIMA MEMORIA DE LA SUTURA
2504452	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.003.005	POLIGLACTINA 910 N° 3/0 AGUJA CURVA MEDIANA. SUTUR SINTET ABSORB. AGU 1/2 CIRCULO LONG 25-27mm HEBRA POLIGLA VIOLETA LONG 70-75cm	SUTURA ESTERIL- SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 COMPUESTA DE UN COPOLIMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA- VIOLETA TENZADO- CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 cm - CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA GRUESA 1/2 CIRCULO-DE 26 mm EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DEBEN SER SEGURO Y ERGONOMICO-LA SILUETA DE LA AGUJA MOSTRADA EN EL EMPAQUE DEBE SER LA DEL TAMAÑO REAL-EL ENSAMBLE DE LA AGUJA AL MATERIAL DE SUTURA DEBE SER FIRME-
2503683	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA ENDOCORTADORA DE 45-60mm	RECARGA PARA ENDOCORTADORA DE 45-60mm-CODI UN COLOR No FI TEJIDO ALTURA GO CARTU LAS GRAPA 3.8MM 1.8MM ECR45G 12 GREEN 6 THICK 4.1MM 2.0MM ECR60W 12 WHITE 6 VASCULAR/THIN 2.5MM 1.0MM ECR60D 12 GOLD 6 REGULAR/THICK 3.8 MESSENTERY/T
2503686	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA 35 mm - 45 mm	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA 35 mm - 45 mm EN TITANIO

2503688	42312201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA CURVA CORTANTE 40mm	RECARGA GRAPADORA CURVA CORTANTE 40MM CR40B 3 AZUL 4 REGULAR 3.5 1.44MM CR40G 3 VERDE 4 GRUESO 4.7 2.0MM
2503685	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA RECTA DE 35 - 45 mm	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA RECTA DE 35 - 45 mm EN TITANIO
2503680	42312203	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 Y 75mm CON ALTURA DE GRAPA	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 Y 75mm CON ALTURA DE GRAPA- CODIGO UN COLOR No FI TEJIDO ALTURA GOCARTU 3.85mm TVR55 12 BLANCO 2 VASCULAR/DELGADO 4.20mm TRT55 12 VERDE 2 GRUESO 4.50mm 2.0mm TCR75 12 AZUL 2 REGULAR 3.85mm TRT75 12 V4.20mm
2503681	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-4	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL PROXIMAL 55-75mm	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL PROXIMAL DE 55 Y 75mm CON ALTURA DE GRAPA- CODIGO UN COLOR No FI TEJIDO ALTURA GOCARTU 3.85mm TVR55 12 BLANCO 2 VASCULAR/DELGADO 4.20mm TRT55 12 VERDE 2 GRUESO 4.50mm 2.0mm TCR75 12 Azul 2 REGULAR 3.85mm TRT75 12 V4.20mm

GRUPO INSUMOS DE CURACION

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2503117	51171630	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.003.03	ACEITE MINERAL FRASCO POR 1000ML	ACEITE MINERAL, LIQUIDO TRANSPARENTE ALMACENADO EN FRASCO DE 1000 ML, MEZCLA DE HIDROCAR-BUROS LIQUIDOS REFINADOS PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES FARMACEUTICA, INSOLUBLE EN AGUA, SOLVENTE CON OLOR SUAVE, POCO SOLUBLE EN ETANOL AL 96% Y MISCIBLE CON HIDROCARBUROS COMO BENCENO, ETER, PARA USO REACTIVO DE LABORATORIO EN MEDICINA Y FARMACIA.
2504521	51171630	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.003.03	ACEITE MINERAL FRASCO POR 120 ML	ACEITE MINERAL, LIQUIDO TRANSPARENTE, SOLVENTE CON OLOR SUAVE EN FRASCO POR 120 ML MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS REFINADOS, PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES FARMACEUTICA INSOLUBLE EN AGUA, POCO SOLUBLE EN ETANOL AL 96% Y

								MISCIBLE CON HIDROCARBUROS COMO BENCENO, ETER.
2583912	51171630	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.003.03	ACEITE MINERAL FRASCO POR 500 ML	ACEITE MINERAL, LIQUIDO TRANSPARENTE, SOLVENTE CON OLOR SUAVE EN FRASCO POR 500 ML MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS REFINADOS PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES FARMACEUTICA INSOLUBLE EN AGUA, POCO SOLUBLE EN ETANOL AL 96% Y MISCIBLE CON HIDROCARBUROS COMO BENCENO, ETER.
2502534	51171630	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.003.03	ACEITE MINERAL FRASCO POR 750 ML	ACEITE MINERAL, LIQUIDO TRANSPARENTE, SOLVENTE CON OLOR SUAVE EN FRASCO POR 750 ML MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS REFINADOS PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES FARMACEUTICA INSOLUBLE EN AGUA, POCO SOLUBLE EN ETANOL AL 96% Y MISCIBLE CON HIDROCARBUROS COMO BENCENO, ETER.
2502222	51171630	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	GLN	A.02.02.01.003.003.03	ACEITE MINERAL FRASCO GALON (3.78 L, 3780ml)	ACEITE MINERAL, LIQUIDO TRANSPARENTE, SOLVENTE CON OLOR SUAVE EN FRASCO POR TIPO GALON MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS REFINADOS, PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES FARMACEUTICA INSOLUBLE EN AGUA, POCO SOLUBLE EN ETANOL AL 96% Y MISCIBLE CON HIDROCARBUROS COMO BENCENO, ETER.
2584197	42312403	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.006	ADHESIVO TOPICO PARA PIEL DE ALTA VISCOSIDAD. USO IDIVIDUAL.	ADHESIVO TOPICO DE POLIMERIZACION RAPIDA, TUBO-PINCEL POR 0.3-0.5 Y 0.75ml DE ALTA VISCOSIDAD PARA EL CIERRE DE HERIDAS. CON FORMULA MONOMERICA 2-OCTIL CIANOCRILATO+ BORDES DE LAS HERIDAS QUIRURGICAS, LACERACIONES SIMPLES.
2502671	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL ETILICO AL 96% FRASCO X 720 CC	ALCOHOL ETILICO AL 96 PORCIENTO, SOLUCION DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS. LIQUIDO TRANSPARENTE DE OLOR CARACTERISTICO. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, ANTISEPTICO. PARA USO FARMACOLOGICOS. MEDICINALES. DROGAS HOMEOPATICAS. MEDICINA. ANTISEPTICO.
2503019	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL ETILICO AL 80% FRASCO	ALCOHOL ETILICO AL 80 PORCIENTO EN FRASCO, SOLUCION DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS. LIQUIDO TRANSPARENTE DE OLOR CARACTERISTICO. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, ANTISEPTICO. PARA USO FARMACOLOGICOS. MEDICINALES. DROGAS HOMEOPATICAS. MEDICINA. ANTISEPTICO.

2504027	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	GLN	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO/ALCOHOL ETILICO 65%. GALON	ALCOHOL GLICERINADO AL 65 PORCIENTO. INGREDIENTE ACTIVO ANTIMICROBIANO: ALCOHOL ETILICO AL 65 PORCIENTO Y AGENTE EMOLIENTE. GEL HOMOGENEO TRANSITORIO DE LA PIEL SANA. ES BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA. BIODEGRADABLE. PRESENTACION EN GALON
2503141	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO AL 65% 500ml FRASCO DISPENSADOR	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 65 PORCIENTO EN FRASCO DISPENSADOR POR 500 ML, GEL BACTERICIDA TUBERCULICIDA FUNGICIDA Y VIRUCIDA DE 63 GR X 100 CC, CON ALCOHOL ETILICO Y, O ALCOHOL ISOPROPILICO. NO REQUIERE ENJUAGUE
2502263	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO X 500ml	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 PORCIENTO EN FRASCO POR 1000 ML, GEL BACTERICIDA TUBERCULICIDA FUNGICIDA Y VIRUCIDA CON ALCOHOL ETILICO Y, O ALCOHOL ISOPROPILICO. NO REQUIERE ENJUAGUE
2502251	51102710	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON LAMINADO 3"x5YD. EN ROLLO	ALGODON LAMINADO 3 PULGADAS X 5 YARDAS, VENDA LAMINADA FABRICADA EN ALGODON 100 PORCIENTO PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVES DE UNA RESINA DE ACRILATO. MAXIMA DESCARTABLE. EMPAQUE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2503538	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON LAMINADO 4"X4YD, EN ROLLO	ALGODON LAMINADO 4 PULGADAS X 4 YARDAS, VENDA LAMINADA FABRICADA EN ALGODON 100 PORCIENTO PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVES DE UNA RESINA DE ACRILATO. MAXIMA DESCARTABLE. EMPAQUE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2502252	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON LAMINADO 4"X5YD, EN ROLLO	ALGODON LAMINADO 4 PULGADAS X 5 YARDAS, VENDA LAMINADA FABRICADA EN ALGODON 100 PORCIENTO PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVES DE UNA RESINA DE ACRILATO. MAXIMA DESCARTABLE. EMPAQUE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2501286	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON LAMINADO 5"x5YD, EN ROLLO	ALGODON LAMINADO 5 PULGADAS X 5 YARDAS, VENDA LAMINADA FABRICADA EN ALGODON 100 PORCIENTO PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVES DE UNA RESINA DE ACRILATO. MAXIMA DESCARTABLE. EMPAQUE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2502253	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON LAMINADO 6"X5YD, EN ROLLO	ALGODON LAMINADO 6 PULGADAS X 5 YARDAS, VENDA LAMINADA FABRICADA EN ALGODON 100 PORCIENTO PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVES DE UNA RESINA DE ACRILATO. MAXIMA

								DESCARTABLE. EMPAQUE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE INDIVIDUAL DESCARTABLE.
2502277	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO, NO ESTERIL. PAQUETEx500g	ALGODON HOSPITALARIO 500 GRAMOS EN ROLLO. HILAZA DE ALGODON 100 PORCIENTO PODER ABSORBENTE. LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAL EXTRAÑO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA. NO ESTERIL
2504963	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO PAQUETE X 25 G	ALGODON HOSPITALARIO 25 GRAMOS EN ROLLO HILAZA DE ALGODON 100 PORCIENTO PODER ABSORBENTE. LIBRE DE IMPUREZAS MATERIAL EXTRANO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA NO ESTERIL
2502929	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO NO ESTERIL. PAQUETE X 35g	ALGODON HOSPITALARIO 35 GRAMOS EN ROLLO HILAZA DE ALGODON 100 PORCIENTO PODER ABSORBENTE. LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAL EXTRANO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA NO ESTERIL
2505843	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA NO ESTERIL, BOLSA x 100g,	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA POR 100 GRAMOS ELABORADO CON ALGODON 100 PORCIENTO, BLANQUEADO SIN CLORO NO DERIVADOS Y TRATADO ESPECIALMENTE ABSORBENTE MATERIAL EXTRANO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA. NO ESTERIL
2584158	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA NO ESTERIL, BOLSA x 500g,	TORUNDA SUAVE AL TACTO CON CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE LIQUIDOS 100% ALGODÓN NO ESTERIL EMPAQUE PLASTICO x 500g
2500111	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA NO ESTERIL, BOLSA x 500g,	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA POR 500 GRAMOS. ELABORADO CON ALGODON 100 PORCIENTO, BLANQUEADO SIN CLORO NO DERIVADOS Y TRATADO ESPECIALMENTE, ABSORBENTE. MATERIAL EXTRANO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA. NO ESTERIL
2505855	42141501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA NO ESTERIL, BOLSA x 75g,	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDA POR 75 GRAMOS. ELABORADO CON ALGODON 100 PORCIENTO, BLANQUEADO SIN CLORO NO DERIVADOS Y TRATADO ESPECIALMENTE, ABSORBENTE. MATERIAL EXTRANO Y DESPROVISTA DE MATERIA GRASA. NO ESTERIL
2502868	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, NO ESTERIL, PAQUETE POR 200 UNIDADES	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm MAS O MENOS 2, CODIGO DE ALGODON GRADO USP, DIAMETRO 4 A 5mm Y1 CON EL USO NORMAL. USOS: FROTIS DE MANOS GARGANTA MONITOREO MICROBIOLOGICO, CURACIONES ENTRE OTROS.DESCARTABLE. EMPAQUE PLASTICO POR 200 UNIDADES

2502367	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR DE MADERA PULIDO, SIN ALGODON. NO ESTERIL. PAQUETE POR 500 UNIDADES	APLICADOR DE MADERA PULIDO EMPAQUE INTERIOR EN BOLSITAS DE 500 UNIDDADES SIN ALGODON DE 15 MAS O MENOS 1cm DE LONGITUD Y 2mm A 2.2 mm DE DIAMETRO, PARA TOMA DE MUESTRAS, USO EN EL LABORATORIO
2584100	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, NO ESTERIL, PAQUETE POR 50 UNIDADES	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm + o - 2, CODIGO DE ALGODÓN DESCARTABLE EMPAQUE PLASTICO POR 50 UNIDADES
2503239	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, NO ESTERIL, PAQUETE POR 100 UNIDADES	APLICADOR EN MADERA, EMPAQUE INTERIOR DE 100 UNIDDADES, APLICADOR DE MADERA 150 X 2,2 MM CON TOLERANCIA MINIMA EN EL DIAMETRO, CODIGO CON ALGODON DIAMETRO 4-5 MM, 12 MM DE LARGO EL ALGODON QUE SE USA PARA LA ELABORACION DE LOS APLICADORES ES 100 PORCIENTO ABSORBENTE, NO ESTERIL, LIMPIO, INCOLORO, DE TACTO SUAVE Y LIBRE DE IMPUREZAS.
2584146	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, NO ESTERIL, PAQUETE POR 20 UNIDADES	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm + o - 2, CODIGO DE ALGODÓN DESCARTABLE EMPAQUE PLASTICO POR 20 UNIDADES
2501592	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.003.001	APLICADOR DE MADERA PULIDO, SIN ALGODON. NO ESTERIL. PAQUETE POR 100 UNIDADES	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm + o - 2, DESCARTABLE. EMPAQUE PLASTICO GRADO MEDICO.DISEÑADO PARA TOMA DE MUESTRAS
2500929	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, NO ESTERIL, UNIDAD	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm + o - 2, CODIGO DE ALGODON GRADO USP, DIAMETRO 4-5mm Y1 CON EL USO NORMAL. USOS: FROTIS DE MANOS GARGANTA, MONITOREO MICROBIOLOGICO, CURACIONES ENTRE OTROS. DESCARTABLE. EMPAQUE PLASTICO 32

2500928	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, ESTERIL, PAQUETE POR 5 UNIDADES	APLICADOR CON MANGO DE MADERA INCOLORA DE GRAN RESISTENCIA, CON LONGITUD 15cm + o - 2, CODIGO DE ALGODON GRADO USP, DIAMETRO 4-5mm Y1 ELUSO NORMAL. USOS: FROTISDE MANOS, GARGANTA, MONITOREO MICROBIOLOGICO, CURACIONES ENTRE OTROS. DEDESCARTABLE. EMPAQUE PLASTICO GRA 32
2501052	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	BX	A.02.02.01.003.001	APLICADOR ESTERIL EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON BLANCO X 3 UNIDADES.	APLICADOR EN MADERA, EMPAQUE INTERIOR DE 3 UNIDDADES, APLICADOR DE MADERA 150 X 2,2 MM, CODIGO CON ALGODON DIAMETRO 4-5 MM, 12 MM DE LARGO, EL ALGODON QUE SE USA PARA LA ELABORACION DE LOS APLICADORES ES 100 PORCIENTO ABSORBENTE, ESTERIL, LIMPIO, INCOLORO, DE TACTO SUAVE Y LIBRE DE IMPUREZAS.
2501051	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR EN MADERA CON PUNTA EN ALGODON, ESTERIL, PAQUETE POR 2 UNIDADES	APLICADOR EN MADERA, EMPAQUE INTERIOR DE 2 UNIDDADES, APLICADOR DE MADERA 150 X 2,2 MM, CODIGO CON ALGODON DIAMETRO 4-5 MM, 12 MM DE LARGO, EL ALGODON QUE SE USA PARA LA ELABORACION DE LOS APLICADORES ES 100 PORCIENTO ABSORBENTE, ESTERIL, LIMPIO, INCOLORO, DE TACTO SUAVE Y LIBRE DE IMPUREZAS.
2565531	12171501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	APLICADOR FLUORESCEINA SODICA 10%, MEDIO DE CONTRASTE PARA PATOLOGIAS OCULARES	APLICADOR CON FLUORESCEINA DE SODIO AL 10%. MEDIO DE CONTRASTE PARA PATOLOGIAS OCULARES. TIRA DIAGNOSTICA PARA VISUALIZAR LOS DEFECT CONTACTOS DUROS Y LA TONOMEIA DE APLANACION
2503418	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.003.001	APLICADOR LARGO CON PUNTA EN ALGODON X 1000 UNIDADES	APLICADOR EN MADERA, EMPAQUE INTERIOR DE 1000 UNIDDADES, APLICADOR DE MADERA 150 X 2,2 MM CON TOLERANCIA MINIMA EN EL DIAMETRO, CODIGO CON ALGODON DIAMETRO 4-5 MM, 12 MM DE LARGO EL ALGODON QUE SE USA PARA LA ELABORACION DE LOS APLICADORES ES 100 PORCIENTO ABSORBENTE, NO ESTERIL, LIMPIO, INCOLORO, DE TACTO SUAVE Y LIBRE DE IMPUREZAS.
2502711	42141502	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A.02.02.01.003.001	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODON DE 15 + O - 1CM DE LONGITUD Y 2MM A 2.2MM DE DIAMETRO. NO ESTERIL.	APLICADOR DE MADERA PULIDO EMPAQUE INTERIOR EN BOLSA DE 1000 UNIDDADES, SIN ALGODON DE 15 MAS O MENOS 1cm DE LONGITUD Y 2mm A 2.2 mm DE DIAMETRO, PARA TOMA DE MUESTRAS, USO EN EL LABORATORIO

							PAQUETE POR 1000 UNIDADE	
2503821	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL 10X10CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ABDOMINAL 10X10CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON, HIPOALERGENICO. ESTERIL.
2584028	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL 10x20cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ABDOMINAL 10X20CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON, HIPOALERGENICO. ESTERIL.
2503822	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL 20X20CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ABDOMINAL 20X20CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON, HIPOALERGENICO. ESTERIL.
2503151	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL 20X40CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON, HIPOALERGENICO. ESTERIL, DE MEDIDA DE 20 CMX 40 CM- EMPAQUE INDI 50MM
2503823	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL 5X5CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ABDOMINAL 5X5CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON, HIPOALERGENICO. ESTERIL.
2503408	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 10X15X230cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO FABRICADO EN 100 PORCIENTO ALGODON, ANCHO DE 10 CM MAS O MENOS 1cm, LARGO 15cm MAS O MENOS 1cm, GROSOR DE 7mm MAS O MENOS 2mm, CON BARRERA ANTIFLUIDO, TIRAS DE QUE GARANTICE IPERMEABILIDAD, ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO CUIDADO BASICO DE MANEJO, REGISTRO INVIMA Y FECHA DE VENCIMIENTOS ENTREGA
2502255	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 10X20cm	APOSITO FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 10 CMX 50MM.

2502601	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 20X15X230cm. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, DE COLOR VERDE MILITAR, QUE GARANTICE IPERMEABILIDAD, ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO CUIDADO BAS +o-1cm GROSOR DE 7mm +o- 2mm, CON BARRERA ANTIFLUIDO, TIRAS DE SUJECION EN MATERIAL TEXTIL COLOR VERDE MILITAR Y LARGO DE 230cm +o- ENTREGA
2584161	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 20x25x270cm	APOSITOS ABDOMINALES DISEÑADOS PARA UNA MAXIMA ABSORBENCIA Y COMODIDAD, COMO EN EL CASO DE HERIDAS MUY EXUDATIVAS. CUATRO BORDES SELLADOS. MEDIDAS 20X25X270 CM PRODUCTO ESTERIL.
2502254	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CIRUGIA 8X15cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	GASA SUAVE, ADHESIVA E HIPOALERGENICA DE POLIACRILATO – ALGODÓN CON APOSITO DE ALTA ABSORCIÓN DE SECRECIONES NO ADHERENTE A LA HERIDA, PERMEABLE CON BORDES RODONDEADOS PARA PREVENIR QUE LA GASA SE DESPEGUE DE MINIMO DE 8 x15 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
2502939	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 28x28cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA 28X28CM. APOSITO FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMP MINIMODE 50MM
2502256	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO ABDOMINAL GRANDE CAMPAÑA 20X40cm.	APOSITO FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 20 CMX DE 40CM
2584163	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO DE CAMPAÑA CON CELULOSA 10x16x270cm.	APOSITO DE CAMPO – 10 x 16 x 270 cms - ELABORADO EN MATERIALES: TELA, GASA, ALGODON, CELULOSA Y POLIETILENO - COLOR VERDE MILITAR.
2503152	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO DE GASA ESTERIL 8 X 15cm, EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO FABRICADO EN GASA 100% ALGODON, EN TEJIDO RECTILINEO, PLEGADA DE 6-8 CAPAS, CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION, SUAVE ADAPTABLE MINIMODE 5mm QUE FACILITA SU APERTURA
2505647	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO MULTIPROPOSITO DE CAMPAÑA 10X20X360CM	APOSITO MULTIPROPOSITO DE GASA ESTERIL MEDIDAS DE 10X20X360 POR UNIDAD SE UTILIZA CUBRIRY PRESERVAR HERIDAS DE AGENTES EXTERNOS Y HEMOSTASIA

2504886	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	APOSITO POSTQUIRURGICO 8X15CM	APOSITO POSTQUIRURGICO, ESTERIL, HIPOALERGENICO, PARA HERIDAS, ELASTICO, DE TELA NO TEJIDA, CON ALMOHADILLA ABSORBENTE IMPERMEABLE COMPUESTO SOPORTE: TEJIDO NO TEJIDO DE ALGODON / POLIESTER, ADHESIVO COPOLIMEROS ACRILICOS, APOSITO CENTRAL CON CAPA EXTERNA TEJIDO NO TEJIDO TRATADO QUE HACE QUE SEA REPELENTA AL AGUA, - CAPA INTERMEDIA MEZCLA DE ALGODON Y FIBRAS ACRILICAS, - CAPA DE CONTACTO FILM DE POLIESTER MICROPERFORADO PRESENTACION 10CM X 8CM CAJA X 20 APOSITOS
2503120	51211615	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	AZUL DE METILENO FRASCO x 200ml	AZUL DE METILENO CONOCIDO COMO CLORURO DE METILTIONINA, ES UN COLORANTE ORGANICO CON PROPIEDADES ANTISEPTICAS Y COLORANTE
2505519	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-004-008	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, AERONAVES	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SUPERVICENCIA, BUSQUEDA Y RESCATE PARA SER USADO EN AERONAVES, TRIPULACION Y PASAJEROS DESPUES DE ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TERRENO INHABITADO. PESO 3.2 LBS, TAMANO 9.5" X 9.5" X 2.63" MODELO FAK-5. DE ACUERDO CON LINEAMIENTO DE DOTACION
2500172	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-004-008	BOTIQUIN M-3 + INSUMOS	BOTIQUIN M-3 (SEGUN DIRECTIVA) MORRAL NORMAS TECNICA CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, KIT DE HEMORRAGIA, KIT DE BIOSEGURIDAD, KIT MANTENIMEINTO VIA AREA, KIT DE CURACIONES, KIT DE MOVILIZACIONES, Y OTROS ELEMENTOS DESCRITOS EN LA DIRECTIVA.
2503936	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-004-008	BOTIQUIN M-4 CON INSUMOS+MEDICAMENTOS	BOTIQUIN M-4 (SEGUN DIRECTIVA) MORRAL NORMAS TECNICA CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, KIT DE HEMORRAGIA, KIT DE BIOSEGURIDAD, KIT MANTENIMEINTO VIA AREA, KIT DE CURACIONES, KIT DE MOVILIZACIONES, OTROS ELEMENTOS, KIT DE MEDICAMENTOS DESCRITOS EN LA DIRECTIVA.
2500173	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-004-008	BOTIQUIN M-5 CON MEDICAMENTOS	BOTIQUIN M-5 (SEGUN DIRECTIVA) MORRAL NORMAS TECNICA, CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, KIT DE HEMORRAGIA, KIT DE BIOSEGURIDAD, KIT MANTENIMIENNTO VIA AREA, KIT DE CURACIONES, KIT DE MOVILIZACIONES, OTROS ELEMENTOS, KIT DE MEDICAMENTOS, DESCRITOS EN LA DIRECTIVA.

2503938	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-004-008	BOTIQUIN/KIT PRIMEROS AUXILIOS PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES ELABORADO EN MATERIAL A PRUEBA DE AGUA	BOTIQUIN/KIT PRIMEROS AUXILIOS PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES ELABORADO EN MATERIAL A PRUEBA DE AGUA-RESISTENTE Y QUE FLOTE-DE COLOR AMARILLO- CON TARJETA TRAUMA-GUIA COMPLETA DE MEDICINA MARINA, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CARACTERISTICAS: TAMAÑO: 11.8"x10.6"x6.9". PESO: 7 LIBRAS 4 ONZAS
2503241	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.004.008	BOTIQUIN/KIT PRIMEROS AUXILIOS-CESTA PARA AVIONES, CONSTRUIDO EN MATERIAL ABS RETARDANTE DE LLAMA, DOBLE CIERRE DE PESTILLOS	BOTIQUIN/KIT PRIMEROS AUXILIOS-CESTA PARA AVIONES, CONSTRUIDO EN MATERIAL ABS RETARDANTE DE LLAMA, DOBLE CIERRE DE PESTILLOS PARA AS 10"x10"x2.625"(LWH)-254mmx254mmX66.68 (LWH). CONTENIDO: 1 CONTENEDOR, 1 VENDAJE DE 1", PK DE 16, 1 TORUNDA ANTISEPTICA, PK DE 10, 1 DE VENDAJE
2503237	42171917	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.004.008	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS+MEDICAMENTOS SEGUN NORMA DEL MINISTERIO DE SALUD	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS+MEDICAMENTOS: CAJA PLASTCA O BOLSO/LONA PLENAMENTE IDENTIFICADO, TRANSPORTABLE. COMPONENTES SEGUN LINEAMIENTO DE INSUMOS POR SECRETARIA DE SALUD.
2505549	42131700	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.004	CAMPO QX INCISION 6 X 24"/15 X 61 CM	CAMPO QX INCISION 6 x 24"/15 x 61 cm. CORTINAS ESTERILES EN TELAS CON ZONAS DE ABSORCION DE FLUIDOS. PARA CREAR UNA BARRERA PROTECTORA QUE AYUDE A PREVENIR EL TACHADO Y LA CONTAMINACION. ESTERIL. UTILIZADO COMO BARRERA RESISTENTES A LA PENETRACION DE SANGRE Y OTROS FLUIDOS. HIPOALERGENICO
2505551	42131700	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.004	CAMPO QX INCISION CON YODO 67 X 45 CM	CAMPO QX INCISION CON YODO 67 x 45 cm CAMPO YODADO. PELICULA TRANSPIRABLE Y ANTIBACTERIANO. DELGADO Y FUERTE. ENVOLTURA INDIVIDUAL EN PAPEL ALUMINIO. ESTERIL. EVITANDO HUMEDAD. SIN LATEX.
2584764	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CURITA ADHESIVA REDONDA-CON PELICULA ADHESIVA TRANSPARENT	CURITA ADHESIVA REDONDA: ESTA FABRICADO EN PELICULA POLIETILENO MICROPERFORADO E IMPERMEABLE, A PRUEBA DE AGUA CON ALMOHADILLA ABSORBERTE NO ADHERENTE A LA HERIDA. DIAMETRO 2CM X 2CM TENER EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

							E HIPOALERGENICO	
2502358	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CURITA IMPERMEABLEADHESIVA CON APOSITO CENTRAL, HIPOALERGENICA, TAMAÑO 72X19MM	CURITA ADHESIVA PARCHE EN CAUCHO NATURAL Y POLIESTER, CON PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE HIPOALERGNICO, POROSO Y FLEXIBLE, CON APOSITO FACIL APLICACION.ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.TAMAÑO 72X19MM
2500899	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	GASA DE COMBATE CONTROL DE HEMORRAGIAS-EMPAQUE AL VACIO Y DOBLADA 7.5cmx3.7m	GASA EN EMPAQUE INDIVIDUAL, IMPERMEABLE, EMPAQUETADA AL VACÍO ESTÉRIL CON IMPREGNACIÓN DE AGENTE HEMOSTÁTICO DE MÍNIMO 3M DE LARGO EN (ACORDEÓN O ZIG ZAG), PUEDE AJUSTARSE A CUALQUIER TAMAÑO O FORMA DE HERIDA (INCLUIDAS LAS HERIDAS.
2500416	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA, PRECORTADA 5x5cm DE 2 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA PRECORTADA 5x5cm PAQUETE POR 2 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), SIN ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL.
2500415	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA, PRECORTADA 5x5cm DE 3 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA PRECORTADA 5x5cm PAQUETE POR 3 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), SIN ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL.
2503857	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ESTERIL PRECORTADA CON TESTIGO 10X10CM PAQUETE POR 5 UNIDADES	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 105x105cm, PKx5U. CON TESTIGO RADIOPACO. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27h IGNICIONMAX 0.89%, EXTRACTO ACUOSOS MAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO ALTA
2501282	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA, PRECORTADA 7.5x7.5cm DE 5 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL, NO TEJIDA PRECORTADA 7.5x7.5cm PAQUETE POR 5 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), SIN ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL.

2584030	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA, CON 4 PLIEGUES, 7.5x7.5cm DE 5UNIDADES	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 7.5x7.5cm PAQUETE POR 5 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), CON 4 PLIEGUES, SIN 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL.
2503344	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 10x10cm PAQUETE POR 5 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 10x10cm PAQUETE POR 5 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME H ACUOSOSMAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPEL MI POLIETILENO)
2584172	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 10x5cm PKx3U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 HILOS). EMPAQUE INDIVIDUAL	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 10x5cm PKx3U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME NO ACUOSO S MAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO BLISTER PEEL PACK
2504248	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ESTERIL TEJIDA PRECORTADA 3X3CM PK X 5U	GASA ESTERIL TEJIDA PRECORTADA3x3cmPKx5U 100% HILOS DE ALGODON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION. ESTERILIZADA CON OXIDO DE ETILENO
2500413	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5X5CM PAQUETE POR 2 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5x5cm PAQUETE POR 2 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME HOM ACUOSOSMAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL.
2500412	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5X5 cm POR 3 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5x5 cm POR 3 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME HOM ACUOSOS MAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPEL MI POLIETILENO)

2500411	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5X5 cm POR 5 UNIDADES.	GASA ABSORBENTE ESTERIL PRECORTADA 5x5cm POR 5 UNIDADES. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME HOM ACUOSOSMAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPEL MI POLIETILENO
2503345	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA 10x10 cm PKx5U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 HILOS). EMPAQUE INDIVID	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA 10x10 cm PKx5U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 hilos), CON 8 PLIEGUES, SIN ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPEL MICROPOROSO QUE PER GRADO
2501283	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.004.008	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA, CON 8 PLIEGUES, 7.5x7.5 cm PKx5U, ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 HILOS).	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA 5x5 cm PKx5U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 hilos), CON 8 PLIEGUES, SIN ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPEL MICROPOROSO QUE PER GRADO
2584029	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.004.008	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA 5x5 cm PKx5U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 HILOS). EMPAQUE INDIVIDUA	GASA ABSORBENTE NO ESTERIL PRECORTADA 5x5 cm PKx5U. ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON, TIPO VII U.S.P. (27 hilos), TEJIDO UNIFORME ACUOSOS MAX 0.16%, ALMIDONES O DEXTRINAS NEGATIVO. USO MEDICINAL. EMPAQUE INDIVIDUAL POR 5 UNIDADES TIPO BLISTER PEEL PACK (PAPELM POLI

2587200	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	SOB	A.02.02.01.004.008	GASA NO TEJIDA CURACION 7.5X7.5cm SOBX5U	GASA NO TEJIDA PARA CURACION 7.5X7.5cm SOBRE X 5 UNIDADES ES EMPLEADA PARA LA OBSORCION DE FLUIDOS DURANTE CURACION ASEPTICA BLANQUEADA DE ACABADO SUAVE, ATOXICA, LIBRE DE IMPUREZA CON PROPIEDADES ABSERVENTES PARA USO MEDICO
2503599	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	GASA TIPO HOSPITALARIA EN ROLLO DE 36"X100 YARDAS TIPO HOSPITALARIO: FABRICADA CON HILOS DE ALGODON 100% PURO. NO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO DE GASA DE 36"x100 YARDAS TIPO HOSPITALARIO: FABRICADA CON HILOS DE ALGODON 100% PURO; TIPOS: VI - VII U.S.P., DE TEJIDO UNIFO DEHERIDAS Y/O SUPERFICIES CORPORALES. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2501170	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	GASA DE TIPO HOSPITALARIO DE 4 CM DE ANCHO X 5 YARDAS- PRESENTACION EN ROLLO	VENDA DE GASA NO ESTERILIZADA EN ROLLO DE 4 CM X 5 YARDAS, 100% HILOS DE ALGODON EXELENTE ABSORCION ENTRE 4 A 6 SEGUNDOS, LIBRE DE PARTICULAS ESTRAÑA, DE COLOR BLANCA, EN ROLLO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2587230	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	BX	A.02.02.01.003.004	HISOPO CON SOL ANTISEPTICA 1.6ml X 50UND	APLICADOR TIPO HISOPO ANTISEPTICO IMPREGNADO CON DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO 70%. INCOLORO. USO UNICO. DESECHABLE.
2587231	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	BX	A.02.02.01.003.004	HISOPO CON SOL ANTISEPTICA 5.2ml X 30 UN	APLICADOR TIPO HISOPO ANTISEPTICO IMPREGNADO CON DE CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO 70%. INCOLORO. USO UNICO. DESECHABLE.
2502616	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A.02.02.01.003.001	KIT DE APLICADORES EN Z	APLICADORES EN MADERA CON ALGODÓN. EMPAQUE INTEGRO NO ESTERIL EN BOLSA DE POLIETILENO-POLIPROPILENO PLASTICA. UNICO USO. DESDECHABLES.
2500666	42140000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	MECHA GINECOLOGICA EN GASA ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	MECHA GINECOLOGICA GASA ESTERIL.ALTAMENTE ABSORBENTE.PRELAVADA PRECORTAD A.100% ALGODON.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. UTILIZADO EN PROCEDIMEINTO ANCHO.MANTENER EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO. MEDIDAS 5X120CM EN 8 PIEGLES
2503760	42140000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	MECHA GINECOLOGICA ESTERIL CON	MECHA GINECOLOGICA GASA ESTERIL.ALTAMENTE ABSORBENTE.PRELAVADA

							CINTA RADIOPACA, EMPAQUE POR UNIDAD	PRECORTAD A.100% ALGODON.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.
2500665	42140000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	MECHA NASAL EN GASA ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	MECHA NASAL EN GASA USO MEDICO HOSPITALARIO ESTERIL. ALTAMENTE ABSORBENTE.PRELAVADA Y PRECORTADA. 100% ALGODON.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. PARA USAR EN CIRUGIA TAPONAMIENTO.MANTENER EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO. MEDIDAS 1.5X5O CM DE 8 PLIEGUES
2503759	42140000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	MECHA NASAL EN GASA ESTERIL+CINTA RADIOPACA, ESTERIL, SOBRE CON 2 UNIDADES	MECHA NASAL EN GASA ESTERIL.ALTAMENTE ABSORBENTE.PRELAVADA Y PRECORTADA. 100% ALGODON.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. PARA USAR EN CIRUG
2502805	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	GLN	A.02.02.01.003.004	TINTURA BENJUI AL 13% GALON	TINTURA DE DENSIDAD 0,870-0900 G/ML, DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHOLICO 69 - 70% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN A 13
2503072	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	TINTURA BENJUI AL 13% X 1000 CC	TINTURA DE DENSIDAD 0,870-0900 G/ML, DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHOLICO 69 - 70% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN A 13%
2504885	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	TINTURA BENJUI AL 13% X 500 ml	TINTURA DE DENSIDAD 0,870-0900 G/ML, DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHOLICO 69 - 70% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN A 13%
2502736	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	FCO	A.02.02.01.003.004	TINTURA BENJUI AL 13%, PH ACIDO, CONTENIDO ALCOHOLICO, FRASCO X 750 CC	TINTURA DE DENSIDAD 0,870-0900 G/ML, DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHOLICO 69 - 70% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN A 13% X 750 CC
2503193	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	TORUNDA GASA ESTERIL, CON CINTA RADIOPACA, PAQUETE POR 2 UNIDADES	TORUNDA DE GASA 100% ALGODON, PLEGADA SOBRE SI MISMA PARA CONSEGUIR UNA BOLA MEDIANTE 2 CAPAS DE GASA ABSORBENTE, DE DIFERENTES DIAM UNIDADES
2504438	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	TORUNDA DE GASA CON CINTA RADIOPACA, ESTERIL,	TORUNDA GASA ESTERIL CINTA RADIOP PK 4UN

							PAQUETE POR 4 UNIDADES	
2503761	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	PK	A-02-02-01-003-005-05	TORUNDA DE GASA CON CINTA RADIOPACA, ESTERIL, PAQUETE POR 5 UNIDADES	TORUNDA DE GASA 100% ALGODON, PLEGADA SOBRE SI MISMA PARA CONSEGUIR UNA BOLA MEDIANTE 2 CAPAS DE GASA ABSORBENTE, DE DIFERENTES DIAMETROS
2502278	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	BOL	A-02-02-01-003-005-05	TORUNDAS ALGODON BOL 500G	ALGODON EN MOTA, TORUNDAS ALGODON BOL 500G, BOLSA X 500 GR. USO: HIGIENE PERSONAL PRIMEROS AUXILIOS ODONTOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA
2501281	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 10 CM X 10 MT	VENDA DE GASA 10 MC X 10 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO, EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2503976	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 2 CM X 5 CM MT	VENDA DE GASA 2 MC X 5 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO, EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2503975	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 3 CM X 5 CM MT	VENDA DE GASA 3 MC X 5 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO, EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2502686	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 4 CM X 5 CM MT	VENDA DE GASA 4 MC X 5 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO, EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2501776	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 5 CM X 5 MT	VENDA DE GASA 5 MC X 5 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO, EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2584121	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE GASA 6 CM X 5 MT	VENDA DE GASA 6 MC X 5 MT EN ROLLO CON ORILLAS, NO ESTERIL FABRICADA CON HILO DE100 % ALGODON. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGENICO

								EXCELENTE ABSORCION. TELA LIVIANA EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2505138	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE TELA ESTERIL 3 X 5 YARDAS	VENDA DE TELA ESTERIL 3X5 YARDAS: TELA LIVIANA, SUAVE Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS PARA CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ABSORCION DE EXUDADOS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOLOGICOS, USO ORTOPEDICO, FIJAR APOSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FERULAS
2505139	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE TELA ESTERIL 4.5 X 5 YARDAS	VENDA DE TELA ESTERIL 4.5X5 YARDAS: TELA LIVIANA, SUAVE Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS PARA CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ABSORCION DE EXUDADOS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOLOGICOS, USO ORTOPEDICO, FIJAR APOSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FERULAS
2505140	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE TELA ESTERIL 5 X 5 YARDAS	VENDA DE TELA ESTERIL 5X5 YARDAS: TELA LIVIANA, SUAVE Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS PARA CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ABSORCION DE EXUDADOS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOLOGICOS, USO ORTOPEDICO, FIJAR APOSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FERULAS
2505141	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE TELA ESTERIL 6 X 5 YARDAS	VENDA DE TELA ESTERIL 6X5 YARDAS: TELA LIVIANA, SUAVE Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS PARA CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ABSORCION DE EXUDADOS, SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOLOGICOS, USO ORTOPEDICO, FIJAR APOSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FERULAS
2500104	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE YESO 3X5 YARDAS	GASA DE ALGODON CON YESO DE FRAGUADO RAPIDO, DE 3X5 YARDAS. ELABORADOEN ALGODON TEJIDO Y SULFATO DE CALCIO, BORDES FIRMES Y ATRAUMATICO INDIVIDUAL, SIN EMPATES, DEBE ESTAR UNIFORMEMENTE RECUBIERTA POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, VENDA CONTINUA SIN EMPATES ENROLLADA EN CORTE REDONDO DE PLASTICO. LA VENDA DE YESO ES INDICADO PARA LA ESTABILIZACION DE FRACTURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS U OTRAS LESIONES. PERMITE LA INMOVILIZACION RIGIDA ASEGURANDO UNA ALTA EFECTIVIDAD CLINICA CON EL MAYOR CONFORT PARA LOS PACIENTES.
2584090	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	GASA DE ALGODON CON YESO DE FRAGUADO RAPIDO, DE 4X5 YARDAS. ELABORADOEN ALGODON TEJIDO Y SULFATO DE CALCIO, BORDES FIRMES Y ATRAUMATICO INDIVIDUAL, SIN EMPATES, DEBE ESTAR UNIFORMEMENTE RECUBIERTA POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, VENDA CONTINUA SIN EMPATES ENROLLADA EN CORTE REDONDO DE PLASTICO.

								LA VENDA DE YESO ES INDICADO PARA LA ESTABILIZACION DE FRACTURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS U OTRAS LESIONES. PERMITE LA INMOVILIZACION RIGIDA ASEGURANDO UNA ALTA EFECTIVIDAD CLINICA CON EL MAYOR CONFORT PARA LOS PACIENTES.
2500106	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	GASA DE ALGODON CON YESO DE FRAGUADO RAPIDO, DE 5X5 YARDAS. ELABORADOEN ALGODON TEJIDO Y SULFATO DE CALCIO, BORDES FIRMES Y ATRAUMATICO INDIVIDUAL, SIN EMPATES, DEBE ESTAR UNIFORMEMENTE RECUBIERTA POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, VENDA CONTINUA SIN EMPATES ENROLLADA EN CORTE REDONDO DE PLASTICO. LA VENDA DE YESO ES INDICADO PARA LA ESTABILIZACION DE FRACTURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS U OTRAS LESIONES. PERMITE LA INMOVILIZACION RIGIDA ASEGURANDO UNA ALTA EFECTIVIDAD CLINICA CON EL MAYOR CONFORT PARA LOS PACIENTES.
2584091	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	GASA DE ALGODON CON YESO DE FRAGUADO RAPIDO, DE 6X5 YARDAS. ELABORADOEN ALGODON TEJIDO Y SULFATO DE CALCIO, BORDES FIRMES Y ATRAUMATICO INDIVIDUAL, SIN EMPATES, DEBE ESTAR UNIFORMEMENTE RECUBIERTA POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, VENDA CONTINUA SIN EMPATES ENROLLADA EN CORTE REDONDO DE PLASTICO. LA VENDA DE YESO ES INDICADO PARA LA ESTABILIZACION DE FRACTURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS U OTRAS LESIONES. PERMITE LA INMOVILIZACION RIGIDA ASEGURANDO UNA ALTA EFECTIVIDAD CLINICA CON EL MAYOR CONFORT PARA LOS PACIENTES.
2503350	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA DE YESO 8X5 YARDAS	GASA DE ALGODON CON YESO DE FRAGUADO RAPIDO, DE 8X5 YARDAS. ELABORADOEN ALGODON TEJIDO Y SULFATO DE CALCIO, BORDES FIRMES Y ATRAUMATICO INDIVIDUAL, SIN EMPATES, DEBE ESTAR UNIFORMEMENTE RECUBIERTA POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, VENDA CONTINUA SIN EMPATES ENROLLADA EN CORTE REDONDO DE PLASTICO. LA VENDA DE YESO ES INDICADO PARA LA ESTABILIZACION DE FRACTURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS U OTRAS LESIONES. PERMITE LA INMOVILIZACION RIGIDA ASEGURANDO UNA ALTA EFECTIVIDAD CLINICA CON EL MAYOR CONFORT PARA LOS PACIENTES.

2505744	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO AUTOADHERENTE 10 cmx 2m	VENDAJE AUTOADHERENTE DE POLIESTER NO TEJIDO DE 10 CM X 2 M, CON FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTISIDAD AL MATERIALES. ES POROSA PARA FACILITAR LA TRANSPIRACION DE LA PIEL, ELASTICO, DISTENSIBLE, RESISTENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD, UNIDA CON CINTA O GANCHO
2503718	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO AUTOADHERENTE 10 cmx4.5m	VENDAJE AUTOADHERENTE DE POLIESTER NO TEJIDO DE 10 CM X 4.5 M, CON FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTISIDAD AL MATERIALES. ES POROSA PARA FACILITAR LA TRANSPIRACION DE LA PIEL, ELASTICO, DISTENSIBLE, RESISTENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD, UNIDA CON CINTA O GANCHO
2503719	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO AUTOADHERENTE 2.5cmx4.5m	VENDAJE AUTOADHERENTE DE POLIESTER NO TEJIDO DE 2.5 CM X 4.5 M, CON FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTISIDAD AL MATERIALES. ES POROSA PARA FACILITAR LA TRANSPIRACION DE LA PIEL, ELASTICO, DISTENSIBLE, RESISTENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD, UNIDA CON CINTA O GANCHO
2503666	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO AUTOADHERENTE 7.5cmx4.5m	VENDAJE AUTOADHERENTE DE POLIESTER NO TEJIDO DE 7.5 CM X 4.5 M, CON FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTISIDAD AL MATERIALES. ES POROSA PARA FACILITAR LA TRANSPIRACION DE LA PIEL, ELASTICO, DISTENSIBLE, RESISTENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD, UNIDA CON CINTA O GANCHO
2505842	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA ELASTICA COHESIVA ROLLO 7.5cm X 2m	VENDA ELASTICA COHESIVA ROLLO 7.5cm X 2m DE APOYO. COMPOSICION: ALGODON, VISCOSA Y POLIAMIDA, LIBRE DE LATEX. VENDA COHESIVA, SE ADHIERE SOBRE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, SOBRE TODO EN PARTES CONICAS PARA FIJACION. USO EN RUPTURAS MUSCULARES, ESGUINCES, INMOVILIZACIONES EN GENERAL, VENAS VARICES, FIJACION DE FERULAS, DRENAJE EN CENTROS DE ESTETICA
2504394	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA ELASTICA COHESIVA DE APOYO 8CMX4M. COMPOSICION: ALGODON,	VENDA ELASTICA COHESIVA DE APOYO 8cmX4m. COMPOSICION: ALGODON, VISCOSA Y POLIAMIDA, LIBRE DE LATEX. VENDA COHESIVA, SE ADHIERE SOBRE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, SOBRE TODO EN PARTES CONICAS PARA FIJACION. MEDIDA ROLLO DE 8cm X 4m

							VISCOSA Y POLIAMIDA. ROLLO	
2500862	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC 4 X 10 YARDAS	VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC 4 X 10 YARDAS, VENDA EXTENSIBLE DE GASA BLANCA IMPREGNADA CON UNA PASTA BLANDA DE OXIDO DE ZINC NO SOLIDIFICABLE PARA USO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES VASCULARES, ULCERAS VARICOSAS Y EDEMAS LINFATICOS.
2504895	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE CUTA FRONTE HERIDAS 0.60MMX7.2CM	TIRA DE AFRONTAMIENTO CUTANEO DE HERIDAS / SUTURA CUTANEA ADHESIVA: DE MATERIAL POROSO RESPIRABLE DE RAYON REFORZADO CON FILAMENTOSD DISPOSITIVO DE CIERRE DE LA PIEL EN EL TRATAMIENTO DE LACERACIONES E INCISIONES QUIRURGICAS DE BAJA TENSION, CIERRE PRIMARIO DE HERI SOBRE
2504021	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	TIRA DE AFRONTAMIENTO CUTANEO DE HERIDAS / SUTURA CUTANEA ADHESIVA DIMENSIONES: 12MM X10CM	TIRA DE AFRONTAMIENTO CUTANEO DE HERIDAS / SUTURA CUTANEA ADHESIVA DIMENSIONES: 12 MM X 10 CM EN ADHESIVO ACRILICO, DE MATERIAL POROSO RESPIRABLE DE RAYON REFORZADO CON FILAMENTOS, DISPOSITIVO DE CIERRE DE LA PIEL EN EL TRATAMIENTO DE LACERACIONES E INCISIONES QUIRURGICAS DE BAJA TENSION, CIERRE PRIMARIO DE HERIDAS
2503105	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	TIRA DE AFRONTAMIENTO CUTANEO DE HERIDAS / SUTURA CUTANEA ADHESIVA DIMENSIONES: 6.3MM X 3.8CM	TIRA DE AFRONTAMIENTO CUTANEO DE HERIDAS / SUTURA CUTANEA ADHESIVA DIMENSIONES: 6.3MM X 3.8CM EN ADHESIVO ACRILICO, DE MATERIAL POROSO RESPIRABLE DE RAYON REFORZADO CON FILAMENTOS, DISPOSITIVO DE CIERRE DE LA PIEL EN EL TRATAMIENTO DE LACERACIONES E INCISIONES QUIRURGICAS DE BAJA TENSION, CIERRE PRIMARIO DE HERIDAS
2501714	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 3X5 YARDAS	VENDAJE DE ALGODON LAMINADO 3X5 YARDAS. TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS, SUAVE AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, USADO PARA CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FERULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL
2501715	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 4X5 YARDAS, UNIDAD	VENDAJE DE ALGODON LAMINADO 4X5 YARDAS. TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS, SUAVE AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, USADO PARA CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FERULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL

2501716	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 5X5 YARDAS	VENDAJE DE ALGODON LAMINADO 5X5 YARDAS. TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS, SUAVE AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, USADO PARA CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FERULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL
2501717	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	RO	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 6X5 YARDAS	VENDAJE DE ALGODON LAMINADO 6X5 YARDAS. TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS, SUAVE AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, USADO PARA CUBRIR LA PIEL ANTES DE COLOCAR UNA FERULA DE YESO O ENYESAR LA PARTE COMPROMETIDA. PARA VENDAJES EN GENERAL
2504198	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE ALTA COMPRENSION 10CM X 3MT ELASTICO	VENDAJE DE ALTA COMPRENSION ELASTICA DE 10 CM X 3MTS COMPUESTA POR UN VENDAJE ELASTICO DE ALGODON, VISCOSA QUE PROPORCIONA PRESION SOSTENIDA, CON LINEA CENTRAL AMARILLA Y DOS INDICADORES RECTANGULARES DE EXTENSION PARA EXTREMIDADES DE DIFERENTE TAMAÑO.
2502797	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE DE EMERGENCIA	VENDAJE ELASTICO PARA HERIDAS TRAUMATICAS Y HEMORRAGIAS CON ALMOHADILLA Y APOSITO DE ALGODON DE HILO DE ALGODON DE POLIESTER LARGO 4.5 MTS X 15 CM DE ANCHO. ELONGACION 100-200%. ALGODON DE GRADO MEDICO NO TEJ 15X18 CMS. ABSORCION 9 GRS DE AGUA X 1 GR DE APOSITO. MUELLE DE COMPRESION: POLICARBONATO EN FORMA DE HERRADURA CON APERTURA DE 40°EN POLICARBONATO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2503351	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO 2 X 5 YARDAS.	VENDA ELASTICA DE 2X5 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL, EN CAUCHO EN FILAMENTOS (25%) Y POLIESTER CRUDO SIN COMPACTAR (75%), TENSIL Y COMPRESION GRADUAL, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO.
2500100	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO 3 X 5 YARDAS.	VENDA ELASTICA DE 3X5 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL, EN CAUCHO EN FILAMENTOS (25%) Y POLIESTER CRUDO SIN COMPACTAR (75%), TENSIL Y COMPRESION GRADUAL, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO.
2500101	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO 4 X 5 YARDAS.	VENDA ELASTICA DE 4X5 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL, EN CAUCHO EN FILAMENTOS (25%) Y POLIESTER CRUDO SIN COMPACTAR (75%), TENSIL Y COMPRESION GRADUAL, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO.

2500102	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO 5 X 5 YARDAS	VENDA ELASTICA DE 5X5 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL, EN CAUCHO EN FILAMENTOS (25%) Y POLIESTER CRUDO SIN COMPACTAR (75%), TENSIL Y COMPRESION GRADUAL, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO.
2500103	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO 6 X 5 YARDAS	VENDA ELASTICA DE 6X5 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL, EN CAUCHO EN FILAMENTOS (25%) Y POLIESTER CRUDO SIN COMPACTAR (75%), TENSIL Y COMPRESION GRADUAL, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO.
2503897	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE ELASTICO AUTOADHERENTE 15cmx4.5m	VENDAJE AUTOADHERENTE DE POLIESTER NO TEJIDO DE 15 CM X 4.5 M, CON FIBRAS ELASTICAS DE POLIURETANO DISTRIBUIDAS LONGITUDINALMENTE PARA OTORGAR ELASTISIDAD AL MATERIALES. ES POROSA PARA FACILITAR LA TRANSPIRACION DE LA PIEL, ELASTICO, DISTENSIBLE, RESISTENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD, UNIDA CON CINTA O GANCHO
2503941	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE OCLUSIVO NEUMOTORAX ABIERTO 6x6	VENDAJE OCLUSIVO NEUMOTORAX ABIERTO 6x6", CON GEL ADHESIVO Y SELLO TRANSPARENTE, PARA COLOCAR DIRECTAMENTE SOBRE LA HERIDA Y TOMARL INDIVIDUAL.
2584766	42311500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-5	C/U	A-02-02-01-003-005-05	VENDAJE TRIANGULAR	CUADRADO DE TELA ALGODON PLEGADO Y TELA LIENSO, CORTADO EN FORMA DE TRIANGULO. PARA TRAUMA, 90x90x120cms. SE PUEDE UTILIZAR COMO COJINETE PARA CONTROLAR LA HEMORRAGIA. COLOR VERDE.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2504613	42294907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CEPILLO PARA TOMA DE CITOLOGIA BILIAR DOBLE LUMEN	CEPILLO CITOLOGIA BILIAR DOBLE LUMEN. SE USA PARA RECOLECTAR CELULAS DEL SISTEMA BILIAR. CEPILLO BILIAR DE LA CITOLOGIA DEL LUMEN DO
2502704	42143100	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA METRICA OBSTETRICA	CINTA METRICA OBSTETRICA EN TELA PLASTICA DE ALTA CALIDAD. NO ESTIRA- NO SE DESHILACHA- NO SE BORRA FACILMENTEY ES SUAVE AL CONTACTO CON LA PIEL- ACRILICO100% CINTA METRICA DE 50 CM CON DIVISIONES DE MEDIO CM. CONTIENE LA TECNICA DE MEDIDA DE LA ALTURA UTERINA- LOS VALORES NORMALES DE ALTURA UTERINA AL TERMINO Y LOS

								PATRONES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA NORMAL DURANTE LA GESTACION.
2502236	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CITOCEPILLO CON ESPATULA PARA CITOLOGIA	CITOCEPILLO ENDOCERVICAL- ESPATULA TIPO AYRE- PARA TOMA DE CITOLOGIA- EMPAQUE INDIVIDUAL.
2502692	93141612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)-EN POLIETILENO REBOBINADO DE COBRE EN LAS ASAS Y EN EL TALLO	DISPOSITIVO INTRAUTERINO ESTERIL. ATOXICO. EN FORMA DE T. ELABORADO EN PLASTICO FLEXIBLE ENVUELTO EN COBRE. CON HILOS AL EXTERMO. USO UNICO. ESTERIL.
2502702	93141612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ELEMENTOS CURSO PSICOPROFILACTICO	ELEMENTOS CURSO PSICOPROFILACTICO-LINTERNA. PELOTAS GRANDES PARA PILATES-PELOTAS DE CAUCHO MEDIANAS. COLCHONETA EN ESPUMA. ALMOHADAS.
2501628	42143100	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULOS VAGINALES DESECHABLES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE- PARA PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS Y TOMA DE EXAMENES DE CITOLOGIA. SISTEMA ARTICULADO DE UNA SOLA PIEZA GARANTIZA LA FACIL MANIPULACION POR PARTE DEL PROFESIONAL-SEIS GRADUACIONES DE ABERTURA PERMITEN GRADUAR EL INSTRUMENTO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD REQUERIDA- AREA POSTERIOR DE OBSERVACION Y TRABAJO DE FORMA OVAL MAS AMPLIA PARA MEJORES PROCEDIMIENTOS. VALVAS O ESPATULAS AMPLIAS EN CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES- SIN BORDES- NI FILOS QUE PUEDAN TRAUMATIZAR LA PACIENTE- ANGULOS MUERTOS EN LOS CODIGOTOS DE CIERRE DEL ESPECULO PARA GARANTIZAR TRAUMATISMO NULO EN LA USUARIA. PEQUEÑO TALLA "S". MEDIANO TALLA "M". GRANDE TALLA "L"
2504896	42143100	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE EN POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA MECANICA TALLA S
2501166	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT PARA CITOLOGIA CON ESPECULO - DIFERENTES TALLAS	KIT PARA CITOLOGIA. COMPUESTO POR ESPECILO EN MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL COLOR NATURAL. ESPATULA TIPO AYRE EN POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA. CITOCEPILLO EN NYLON MONOFILAMENTO. LAMINA 75 X 25 MM VIDRIO TRANSPARENTE NO CORROSIVO CON BORDES PRECORTADOS Y

								PORTALAMINA LIBRE DE PATOGENOS. ETIQUETA INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2503803	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT PARA CITOLOGIA CON ESPECULO TALLA L	KIT PARA CITOLOGIA TALLA L. UNIDAD EMPAQUE INDIVIDUAL- TRANSPARENTE. CLAMP O MECANISMO DE TORNILLO PARA GRADUAR LA APERTURA Y FIJACION DEL CUELLO DEL UTERO. INCLUYE CITOCEPILLO ENDOCERVICAL- ESPATULA TIPO AYRE- ESTUCHE LAMINA PORTA OBJETO- LAMINA PORTA OBJETO DE VIDRIO.
2503804	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT PARA CITOLOGIA CON ESPECULO TALLA M	KIT PARA CITOLOGIA TALLA M. UNIDAD EMPAQUE INDIVIDUAL- TRANSPARENTE. CLAMP O MECANISMO DE TORNILLO PARA GRADUAR LA APERTURA Y FIJACION DEL CUELLO DEL UTERO. INCLUYE CITOCEPILLO ENDOCERVICAL- ESPATULA TIPO AYRE- ESTUCHE LAMINA PORTA OBJETO- LAMINA PORTA OBJETO DE VIDRIO.
2503805	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT PARA CITOLOGIA CON ESPECULO TALLA S	KIT PARA CITOLOGIA TALLA S. UNIDAD EMPAQUE INDIVIDUAL- TRANSPARENTE. CLAMP O MECANISMO DE TORNILLO PARA GRADUAR LA APERTURA Y FIJACION DEL CUELLO DEL UTERO. INCLUYE CITOCEPILLO ENDOCERVICAL- ESPATULA TIPO AYRE- ESTUCHE LAMINA PORTA OBJETO- LAMINA PORTA OBJETO DE VIDRIO.
2500898	41116111	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT PARA CITOLOGIA SIN ESPECULO	KIT- CITOCEPILLO RECOLECTOR DE MUESTRA ENDOCERVICAL DE CERDAS SUAVES NO MAYOR DE 3 MM DISTRIBUIDOS EN TODA LA CODIGO RECOLECTORA- ESPATULA TIPO AYRE- POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBLE. DEM HISTERECTOMIA- DE MATERIAL PLASTICO. LAMINA PORTA OBJETOS CON 1/3 DE LA SUPERFICIE ESMERILADA PARA MARCACION EMPAQUE. ESTUCHE PORTA LAMINAS- HECHO EN POLIPROPILENO PARA PROTEGER LA MUESTRA. CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO - LIMPIO- SECO Y SOBRE ESTIBAS
2501781	60105907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE VALORACION PRENATAL	COMPUESTO POR CINTA OBSTETRICA- GESTOGRAMA DE BOLSILLO- GESTOGRAMA MURAL- ESTETOSCOPIO FETAL ILUSTRADO- CONTROL CLINICO DE LA CONTRACTILIDAD UTERINA Y DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DURANTE EMBARAZO Y PARTO- PARTOGRAMA CON CURVAS DE ALERTA- PLANTILLAS CON CURVAS DE ALERTA DE LA DILATACION CERVICAL- DILATOMETRO- TARJETA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- TARJETA DE CONTROL PRENATAL Y VIGILANCIA DE CRECIMIENTO FETAL

2501290	60105907	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE VALORACION PARA CONTROL PRENATAL Y CURSO PSICOPROFILACTICO	CONTENIDO KIT VALORACION CONTROL PRENATAL Y CURSO PSICOPORFILACTICO-TERMOMETRO DIGITAL- CINTRA METRICA PARA OBSTETRICIA EN ESTUCHE-T LAMINA DURA PLASTICA DE LETRAS- PALETA OCULAR- LINTERNA PEQUEÑA CON PILAS AAA
2501289	42000000	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT VALORACION SALUD INFANTIL	CONTENIDO KIT VALORACION INFANTIL- TABLA DE SNELL DE FIGURAS O DIBUJOS- CUBOS EN ESPUMA FORRADOS EN TELA DE DIFERENTES COLORES DE 15 (PAQUETE X20 UNIDADES)-PELOTA DE CAUCHO (GRANDE- MEDIANA Y PEQUEÑA)- ZAPATO GRANDE DIDACTICO PARA AMARRAR- ABACO DIDACTICO EN MADER DIFERENTES
2501313	93141612	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-6	C/U	A.02.02.01.003.006	PRESERVATIVO /CONDON-ELABORADOEN LATEX NATURAL-EMPAQUE INDIVIDUAL	PRESERVATIVO.ELABORADO EN LATEX NATURAL.APRUEBA DE FUGA DE LIQUIDOS.MOLDEABLE Y RESISTENTE EN EL USO CON EL TRANSDUCTOR TRANSVAGINA LUBRICADO Anchura nominal 53 mm

GRUPO ELEMENTOS Y BARRERAS DE PROTECCION

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501955	42295013	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	BLOQUEADOR DE MORDIDA. FABRICADO CON MATERIAL LIBRE DE LATEX	BLOQUEADOR DE MORDIDA FABRICADO CON MATERIAL LIBRE DE LATEX - CON BORDE DE RETENCION DENTAL ((REDONDEADO) Y ARNES (CORREA SUAVE EN CAUCHO NATUAL-QUE SE AJUSTA PARA PARA INMOVILIZARLO)-USO-PROTEGER LABIOS-DIENTES-ENCIAS
2502937	42261602	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA EMBALAJE DE CADAVERES	BOLSA DESCARTABLE PARA EMBALAJE DE CADAVERES EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BOLSILLO PEQUEÑO EN VINILO PARA IDENTIFICACION DEL FALLECIDO. RESISTENCIA HASTA 120 KG- CON CREMALLERA CENTRAL Y CUATRO CORRESAS LATERALES PARA TRASPORTE
2504049	42295013	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	BOQUILLA DESCARTABLE ENDOSCOPIA ADULTO EN PP Y/O ABS. ESTERIL.	BOQUILLA DESCARTABLE ENDOSCOPICA PARA ENDOSCOPIA EN POLIPROPILENO (PP) Y/O ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS). POLIETILENO. LIBRE DE LATEX. USO UNICO. CON PUERTO DE ENTRADA QUE PERMITE ADMINISTRAR OXIGENO. ADAPTABLE A

							EMPAQUE INDIVIDUAL	DIFERENTES TAMAÑOS ENDOSCOPICOS. BLOQUE DE MORDIDA INDIVIDUAL. CORREA AJUSTABLE
2503512	46181800	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CARETA VISOR PARA PROFESIONAL SALUD- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SALPICADURAS DE FLUIDOS A LA CARA. UNIDAD	CARETA VISOR PARA PROFESIONAL SALUD CON VISOR EN POLICARBONATO FLEXIBLE. SOPORTE LEVANTABLE LAMINA EN POLICANBONATO CLARO Y RIBETE METALICO
2504113	42281532	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CAJA RECOLECTORA SISTEMA STERRAD	CAJA RECOLECTORA SISTEMA STERRAD QUE ALMACENA 3 CASSETTES DESPUES DE SU USO-100 NX UNIDAD
2502348	42281532	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CASSETTE PEROXIDO HIDROGENO 30/5 CICLOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION	CASETTE CON NUMERO DE 5 CICLOS POR CASETTE PARA ESTERILIZACION DE 30 LITROS DE VOLUMEN. ANAQUEL DE DOS HILERAS. TEMPERATURA DEL CICLO INFERIOR A 55*C (131*F). TIEMPO DEL CICLO. ENVASE CON INDICADOR QUIMICO E IDENTIFICACION DE CODIGO DE BARRAS
2502347	42281532	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CASSETTE PEROXIDO HIDROGENO 50/5 CICLOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION	CASSETTE 50 CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON NUMERO DE 5 CICLOS POR CASSETTE. CON ENVASE E INDICADOR QUIMICO. CON IDENTIFICACION DE CODIGO DE BARRAS. COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION.
2504371	42281532	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CASSETTE PEROXIDO HIDROGENO 59% 15 CICLOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONCENTRACION 59 %	CASSETTE PEROXIDO HIDROGENO 59% 15 CICLOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONCENTRACION: 59%. ESTADO FISICO: LIQUIDO. EFICACIA: AMPLIO E. APLICACIONES: DESCONTAMINACIO DE SALAS, EQUIPOS, CAMARAS DE PASO, CABINAS DE SEGURIDAD BI REUTILIZABLES
2503027	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CAUCHO LATEX TORNIQUETE Ø5MM	CAUCHO LATEX TORNIQUETE Ø5MM- CON O SIN CIERRES A LOS EXTREMOS

2584099	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR, DE 16-18mm x 50 metros. ROLLO	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE 16-18mm x 50-55 mtros INDICADOR DE COLOR BLANCO CON LINEAS DIAGONALES QUE VI PROCESADOSDE LOS PROCESADOS. CARACTERISTICAS: CAMBIO DE COLOR DE BLANCO A CAFE NEGRO. TIEMPO COMPLETO VAPOR 121 = 10 MIN, 132-134 = DIMENSIONE
2504052	41104112	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA - BANDA ELASTICA PARA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA. BANDA ELASTCA LBRE DE LATEX	CINTA - BANDA ELASTCA LIBRE DE LATEX Y FTALATOS. ELABORADA EN POLIESTER CON CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO
2584132	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO POR 3 METROS	CINTA INDICADORA CON ADHESIVO. UN RESPALDO Y TIRAS DE UN INDICADOR QUIMICO. PROCESO DE USO EXTERNO. PARA MONITOREAR LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION
2504537	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA DE IMPRESION PARA ESTERILIZADORES, DIAMETRO (Ø) 5MM. MATERIAL NILON. COLOR NEGRO. EN FORMA DE CARTUCHO SELLADO EN PLASTICO	CINTA DE IMPRESION PARA ESTERILIZADORES PEQUEÑOS (STERIS) EQUIPADOS CON IMPRESORA DE IMPACTO. DIAMETRO (Ø) 5mm. MATERIAL NYLON. COLO P150828440
2503270	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA IMPRESORA AUTOCLAVE 70MM X 40M, COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION	CINTA PARA IMPRESORA PARA AUTOCLAVE.PAPEL EN ROLLO COLOR BLANCO DE 70MM X 40 METROS COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCION.

2503417	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA TESTIGO-INDICADOR QUIMICO EXTERNO - CLASE 1 - PROCESOS DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO	CINTA TESTIGO-INDICADOR QUIMICO EXTERNO - CLASE 1 - EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. CAMBIA DE COLOR DUR ROLLO
2584092	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA ESTERILIZACION A VAPOR LIBRE DE PLOMO (Pb). DE 12mm x 55metros. ROLLO	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA ESTERILIZACION A VAPOR. LIBRE DE PLOMO (Pb). DE 12mm x 55metros. USO EXTERNO. PARA MONITOREAR LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION
2502343	42281802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA INDICADORA QUIMICA ESTERILIZACION A VAPOR DE 12-15mm x 50 METROS. ROLLO	CINTA INDICADORA QUIMICA PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE 12-15mm x 50 mtros. ENVASE Y ENVOLTURA CON PAPEL CREPADO TIPO LATEXADO. USO EXTERNO. PARA MONITOREAR LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION
2502237	42291805	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CLAMP UMBILICAL EN POLIPROPILENO GRADO MEDICO	CLAMP UMBILICAL- ELABORADO EN POLIPROPILENO GRADO MEDICO- CON DOBLE BROCHE DE SEGURIDAD- ESTERIL. ATOXICO EMPAQUE INDIVIDUAL. CON ETIQUETA DE INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO- FECHA VENCIMIENTO Y LOTE
2584131	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	CONTROL BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA OXIDO DE ETILENO	TUBO CON GAS DE OXIDO ETILENO. INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA OXIDO DE ETILENO. PLASTICO. UN SOLO USO. ESTERIL. DESECHABLE (COLOR VERDE OXIDO DE ETILENO)
2584098	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	CONTROL BIOLOGICO AUTOCLAVE DE VAPOR, DE UN SOLO USO, FACIL LECTURA	TUBO INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR. CON ESPORAS COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACION TEMPERATURAS DE VACIO. UN SOLO USO. ESTERIL. DESECHABLE. (COLOR MARRON VAPOR).

2501231	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	CONTROL BIOLOGICO PARA VAPOR FLASH, PRESENTACION EN CAPSULA	TUBO INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR. CON ESPORAS COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACION TEMPERATURAS DE VACIO. UN SOLO USO. ESTERIL. DESECHABLE
2501232	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	AMP	A.02.02.01.003.004	CONTROL BIOLOGICO PEROXIDO DE HIDROGENO	TUBO INDICADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO. CON ESPORAS COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACION TEMPERATURAS DE VACIO. UN SOLO USO. ESTERIL. DESECHABLE.
2503261	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	CONTROL QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMOERATURA	LA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO, ES UN PROCESO DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS. PRESENTA VARIEDAD DE MATERIALES COMO EL ACERO INOXIDABLE, PLASTICO, SILICONAS, ENTRE OTROS. CICLOS RAPIDOS, SIN RESIDUOS TOXICOS, PROCESO REPR VALIDABLE
2587070	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO PARA RETRACCION FLEXIBLE DE INCISIONES Y PROTECCION DE HERIDAS-EXTRA-GRANDE. DISEÑADO EN UNA SOLA PIEZA. ESTERIL	DISPOSITIVO DESECHABLE CON DOS AROS UNO DE RETRACCION RIGIDA O UNO DE RETRACCION FLEXIBLE- UNIDOS ENTRE SI POR UNA LAMINA DE LATEX TRANSPARENTE- EXTRA-GRANDE. UNA SOLA PIEZA
2587069	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO PARA RETRACCION FLEXIBLE DE INCISIONES Y PROTECCION DE HERIDAS-GRANDE. DISEÑADO EN UNA SOLA PIEZA. ESTERIL	DISPOSITIVO DESECHABLE CON DOS AROS UNO DE RETRACCION RIGIDA O UNO DE RETRACCION FLEXIBLE- UNIDOS ENTRE SI POR UNA LAMINA DE LATEX TRANSPARENTE- GRANDE. UNA SOLA PIEZA

2587068	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO PARA RETRACCION FLEXIBLE DE INCISIONES Y PROTECCION DE HERIDAS-MEDIANO. DISEÑADO EN UNA SOLA PIEZA. ESTERIL	DISPOSITIVO DESECHABLE CON DOS AROS UNO DE RETRACCION RIGIDA O UNO DE RETRACCION FLEXIBLE- UNIDOS ENTRE SI POR UNA LAMINA DE LATEX TRANSPARENTE- MEDIANO. UNA SOLA PIEZA
2587067	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPOSITIVO PARA RETRACCION FLEXIBLE DE INCISIONES Y PROTECCION DE HERIDAS-PEQUEÑO. DISEÑADO EN UNA SOLA PIEZA. ESTERIL	DISPOSITIVO DESECHABLE CON DOS AROS UNO DE RETRACCION RIGIDA O UNO DE RETRACCION FLEXIBLE- UNIDOS ENTRE SI POR UNA LAMINA DE LATEX TRANSPARENTE- PEQUEÑO. UNA SOLA PIEZA
2584196	42203430	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO A TIERRA PARA PROCEDIMIENTOS EN NEUROFISIOLOGIA	ELECTRODO A TIERRA EN FORMA CONCAVA. DE MATERIAL FLEXIBLE CON LENGUETA DE LIBERACION CON CABLE CONDUCTOR DELGADO Y FLEXIBLE.
2500670	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO ADULTO-HIPOALERGENICO-PREGELIZADO. DESCARTABLE	ELECTRODO DESECHABLE. REUTILIZABLES. FABRICADO EN TELA MICROPOROSA Y/O PELICULA DE POLIPROPILENO. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE.
2500335	42203430	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO DE DISPERSION COMO ACCESORIO PARA ELECTROFISIOLOGIA	ELECTRODO DE DISPERSION COMO ACCESORIO PARA ELECTROFISIOIOGIA. EN GEL PARA MEJOR CONTACTO CON LA PIEL Y ADAPTACION AL CUERPO. CON SEGURO O ANILLO DE SEGURIDAD PARA SIMETRIA DE CORRIENTE OPTIMA Y SOPORTE IDEAL COMPATIBLES CON EQUIPO DISPONIBLE
2584139	39121436	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA EN FORMA DE J	ELECTRODO MONOPOLAR CODIGO EN FORMA DE J. DESECHABLE. ESTERIL. COMPATIBLE CON EL EQUIPO DISPONIBLE

2503294	42182015	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°4- DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO.	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA ESTANDAR-DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO RIGIDA Y UN MATERIAL SUAVE Y BLANDO EN EL EXTEREMO DURADEROS Y DESECHABLES PARA VARIOS MODELOS DE OTOSCOPIOS- INCLUIDOS LOS RI-MINI Y RI-SCOPE DE RIESTER. DIFERENTES TAMAÑOS (2-5 MM Y 4 MM)
2504938	42182015	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N° 2.75 mm	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°2.75mmBASE DE PLASTICO RIGIDA Y UN MATERIAL SUAVE Y BLANDO EN EL EXTEREMO- EL CUAL ENCJ INSTITUCION.DESCARTABLE
2503292	42182015	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°3- DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO.	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°3. DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO RIGIDA Y BLANDO EN EL EXTREMO. DESECHABLE. LIBRE DE LATEX. DESCARTABLE
2503293	42182015	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°4- DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO.	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°4. DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO RIGIDA Y BLANDO EN EL EXTREMO. DESECHABLE. LIBRE DE LATEX. DESCARTABLE
2504937	42182015	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°3- DISEÑADO CON UNA BASE DE PLASTICO. REF-76710/76767 MARCA WELLCH ALLYN)	ESPECULO - CONO DE OTOSCOPIA N°4.25mm BASE DE PLASTICO RIGIDA Y UN MATERIAL SUAVE Y BLANDO EN EL EXTEREMO- EL CUAL ENCJ INSTITUCION. DESCARTABLE
2505710	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS EN FORMA DE ALMOHADILLA PARA USO EN DESFIBRILADO RES-ELECTROCARDIOGRAMA-ADULTO	ELECTRODOS EN FORMA DE ALMOHADILLA ADHESIVA CON CABLE CONECTOR-EXCELENTE CONDUCCION ELECTRICA-BUENA ADHESION A LA PIEL PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA DESCARGA ELECTRICA-DESECHABLE-PARA USO EN DESFIBRILADORES Y ELECTROCARDIOGRAMA
2505711	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS EN FORMA DE ALMOHADILLA PARA USO EN DESFIBRILADO RES-	ELECTRODOS EN FORMA DE ALMOHADILLA ADHESIVA CON CABLE CONECTOR-EXCELENTE CONDUCCION ELECTRICA-BUENA ADHESION A LA PIEL PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA DESCARGA ELECTRICA-DESECHABLE-PARA USO EN DESFIBRILADORES Y ELECTROCARDIOGRAMA

							ELECTROCARDIOGRAMA-PEDIATRICO	
2504933	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS CARBONADOS 8 X 12 cm	ELECTRODOS CARBONADOS 8 X 12 cm DE CAUCHO DE GOMA SILICONADO
2505457	42141814	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS CARBONADOS 15 MM	ELECTRODOS ADHESIVOS DE CARBONO. REUTILIZABLES. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE
2504292	42141814	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS CARBONADOS CON MEDIDAS DE 5 X 9CM. ELECTRODOS ADHESIVOS DE CARBONO- CON SUPERFICIE ADHERIBLE- REUTILIZABLES - PAQ 4 UNIDAD	ELECTRODOS ADHESIVOS DE CARBONO. REUTILIZABLES. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE
2505456	42141814	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS CARBONADOS 8 MM	ELECTRODOS ADHESIVOS DE CARBONO. REUTILIZABLES. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE
2502498	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS DE COPA PARA ELECTROMIOGRAFIA	ELECTRODOS REUSABLES EN COPA DE SUSTRATO DE COBRE CON REVESTIMIENTO DORADO. TAPAS PLASTICAS. RESISTENTES A LA CORROSION. CON CONECTOR A PRUEBA DE CONTACTO. CABLE DE TPU DE GRADO MEDICO CON NUCLEO DE ALAMBRE DE KEVLAR. COMPATIBLES CON EQUIPO DISPONIBLE.
2584102	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS REUSABLES COPA ORO EEG EN SET	ELECTRODOS DE ALTO RENDIMIENTO-REUSABLES COPA DE ORO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA-DE BAJA IMPEDANCIA DE SEÑAL-SUPERFICIE RESISTENTE A LA CORROSION-CABLE DE TPU GRADO MEDICO CON HILO DE TRACCION-CONECTOR DE SEGURIDAD-PARA ESTUDIOS DE SUEÑO
2500671	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO PEDIATRICO-HIPOALERGENICO-PREGELIZADO. DESCARTABLE	ELECTRODO DESECHABLE. REUTILIZABLES. FABRICADO EN TELA MICROPOROSA Y/O PELICULA DE POLIPROPILENO. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE.
2500337	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO MONITORIA Y PRUEBA	ELECTRODO DESECHABLE CON RESPALDO DE ESPUMA. ADHESIVO. HIPOALERGENICO. USO UNICO. CONEXION DE BROCHE ESTANDAR. LIBRE

							ESFUERZO ADULTO	DE LATEX. CON CARACTERISTICAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO DISPONIBLE.
2500338	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO PARA MONITORIA Y PRUEBA ESFUERZO PEDIATRICO	ELECTRODO DESECHABLE CON RESPALDO DE ESPUMA. ADHESIVO. HIPOALERGENICO. USO UNICO. CONEXION DE BROCHE ESTANDAR. LIBRE DE LATEX. CON CARACTERISTICAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO DISPONIBLE.
2505712	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO PARCHE DESECHABLE ADULTO	ELECTRODO DESECHABLE TIPO PARCHE. REUTILIZABLES. FABRICADO EN TELA MICROPOROSA Y/O PELICULA DE POLIPROPILENO. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE.
2505847	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	RO	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO PARCHE DESECHABLE PEDIATRICO	ELECTRODO DESECHABLE TIPO PARCHE. REUTILIZABLES. FABRICADO EN TELA MICROPOROSA Y/O PELICULA DE POLIPROPILENO. HIPOALERGENICO. DESCARTABLE.
2584184	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO REUSABLE COPA DE ORO PARA ELECTROENCEFALOGRAMA. ELELECTRODO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ESTUDIOS DE SUEÑO	ELECTRODOS REUSABLES EN COPA DE SUSTRATO DE COBRE CON REVESTIMIENTO DORADO. TAPAS PLASTICAS. RESISTENTES A LA CORROSION. CON CONECTOR A PRUEBA DE CONTACTO. CABLE DE TPU DE GRADO MEDICO CON NUCLEO DE ALAMBRE DE KEVLAR.
2504236	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODOS REUSABLES COPA DE ORO PARA EEG/EMG/EOG--72 CON CUBIERTA DE CAUCHO FACIL CONEXION AL AMPLIFICADOR	ELECTRODOS REUSABLES EN COPA DE SUSTRATO DE COBRE CON REVESTIMIENTO DORADO. TAPAS PLASTICAS. RESISTENTES A LA CORROSION. CON CONECTOR A PRUEBA DE CONTACTO. CABLE DE TPU DE GRADO MEDICO CON NUCLEO DE ALAMBRE DE KEVLAR. COMPATIBLES CON EQUIPO DISPONIBLE.
2504616	42294528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	EXPANSOR DE PUPILA UNIFORME ESTERIL EN POLIURETANO Y ACERO INOXIDABLE	EL EXPANSOR DE PUPILA ES UNA HERRAMIENTA INSERTADORA QUE CONSTA DE UNA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL MANGO-BOTON DE LA HERRAMIENTA INSERTADORA-BASE Y CUBIERTA DEL NIDO INSERTADOR-TUBO E IMPULSADOR DE LA HERRAMIETA- ESTA DISEÑADO PARA EXPANDIR DE FORMA SEGURA EL IRIS Y AUMENTAR EL CAMPO DE VISION DEL CIRUJANO-AYUDA A MEJOR ENGANCHADO O QUITADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2504300	42192501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	FUNDA PROTECTORA DE CAMARA DE VIDEO PARA LAPAROSCOPICA ESTERIL DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL	FUNDA PROTECTORA WEN POLIPROPILENO TRANSPARENTE. ESTERIL. DESECHABLE. CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL
2501223	46181802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GAFAS PROTECTORAS DE BIOSEGURIDAD -EN POLICARBONATO- UNIDAD	MONOGAFA PANORAMICOS DE POLICARBONATO. FILTRO UV. ANTIEMPAÑANTES. CON CINTA AJUSTABLE A LA CABEZA.
2502227	42182308	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL/PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA	GEL ALTAMENTE CONDUCTOR LIBRE CLORURO Y ACETONA-DE CONSISTENCIA PLASTICA QUE REDUCE EL RIESGO DE EFECTO PUENTE ENTRE LOS ELECTRODOS-SOLUBLE EN AGUA-ANTIALERGENICA-ATOXICA-SU INDICACION ES ESPECIFICA PARA REGISTROS DE ELECTROENCEFALOGRAMA YA QUE GARANTIZA UNA BAJA IMPEDANCIA Y BUENA ESTABILIDAD DE SEÑAL
2502696	42182308	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ABRASIVO PARA ECG Y EEG. PREPARACION DE LA PIEL PREVIA A ESTOS EXAMENES. TUBOx4 ONZAS	GEL ABRASIVO CON EXFOLIANTES. PARA DISMINUIR LAS IMPEDANCIAS DE LA PIEL.
2584157	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ABRASIVO PARA ECG- EEG + OTROS. PREPARACION DE LA PIEL PREVIA A ESTOS EXAMENES. TUBO x 114g	GEL ABRASIVO CON EXFOLIANTES. PARA DISMINUIR LAS IMPEDANCIAS DE LA PIEL.
2504235	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	TUB	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR EEG-PE-PSG TUBO 4 ONZAS	GEL CONDUCTOR LIBRE DE PARABENOS. INCOLORO. HIPOALERGENICO. HIDROSOLUBLE

2502166	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE VISCOSIDAD MEDIA	GEL CONDUCTOR LIBRE DE PARABENOS. INCOLORO. HIPOALERGENICO. HIDROSOLUBLE
2503935	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE VISCOSIDAD ALTA-ELECTROCONDUCTIVA FCO POR 250ML	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE VISCOSIDAD ALTA- ELECTROCONDUCTIVA- EVITA INTERFERENCIAS-HIDROSOLUBLE-HIPOALERGENICO CON FORM EXCELENTES CUALIDADES LUBRICANTES Y DESLIZANTES. SE DEBE EXTENDER UNIFORMEMENTE SIN SECARSE. AGENTE CONDUCTOR PARA USO DE TERAPIA
2584174	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR DE PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICO FRASCO 250ml	GEL CONDUCTOR 250ML. LIBRE DE PARABENOS. INCOLORO ALTA CONDUCTIVIDAD Y TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS Y ELECTROMEDICAS NO PERMITE INTERFERENCIAS HIDROSOLUBLE. NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE. OPTIMA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. PROTEGE TRANSDUCTORES Y EQUIPOS
2502424	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	GLN	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GALON X 3800ML	GEL CONDUCTOR EN GALON DE 3800 ML ULTRASONIDO CONDUCTOR CON AGUA DESIONIZADA- PARA UTILIZAR EN PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN ULTRASONIDO E IMAGENES DIAGNOSTICAS.
2504503	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	GAR	A.02.02.01.003.004	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GAR X 3000ml	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GARRAFA 3000 ML. GEL DE DIAGNOSTICO Y TERAPIA CON ULTRASONIDO Y ELECTRO ESTIMULADORES-LUBRICANTE TRNASPAR DE ULTRASONIDO SOBRE 90% EN TODA LA GAMA DE FRECUENCIAS MEDICAS- PARA USO HOSPITALARIO Y MEDICO-HIPOALERGENICO Y BACTERI OSTATICO.
2501104	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL SOLIDIFICANTE-POLVO ENVASADO EN FRASCO PLASTICO X 1000 CC	PRODUCTO GRANULADO 1000 CC. SOLIDIFICADOR E INACTIVADOR DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES- PRODUCTO GRANULADO QUE CONTIENE POLIMERO ABSORBENTE Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 10% PARA UNA EFECTIVA SOLIDIFICACION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE RIESGOSOS CON EFECTO DESINFECTANTE.
2501108	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL SOLIDIFICANATE- POLVO ENVASADO EN FRASCO	PRODUCTO GRANULADO 1500 CC. SOLIDIFICADOR E INACTIVADOR DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES- PRODUCTO GRANULADO QUE CONTIENE POLIMERO ABSORBENTE Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 10% PARA UNA EFECTIVA

							PLASTICO X 1500 CC	SOLIDIFICACION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE RIESGOSOS CON EFECTO DESINFECTANTE.
2501109	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL SOLIDIFICANATE- POLVO ENVASADO EN FRASCO PLASTICO X 3000 CC	PRODUCTO GRANULADO 3000 CC. SOLIDIFICADOR E INACTIVADOR DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES- PRODUCTO GRANULADO QUE CONTIENE POLIMERO ABSORBENTE Y PEROXIDO DE HIDROGENO AL 10% PARA UNA EFECTIVA SOLIDIFICACION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE RIESGOSOS CON EFECTO DESINFECTANTE.
2502735	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	GLN	A.02.02.01.003.004	GEL SOLIDIFICANTE-INACTIVANTE GRANULADO PARA SOLUCION	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS CON DESINFECTANTE-PRODUCTO GRANULADO QUE CONTIENE UN POLIMERO ABSORBENTE QUE ENCAPSULA-ABSORBE Y SOLIDIFICA TODO TIPO DE LIQUIDOS FACILITANDO SU DISPOSICION FINAL MAS UN INGREDIENTE BASADO EN PEROXIDOS INORGANICOS
2584156	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL/CREMA CONDUCTOR EEG+OTROS TUBO 228G-PARA PROCEDIMIENTOS DE NEURODIAGNOSTICO	GEL/CREMA CONDUCTOR PARA PROCEDIMIENTOS DE NEUROMONITOREO JUNTO CON ELECTRODOS DE NEURODIAGNOSTICO SIN GEL (EEG- POTENCIALES EVOCADO FACIL DE LIMPIAR- HIPOALERGENICO. COMPONENTES-ETER CETILICO POLIOXILTILENO- AGUA-GLICERINA- CARBONATO CALCICO- CLORURO DE POTASIO+ HIPOALERGENICO
2587222	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE DE NITRILO ESTERIL TALLA 6.5 PAR	GUANTES TALLA N° 7.0 COMPUESTOS DE 100% NITRILO - LIBRE DE LATEX - CAUCHO NATURAL-LUBRICANTE Y POLVO- SUPERFICIE EXTERNA LISA - DEDOS RECTOS TEXTURIZADOS- BORDE ENROLLADO PARA RESISTENCIA Y FACIL POSTURA - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL
2587057	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE DE NITRILO ESTERIL TALLA 7.0 ESTERIL-PAR. AMBIDIESTRO DE FACIL CALZADO	GUANTES TALLA N° 7.0 COMPUESTOS DE 100% NITRILO - LIBRE DE LATEX - CAUCHO NATURAL-LUBRICANTE Y POLVO- SUPERFICIE EXTERNA LISA - DEDOS RECTOS TEXTURIZADOS- BORDE ENROLLADO PARA RESISTENCIA Y FACIL POSTURA - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL
2587058	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE DE NITRILO ESTERIL TALLA 7.5 ESTERIL-PAR. AMBIDIESTRO DE FACIL CALZADO	GUANTES TALLA N° 7.5 COMPUESTOS DE 100% NITRILO - LIBRE DE LATEX - CAUCHO NATURAL-LUBRICANTE Y POLVO- SUPERFICIE EXTERNA LISA - DEDOS RECTOS TEXTURIZADOS- BORDE ENROLLADO PARA RESISTENCIA Y FACIL POSTURA - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL

2587059	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE DE NITRILO ESTERIL TALLA 8.0 ESTERIL-PAR. AMBIDIESTRO DE FACIL CALZADO	GUANTES TALLA N° 8.0 COMPUESTOS DE 100% NITRILO - LIBRE DE LATEX - CAUCHO NATURAL- LUBRICANTE Y POLVO- SUPERFICIE EXTERNA LISA - DEDOS RECTOS TEXTURIZADOS- BORDE ENROLLADO PARA RESISTENCIA Y FACIL POSTURA - EMPAQUE INDIVIDUAL - ESTERIL
2500449	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 6.0- DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE- HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL- FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500450	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 6.5- DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE- HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL- FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500451	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 7- DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE- HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL- FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500452	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 7.5- DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX

								NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE-HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL-FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500453	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 8-DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE-HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL-FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500454	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.5/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 8.5- DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE. ENTALCADO. HIPOALERGENICO. ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR- SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE-HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL-FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE INDIVIDUAL DE FACIL APERTURA.
2500455	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 9.0/PAR	GUANTE ESTERILES DE LATEX NATURAL TALLA 9-DISEÑO ANATOMICO.MAXIMA SENSIBILIDAD Y COMODIDAD- PUÑO RIBETEADO- SUPERFICIE MICRORRUGOSA.RESISTENTE AL DESGARRE-HIPOALERGENICO-ANATOMICO CON REDUCCION DE FATIGA DE PULGAR-SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA- EN CAUCHO DE LATEX NATURAL- ENTALCAMIENTO LEVE-HIPOALERGENICO- 100% LATEX NATURAL-FUERTES- FLEXIBLES Y CONFORTABLES-EMPAQUE INDIVIDUAL -DE FACIL APERTURA
2505700	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNAS TALLA XS	GUANTE NITRILO LIBRE DNaSE/RNaS-SIN POLVO-LIBRE DE TODA CONTAMINACION Y LATEX-AMBIDIESTRO-ESTERIL-DE FACIL CALZADO-BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE-DIFERENTES COLORES-BIOCOMPATIBLE-DESCARTABLE-TALLA XS-ANCHO 80 +o-5 mm- LARGO 240mm- N

2505659	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/RNAS TALLA 6-5	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACI ON- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA 6.5-ANCHO 100 +o-5 mm- LARGO 240mm GUANTES.
2503189	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNaSE/RNaSE TALLA 7.0 ESTERIL- PAR.	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACION- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA M- ANCHO 100 +o-5 mm- LARGO 240mm- N
2503150	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE Y RNASE TALLA 7.5 ESTERIL. PAR	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACI ON- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA M- ANCHO 100 +o-5 mm- LARGO 240mm GUANTES.
2505658	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNaSE/RNaSE ESTERIL 8.0	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACI ON- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA 8.0-ANCHO 100 +o-5 mm- LARGO 240mm GUANTES.
2584095	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE Y RNASE- LIBRE DE LATEX Y POLVO. TALLA L	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACION- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA L- ANCHO 110 +o-5 mm- LARGO 240mm- N
2502485	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE Y RNASE- LATEX Y POLVO. AMBIDIESTRO. DESCARTABLE. TALLA M	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX-AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO-PARTE I PERFORACION- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA M- ANCHO 100 +o-5 mm- LARGO 240mm- N

2502673	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE Y RNASE- LATEX Y POLVO. AMBIDIESTRO. DESCARTABLE. TALLA S	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX- AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO- PARTE I PERFORACI ON- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA S- ANCHO 80 +o-5 mm- LARGO 240mm- N
2505657	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NITRILO LIBRE DNaSE/RNa SIN ESTERILIZAR TALLAXL	GUANTE DE NITRILO- SIN POLVO- LIBRE DE TODA CONTAMINACION (DNaSE Y RNaSE) Y LATEX- AMBIDIESTRO.NO ESTERIL. DE FACIL CALZADO- PARTE I PERFORACI ON- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE. DIFERENTES COLORES. BIOCOMPATIBLE. DESCARTABLE. TALLA XL-
2500459	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA L. AMBIDIESTRO. RESISTENTE A RUPTURA O DESGARRE. HIPOALERGENICO. ANATOMICO. CON DEDOS RECTOS O REDONDO. ENTALCADO- PREENTALCADOS CON ALMIDON- DESECHABLES- ALTA RESISTENCIA DE ENLONGACION CAJA X 100 UNIDADES
2500458	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M. AMBIDIESTRO. RESISTENTE A RUPTURA O DESGARRE. HIPOALERGENICO. ANATOMICO. CON DEDOS RECTOS O REDONDO. ENTALCADO- PREENTALCADOS CON ALMIDON- DESECHABLES- ALTA RESISTENCIA DE ENLONGACION CAJA X 100 UNIDADES
2500457	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S. AMBIDIESTRO. RESISTENTE A RUPTURA O DESGARRE. HIPOALERGENICO. ANATOMICO. CON DEDOS RECTOS O REDONDO. ENTALCADO- PREENTALCADOS CON ALMIDON- DESECHABLES- ALTA RESISTENCIA DE ENLONGACION CAJA X 100 UNIDADES
2505702	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA XL	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA XL. AMBIDIESTRO. RESISTENTE A RUPTURA O DESGARRE. HIPOALERGENICO. ANATOMICO. CON DEDOS RECTOS O REDONDO. ENTALCADO- PREENTALCADOS CON ALMIDON- DESECHABLES- ALTA RESISTENCIA DE ENLONGACION CAJA X 100 UNIDADES
2500456	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA XS	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA XS. AMBIDIESTRO. RESISTENTE A RUPTURA O DESGARRE. HIPOALERGENICO. ANATOMICO. CON DEDOS RECTOS O REDONDO. ENTALCADO- PREENTALCADOS CON ALMIDON- DESECHABLES-

								ALTA RESISTENCIA DE ENLONGACION CAJA X 100 UNIDADES
2503183	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO- LIBRE DE POLVO- NO ESTERIL- TALLA L	GUANTE DE USO GENERAL TAMAÑO L. MATERIAL EN CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD. UTILIZADO PARA AISLAR Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA. AMBIDIESTRO. PUÑO CON REBORDE- REFORZADO ASEGURANDO FACIL COLOCACION Y EVITANDO QUE SE ENROLLE. ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. LIBRE DE CIERTOS ADITIVOS- DISMINUYE EL RIESGO DE ALERGIAS. NO ESTERILES. NO CONTIENE PROTEINAS DE LATEX. PRODUCTO DESECHABLE (UN SOLO USO).
2503184	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO- LIBRE DE POLVO- NO ESTERIL- TALLA M	GUANTE DE USO GENERAL TAMAÑO M MATERIAL EN CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD. UTILIZADO PARA AISLAR Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA. AMBIDIESTRO. PUÑO CON REBORDE- REFORZADO ASEGURANDO FACIL COLOCACION Y EVITANDO QUE SE ENROLLE. ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. LIBRE DE CIERTOS ADITIVOS- DISMINUYE EL RIESGO DE ALERGIAS. NO ESTERILES. NO CONTIENE PROTEINAS DE LATEX. PRODUCTO DESECHABLE (UN SOLO USO).
2503185	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO- LIBRE DE POLVO- NO ESTERIL- TALLA S	GUANTE DE USO GENERAL TAMAÑO S. MATERIAL EN CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD. UTILIZADO PARA AISLAR Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA. AMBIDIESTRO. PUÑO CON REBORDE- REFORZADO ASEGURANDO FACIL COLOCACION Y EVITANDO QUE SE ENROLLE. ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. LIBRE DE CIERTOS ADITIVOS- DISMINUYE EL RIESGO DE ALERGIAS. NO ESTERILES. NO CONTIENE PROTEINAS DE LATEX. PRODUCTO DESECHABLE (UN SOLO USO).
2503182	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO- LIBRE DE POLVO- NO ESTERIL- TALLA XL	GUANTE DE USO GENERAL TAMAÑO XL. MATERIAL EN CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD. UTILIZADO PARA AISLAR Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA. AMBIDIESTRO. PUÑO CON REBORDE- REFORZADO ASEGURANDO FACIL COLOCACION Y EVITANDO QUE SE ENROLLE. ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. LIBRE DE CIERTOS ADITIVOS- DISMINUYE EL RIESGO DE ALERGIAS. NO ESTERILES. NO CONTIENE PROTEINAS DE LATEX. PRODUCTO DESECHABLE (UN SOLO USO).
2505446	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO SIN POLVO TA/XS	GUANTE DE VINILO/ PVC (POLICLORURO DE VINILO) SINTETICO TALLA /XS- AMBIDIESTRO- LIBRE DE POLVO - RESISTENTE RUPTURA O DESGARRE- ANATOMICO- PUÑO REFORZADO- NO ESTERIL.

2505465	42132200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	GUANTE NO ESTERIL VINILO- LIBRE DE POLVO- NO ESTERIL- TALLA M	GUANTE DE USO GENERAL TAMAÑO M MATERIAL EN CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD. UTILIZADO PARA AISLAR Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA. AMBIDIESTRO. PUÑO CON REBORDE- REFORZADO ASEGURANDO FACIL COLOCACION Y EVITANDO QUE SE ENROLLE. ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. LIBRE DE CIERTOS ADITIVOS- DISMINUYE EL RIESGO DE ALERGIAS. NO ESTERILES. NO CONTIENE PROTEINAS DE LATEX. PRODUCTO DESECHABLE (UN SOLO USO).
2502344	46181538	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	PAA	A.02.02.01.003.006	GUANTE RESISTENTE CALOR ESTERILIZACION	GUANTES DE TELA Y ALGODON- SUAVE- FLEXIBLE. RESISTENTES AL CALOR
2504129	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR BIOLOGICO ESTERILIZACI H2O2	INDICADOR BIOLOGICO COMPATIBLE A SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. UN SOLO USO. CONTENEDO DE ESPORAS BACTERIANAS. AMPOLLA DE VIDRIO CON MEDIO DE CULTIVO. TUBO EN POLIPROPILENO.
2501793	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.008	INDICADOR BIOLOGICO LECT RAPI TIPO ATTES PRESENTACION EN la CAJA POR 50 UNIDADES	INDICADOR BIOLOGICO LECTURA RAPIDA TIPO ATTES. UN SOLO USO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. TUBO EN POLIPROPILENO. TIRA CON ESPORAS BACTERIANAS. AMPOLLA CON CULTIVO.
2503199	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR BIOLOGICO/INTEGRADOR PRUEBA 16 POR 4 CONTROLES	DISEÑADO PARA MONITOREAR PROCESOS DE ESTERILIZACION POR VAPOR. INCLUYE PAQUETES DE PRUEBA 14 + 4 CONTROLES, LECTURA DE 3 HORAS, GORR CONTROLES
2504242	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO (STERRAD)	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO (STERRAD)
2503191	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO, TIRA PLASTICA	TIRA PLASTICA EN POLIESTIRENO DE COLOR BLANCO CON INDICADOR QUIMICO VISUAL. CON TINTA ROJA. UN SOLO USO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX. TIRA PLASTICA DE POLIESTIRENO DE COLOR BLANCO

							DE POLIESTIRENO	
2584084	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR QUIMICO A VAPOR(INTEGRADOR)/4 PRESENTACION EN TIRAS	INDICADOR QUIMICO A VAPOR(INTEGRADOR). DE UN SOLO USO.FACIL INTERPRETACI ON O LECTURA.LECTURA POR DESPLAZAMIENTO.PLASTIFICADO. CLASE4 LUEGO DE EFECTUAR UN CICLO DE ESTERILIZACION. CUMPLIR CON LA NORMA ISO: 11140 clase IV
2501078	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR QUIMICO A VAPOR(INTEGRADOR), CLASE 5 (CINCO)	TIRAS DE PAPEL BILAMINADO CON INDICADOR QUIMICO A VAPOR (INTEGRADO). UN SOLO USO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX.
2500544	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INDICADOR QUIMICO INTERNO/INTEGRADOR. PRESENTACION BOLSA	UN INDICADOR QUIMICO PARA DOBLE PROCESOS DE ESTERILIZACION POR VAPOR. TIRAS REACTIVAS DE PAPEL CON DOS SELLOS REACTIVOS. UN SOLO USO. ESTERIL. LIBRE DE LATEX.
2584085	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO ETILENO/IV	INTEGRADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO CLASE V MULTIPARAMETROS. DISEÑADO PARA MONITOREAR TODOS LOS PARAMETROS EN EL PROCESO DE EST ALCANZADAS
2502679	42281804	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO ETILENO CLASE V	INTEGRADOR QUIMICO CON OXIDO DE ETILENO CLASE V MULTIPARAMETRO DISEÑADO PARA MONITOREAR TODOS LOS PARAMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACION
2505412	42143603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.002.007	INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA DEL ADULTO-PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA DEL ADULTO-PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES EN LONA Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE DE BAJO PESO- ALTA DURABILIDAD-SEGURO Y CONFIABLE- DANDO ESTABILIDAD A LOS MIEMBROS DEL CUERPO.
2505413	42143603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.002.007	INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA PEDIATRICO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA PEDIATRICO-PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES EN LONA Y CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE. DE BAJO PESO- ALTA DURABILIDAD-SEGURO Y CONFIABLE- DANDO ESTABILIDAD A LOS MIEMBROS DEL CUERPO

2502938	42143603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	INMOVILIZADOR EXTREMIDA PLATINA/ALUMINIO RADIOLUCIDO-LIVIANO-RESISTENTE AL AGUA-REUSABLE	INMOVILIZADOR EXTREMIDAD EN PLATINA DE ALUMINIO DELGADO- FLEXIBLE- CON ESPUMA RADIOLUCIDO- LIVIANO- RESISTENTE AL AGUA- ALTAMENTE RESISTENTE Y MALEABLE
2584166	42311702	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE CORDON UMBILICAL - CLAMP PARA LIGADURA DE CORDON UMBILICAL	KIT DE CORDON UMBILICAL BOLSA RECOLECTORA LIQUIDOS CORDON UMBILICAL. ENVASE PARA TEJIDOS CORDON UMBILICAL. TUBOS/VIALES RECOLECTORES SANGRE MADRE.
2584177	42143603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT INMOVILIZACION EXTREMIDADES DESECHABLE-EN CARTON	KIT DESECHABLE. EN ESPUMA PVC MOLDEABLE. CON CORREAS DE AJUSTE CON CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y BROCHES PLASTICOS. INMOVILIZADOR DE PIERNA. INMOVILIZADOR DE BRAZO. INMOVILIZADOR DE ANTEBRAZO. INMOVILIZADOR DE CUELLO. INMOVILIZADOR DE MUNECA.
2501777	85161503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	GLN	A.02.02.01.003.004	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL - PARA LUBRICACION Y CONSERVACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO. GALON	ACEITE MINERAL CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA- QUE SEA PERMEABLE A ESTERILIZACION A VAPOR- EMULSIONES NO IONICAS Y AGUA. LUBRICANTE M QUIRURGICO X 1GLN
2505507	85161503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	LUBRICANTE INSTRUMENTAL NATURAL 350 ML - 80 % ACEITE NATURAL DE CASTOR Y 20 % D, DELIMONENO SOLVENTE CITRICO NATURAL DE NARANJA	LUBRICANTE INSTRUMENTAL NATURAL 350 ML CITRILUB ES UN LUBRICANTE E INHIBIDOR DE CORROSION DE ORIGEN NATURAL, ESPECIALMENTE DISEÑADOPARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO HOSPITALARIO, VETERINARIO, ASI COMO LA LUBRICACION DE PIEZAS DE MANO Y MICROMOTORES ODONTOLOGICOS. COMPONENTES: CITRILUB ESTA COMPUESTO POR 80 % ACEITE NATURAL DE CASTOR Y 20 % D, DELIMONENO SOLVENTE CITRICO NATURAL DE NARANJA. PRESENTACION: CITRILUB: PISTOLA CON GATILLO ASPERSOR DE 350 ML.

2500542	85161503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	GLN	A.02.02.01.003.004	LUBRICANTE NEUTRO LAVADORA AUTOMATICA	LUBRICANTE NEUTRO PARA LAVADORA AUTOMATICA.LUBRICANTE BACTERIOSTATICO DE ACEITE MINERAL NO CORROSIVO.SIN SILICONA NO PEGAJOSO.EFECT-NEUTRO.
2584143	42142106	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	MANTA DESCARTABLE CON 12 PAQUETES DE AUTOCALENTA MIENTO. EMPAQUE INDIVIDUAL	MANTA TERMICA DISEÑADA COMO PRIMERA RESPUESTA AL SHOCK Y LA HIPOTERMIA. LA MANTA CONTIENE UN NUCLEO DE ESPUMA LIGERO. SE CALIENTA INDIVIDUAL ASEGURA LA DISTRIBUCION UNIFORME DE LA TEMPERATURA
2500656	42142106	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	MANTA TERMICA DESECHABLE 2.10X1.30m EN POLIESTER ALUMINIZADO-PARA EMERGENCIA Y RESCATE	MANTA TERMICA DE TIPO DESECHABLE-PARA EMERGENCIA Y RESCATE- FABRICADA EN POLIESTER ALUMINIZADO.DIMENSIONES DE 210 X 130CM. MANTA ISO SOBRECALENTAMIENTO CUANDO SE COLOCA COLOR ORO SOBRE EL PACIENTE. MANTENER EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
2501277	42142106	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	MANTA TERMICA DESECHABLE 2.10X1.30m EN POLIESTER ALUMINIZADO-PARA EMERGENCIA Y RESCATE	MANTA TERMICA DE TIPO DESECHABLE-PARA EMERGENCIA Y RESCATE- FABRICADA EN POLIESTER ALUMINIZADO.DIMENSIONES DE 210 X 160 CM. MANTA IS SOBRECALENTAMIENTO CUANDO SE COLOCA COLOR ORO SOBRE EL PACIENTE
2503375	42142106	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	MANTA TERMICA DESECHABLE 2.10X1.60M EN ALUMINIO-PARA EMERGENCIA Y RESCATE	MANTA TERMICA DE TIPO DESECHABLE-PARA EMERGENCIA Y RESCATE- FABRICADA EN POLIESTER ALUMINIZADO.DIMENSIONES DE 210 X 160CM. MANTA ISO SOBRECALENTAMIENTO CUANDO SE COLOCA COLOR ORO SOBRE EL PACIENTE
2501136	46181802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	MONOGAFAS DE PVC- CON LENTES DE POLICARBONATO-PROTECTORAS TRANSPARENTES	MONOGAJAS SUAVES DE PVC- MUY LIVIANO CON LENTES DE POLICARBONATO QUE PROVEEN RESISTENCIA AL IMPACTO. BANDA ELASTICA PARA FIJACION-GARANTIZA LA CLARIDAD Y TRASPARENCIA- PROPORCIONA PROTECCION ADICIONAL PARA LOS OJOS A TRAVES DE PROTECTORES LATERALES LAVAR CON JABON NEUTRO POTECTOR UV

2503297	42143513	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	BX	A.02.02.01.003.006	OLIVAS PARA TIMPANOMETRIA CON IMPEDANSIOMETRO AT235/AT235H Y MT10. CAJA CON 65 PIEZAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. BET50-CAJA SURTIDA	OLIVAS PARA TIMPANOMETRIA CON IMPEDANSIOMETRO AT235/AT235H Y MT10. CAJA CON 65 PIEZAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. BET50-CAJA SURTIDA
2584087	42281501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	OXIDO DE ETILENO AL 100% PURO GAS/100 gr	CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO AL 100% PURO GAS DE 100 gr ALTA PUREZA, 100 % DE OXIDO DE ETILENO. SIRVEN PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTERILIZADORES YA SEAN MANUALES O AUTOMATICOS, EXISTENTES EN EL MERCADO. ACCION BACTERICIDA, VIRICIDA Y FUNGICIDA.HERMETICOS, INVIOLABLES Y DESCARTABLES. PERMITEN DENTRO DEL ESTERILIZADOR, CONTROLAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PARAMETROS. (CONCENTRACIÓN, TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD).
2584130	42281501	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	OXIDO DE ETILENO AMPOLLA CON GAS ESTERILIZANTE	AMPOLLAS DE OXIDO DE ETILENO AL 100% DE 100GMS 3,52 OZ. DISENADO Y COMPATIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC, SISTEMA DE ESTERILIZACION TEMPERATURA
2584141	42172101	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PALETA DESECHABLE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO-PHILIPS MODELO 3861A	PALETA DESECHABLE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO- PHILIPS MODELO 3861A PARA USO DE DESFIBRILACION EXTERNA O FUNSION DE MARCAPASOS TRANSCUTANEO
2502705	42183046	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PALETA OCULAR	UN OCLUSOR OCULAR EN FORMA DE PALETA ES UN INSTRUMENTO QUE SE UTILIZA EN OFTALMOLOGIA PARA CUBRIR LOS OJOS Y REALIZAR EXAMENES DE AGUDEZA VISUAL-ELABORADA EN PLASTICO OPACO Y UN MANGO LARGO

2504186	42281500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A-02-02-01-003-002	PAPEL DE IMPRESION STERRAD 100NX CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION STERRAD S1000 REF 41602.3- PRESENTACION EN ROLLO	ROLLO DE PAPEL DE IMPRESION STERRAD 100NX CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION STERRAD S1000 REF 41602.3 UNIDAD
2503223	41103022	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PAQUETE FRIO TRANSPOR VACUNAS 300-500ML. RECIPIENTE PLASTICO O PILA DE DISEÑO ESPECIAL PARA CONSERVAR RANGO TERMICO	PAQUETE FRIO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS- SON RECIPIENTES PLASTICOS DE DISEÑO ESPECIAL PARA CONSERVAR EN RANGO TERMICO A LAS VACUNAS. CONTENIDO PUEDE SER UN LUIQUIDO INCOLORO- ES HABITUAL QUE SE LE CONFUNDA CON AGUA- PUEDEN DIFERENCIARSE POR ESTAR SELLADOS-
2504511	42203506	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	PARCHE ELECTRODOS DESFIBRIL ADUL PADZII	PARCHE ELECTRODOS DESFIBRILADOR ZOLL STAT-PADZ II 8900-0802-01 LOS ELECTRODOS ZOLL STAT-PADZ II DE 2 PIEZAS ESTAN ESPECIALMENTE DISE GARANTIZAN UNA VIDA UTIL DE AL MENOS 18 MESES O MAS. NOTA- A DIFERENCIA DE ZOLL CPR-D PADZ- LOS ELECTRODOS ZOLL STAT-PADZ II
2502807	42311511	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	PARCHE TERAPIA OCULAR ADULTO COLOR PIEL	SOPORTE DE TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOROSA COLOR PIEL- QUE PERMITE QUE LA PIEL RESPIRE NORMALMENTE- AJUSTANDOSE AL CONTORNO- DE LATEX
2502808	42311511	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	PARCHE TERAPIA OCULAR PEDIATR COLOR PIEL	SOPORTE DE TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOROSA COLOR PIEL- QUE PERMITE QUE LA PIEL RESPIRE NORMALMENTE- AJUSTANDOSE AL CONTORNO- DE LATEX
2584154	42311511	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.004.001	PARCHES CARDIO/DESFIB RILACION ADULTO COMPATIBLES CON DESFIBRILADO R PHILLIPS FR2	PARCHES CARDIOVENSION Y DESFIBRILACION A PACIENTES TORAX Y ABDOMEN CON CONECTOR PARA DEA MARCA PHILLIPS MODELO HEART START PALETAS D PARTE

2582508	42142703	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PINZA DE CUNNINGHAM UNIDAD	DISPOSITIVO DE CONTROL- EFICAZ PARA AYUDAR A LA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA SUAVEMENTE CERRADO REUTILIZABLE Y FACIL DE LAVAR- SE COMPONE DE UNA ESTRUCTURA METALICA CON UN SISTEMA DE POLEAS Y CONTRAPESOS QUE PERMITEN GRADUAR LA INTENSIDAD DE LA TRACCION APLICADA
2505557	24141500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTECTOR ACRILICO PARA ENTUBADO CAL 4MM	DISPOSITIVO PARA PROTEGER A LOS MEDICOS DURANTE LA INTUBACION DE LOS PACIENTES INFECTADOS POR COVI19. ELABORADA EN ACRILICO. MEDIDAS 50 ALTO 40 PRUFUNDO 50 FRENTE. CALIBRE 4MM.
2501803	24141500	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTECTOR FACIAL PARA RCP	PROTECTOR FACIAL PARA RCP HECHO DE LAMINA DE PLASTICO PVC TRASPARENTE IMPERMEABLE CON VALVULA UNIDIRECCIONAL PERMITE EL PASO DE AIRE Y NO LA DEVOLUCION DE FLUIDOS
2503714	42183046	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTECTOR OCULAR PLASTICO	PROTECTOR OCULAR DE POLIMERO GRADO MEDICO ANATOMICO CON BORDES SUEVES- LISIS-LIVIANOS CON ORIFICIOS DE VENTILACION
2504383	42294400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS VASCULAR PERIFERICA EN POLIETRAFLUO RETILENO (PTFE) 4.7MM X 45CM. INJERTO VASCULAR- COMPUESTO DE PTFE Y CARBON IMPREGANDO. C	PROTESIS VASCULAR PERIFERICA EN POLIETRAFLUORETILENO (PTFE) 4.7mm X 45cm. INJERTO VASCULAR- COMPUESTO DE PTFE Y CARBON IMPREGANDO. C RECONSTRUCCIONDE VASOS SANGUINEOS ARTERIALES PERIFERICOS Y COMO CONDUCTOS ARTERIOVENOSOS SUBCUTANEOS PARA EL ACCESO SANGUINEO.
2504219	42294400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS VASCULAR EN DACRON RECTA CALIBRE 26 MM X 25 CM	PROTESIS VASCULAR EN DACRON RECTA CALIBRE 26 MM X 25 CM
2584094	42281528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA BOWIE DICK PARA AUTOCLAVE VAPOR-HOJA IMPRESA CON INDICADOR QUIMICO	HOJA DE PRUEBA BOWIE DICK 21.1 x 29.7, IMPRESAS CON UN INDICADOR QUIMICO EN LINEAS DIAGONALES, EL CUAL CAMBIA DE COLOR AMARILLO CLA ESTERILIZADORES DE PREVACIO. DEBE SER CONFIABLE (ESTANDARES AAMI). FACIL DE LEER, INTERPRETAR Y REGISTRAR. PARA SER UTILIZADOS EN ALGODON

2503140	42281528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK PARA ESTERILIZACION A VAPOR. FACIL DE LEER E INTERPRETAR	PRUEBA BOWIE DICK DISEÑADA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOCLAVES DE ALTO VACIO (VAPOR). INDICA LA EFICIENCIA DE ELIMINACION (ESTANDARES AAMI)-FACIL DE LEER, INTERPRETAR Y REGISTRAR. INCLUYE HOJA DE PRUEBA DE ADVERTENCIA TEMPRANA, PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK
2584129	42281528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	PAQUETE DE PRUEBA PARA ESTERILIZACION A VAPOR, PRESENTACION 16 PAQUETES+4CONTROLES BIOLOGICOS	PAQUETE DE PRUEBA CERTIFICADO BAJO EL ESTANDAR DE USO, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACION DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL RAPIDA
2502740	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	POLVO SOL GELIFICANTE INACTIVAN X 100 MG	GELIDIFICANTE GRANULADO CON PEORIXIDO DE HIDROGENO AL 10% DESINFECTA, ENCAPSULA, ABSORBE Y SOLIDIFICA FLUIDOS CORPORALES POTENCIALM MAS
2502250	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	POLVO SOLUCION GELIFICANTE INACTIVAN FRASCO X 1000GRS Y/O SOLIDIFICADOR LIQUIDOS BIOLOGICOS	POLVO SOLUCION GELIFICANTE INACTIVANTE FCO CAPACIDAD DE GELIFICAR 1500CC O MAS."SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS BIOLOGICOS". FRASCO POR 1000gr
2502997	46181800	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	REPUESTO TRANSPARENTE PARA CARETA VISOR EN LAMINA DE ACETATO ANTIEMPAÑANTE	CARETA TRANSPARENTE EN LAMINA DE ACETATO ANTI EMPAÑANTE- ANTI-ARAÑAZO-TERMOMOLDEADA- INTERCAMBIABLE- PERMITA INCLINACION DE 90 GRADOS
2502226	46181802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	RESPIRADOR BLANCO N-95	FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO-BRINDA UNA EFECTIVA-CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA LA GRAN MAYORIA DE POLVOS Y PARTICULAS SIN PRESENCIA DE ACEITE-FORMA PLEGABLE-CON CINTAS ELASTICAS- CLIP METALICO-ELEMENTO FILTRANTE EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIESTER.

2505509	42181715	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLIDIFICANTE GRANULADO CON UN 10% DE PEROXIDO DE HIDROGENO FCO 200G	SOLIDIFICANTE GRANULADO CON 10% DE PEROXIDO DE HIDROGENO Y POLIMERO ABSORBENTE. DESINFECTANTE. BLANQUEADOR. INACTIVADOR DE LIQUIDOS CORPORALES CON PELIGRO BIOLOGICO
2501364	42281903	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPETE ADHESIVO MATERIAL POLIETILENO- PARA CAPTURAR PARTICULAS POR TRAFICO COLOR AZUL 115X45CM X 5UN	TAPETE ADHESIVO A BASE DE SOLVENTE ORGANICO- MATERIAL POLIETILENO- PARA CAPTURAR PARTICULAS POR TRAFICO COLOR AZUL 115X45CM RESISTENTE AL CALOR HASTA 70°C FACIL DE USAR- CUANDO LA CAPA SUPERFICIAL ESTA CONTAMINADA- SIMPLEMENTE DESPEGUELA Y DESECHELA- QUEDARA LISTA LA SIGUIENTE CAPA
2505638	46181901	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPONES AUDITIVOS	TAPON AUDITIVO DE SILICONA. DE SUPERFICIE LISA RESISTENTES AL ACEITE Y AL AGUA. ANTIALERGENICO. FACIL MANIPULACION. PRODUCTO DESECHABLE
2587180	42294526	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TAPON LAGRIMAL	TAPONES SINTETICOS- SILICONADOS O COLAGENO TUBULARES- DIMINUTOS Y BIOCOMPATIBLES- TALLA UNICA- ESTERIL EN SILICONA Y EN COLAGENO
2503542	41103022	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS CAPACIDAD 9 LIT	TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS EN MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD-RESISTENTE AL ALTO IMPACTO-LISO-SOLIDO-LAVABLE-INERTE-NO CORROSIVO Y NO REACTIVO-EXTERNO-CON TAPA SOLIDA TIPO COFRE DE SELLADO HERMETICO-BISAGRAS Y SISTEMA PORTACANDADOS-INTERNO-CON CURVAS SANITARIAS-COLORES CLAROS-AISLAMIENTO DE POLIURETANO SEGUN NORMAS NINTERNACIONALES-EN COLOR CLARO Y LAVABLE-CON ROSCA DE USO Y CONTRATAPA
2502701	42182201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TERMOMETRO DIGITAL UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL INCORPORAN INTEGRADOS QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE PERCIBIR LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA DE MANERA LINEAL PANTALLA EN LCD-REUTILIZABLE
2505721	42182201	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TERMOMETRO INFRAROJO	TERMOMETRO DIGITAL LCD PARA LA FRENTE-PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL EN ADULTOS Y NIÑOS. METODO DE MEDICION SIN CONTACTO. UBICACION PARA MEDICION EN LA FRENTE. DISTANCIA DE MEDICION < 2.5CM RANGO DE MEDICION EN CUERPO 35 A 44 °C. RANGO DE MEDICION EN

								SUPERFICIE 0 A 99 °C ERROR DE MEDICION 35 A 42 °C (±0.2°C); 42.1 A 44 °C (±0.3°C).
2502345	42281528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	FCO	A.02.02.01.003.004	TIRA INDICADORA GLUTARALDEHIDO FCO 60	TIRAS INDICADORAS PARA GLUTARALDEHIDO-PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE GLUTARALDEHIDO-PRESNTACION FRASCO X 60 TIRAS
2584198	42281528	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.004	TIRA REACTIVA PARA ORTOFTALALDEHIDO	TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION MINIMA EFECTIVDA DEL 0.3% DE ORTOFTALALDEHIDO EN LA SOLUCION QUE SE ESTE REUSANDO EN EMPAQUE X 50 UND ALMACENAR LUGAR FRESCO Y SECO
2505558	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE ADULTO-BANDA ELASTICA	TORNIQUETE ADULTO-BANDA ELASTICA CON ADAPTACION PARA EJERCER PRESION EN EL SITIO PROXIMO A LA CODIGO VENOSA. LIBRE DE LATEX. DE REALIZAR FLEBOTOMIA. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA.
2503378	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE ADULTO-BANDA ELASTICA CON ADAPTACION PARA EJERCER PRESION EN EL SITIO PROXIMO A LA PUNCION VENOSA. LIBRE DE LATEX	TORNIQUETE ADULTO-BANDA ELASTICA CON ADAPTACION PARA EJERCER PRESION EN EL SITIO PROXIMO A LA CODIGO VENOSA. LIBRE DE LATEX. DIMENS REALIZAR FLEBOTOMIA. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA.
2502364	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE ELASTICO CON SISTEMA DE CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO Y HEBILLA DE SEGURIDAD	TORNIQUETE HECHO DE TEJIDO ELASTICO CON UN SISTEMA DE CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO Y HEBILLA DE SEGURIDAD. UTILIZADO PARA COMPRIMIR UNA VENA, POR DIFERENTES MOTIVOS, PARA DETENER UNA HEMORRAGIA, PARA DIFERENCIAR UNA VENA O VASO PARA EXTRAER SANGRE.
2502873	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIA EN TELA Y CIERRE DE CONTACTO ADHESIVO (CINTA DE GANCHO Y LAZO)	DISPOSITIVO PARA CONTROL DE HEMORRAGIA EN EXTREMIDADES CON TIRA DE MINIMO 4CM DE ANCHO Y LARGO MINIMO DE 89 CM. CON UN SISTEMA DE PARADA AUTOMATICA QUE PERMITE EL APRIETE INSTANTANEO DE LA BANDA DE CONSTRICCION SISTEMA DE GANCHO Y BUCLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE QUE FUNCIONE CUANDO ESTA COMPLETAMENTE SUMERGIDO, PROPORCIONANDO MAXIMA SEGURIDAD EN LAS CONDICIONES CLIMATICAS MAS DURAS, EL MATERIAL EXTERIOR ESTA OPTIMIZADO PARA LA VISION NOCTURNA, CONSTRUCCION DURADERA DE CORREA DE NYLON DE UNA SOLA CAPA, CUENTA CON AGUJEROS A INTERVALOS QUE SE

								BLOQUEAN CON LA HEBILLA. UN SISTEMA DE SEGURIDAD, EVITANDO QUE SE LIBERE ACCIDENTALMENTE Y PERMITIENDO UN FACIL AJUSTE AL MISMO, FACIL AUTO COLOCACION.
2502365	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE HECHO DE TEJIDO ELASTICO CON UN SISTEMA DE CIERRE DE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y HEBILLA DE SEGURIDAD	TORNIQUETE PEDIATRICO HECHO DE TEJIDO ELASTICO CON UN SISTEMA DE CIERRE DE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE Y HEBILLA DE SEGURIDAD DE PLASTOCO DISPOSITIVO DE RETIRO EN DOS MODALIDADES (TOTAL Y OUT PRESION) LAVABLE HASTA 60°C LONGITUD DE 40 CM MULTICOLOR
2503767	42295305	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	TORNIQUETE TACTICO PARA EL CONTROL DE HEMORRAGIA EN COMBATE O SITUACIONES DE EMERGENCIA	TORNIQUETE TACTICO PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS FABRICADO EN NYLON - POLIPROPILENO CON SISTEMA DE CIERRE
2504217	42294523	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	VALVULA DE AHMED GLAUCOMA DIFICIL TRATAMIENTO MODELO FP7	VALVULA DE AHMED EN SILICONA GRADO MEDICO PARA GLAUCOMA DIFICIL TRATAMIENTO MODELO FP7EN S
2505521	42294802	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-7	C/U	A.02.02.01.003.006	VALVULA DE BIOPSIA/NEGRA ENDOSCOPIO	VALVULA DE BIOPSIA/NEGRA ENDOSCOPIO LIBRE DE LATEX DE UN SOLO USO. COMPATIBLE CON ENDOSCOPIOS DISPONIBLES. REDUCE LA CONTAMINACION CRUZADA.MINIMIZACION DE FUGAS Y SALPICADURAS. LA TAPA PERFORADA EVITA SALPICADURAS Y ASEGURA LA ENTRADA FACIL DE ACCESORIOS. OPCIONES ESTERILES / NO ESTERILES DISPONIBLES. SE UTILIZAN PARA CUBRIR LAS ABERTURAS DE LAS ENTRADAS DE LA BIOPSIA/CANAL DE SUCCION DE LOS ENDOSCOPIOS GASTROINTESTINALES
GRUPO INSUMOS DE CORTE, DISECCION Y COAGULACION								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**

2504111	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA DE CORTE BIPOLAR 24/26 FR-PARA RESECCION RTU-TRATAMIENTOS DE ENDOSCOPIA UROLOGICA-GINECOLOGICA -EMPAQUE INNDIVIDUAL	ASA DE CORTE BIPOLAR 24/26 FR, RESECCION TRASURETERAL (RTU) EN TRATAMIENTOS DE ENDOSCOPIA- UROLOGIA- GINECOLOGIA; COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DE INSTITUCION, NO ESTERIL - ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE (REUTILIZABLE) LONGITUD APROX. 28.6 CM EMPAQUE INDIVIDUAL
2503212	42141808	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10x10mm, CON VASTAGO LARGO DE 15cm, EN CARBURO DE TUNGSTENO. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10X10mm, CON VASTAGO LARGO DE 15cm, FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, PARA CORTE PRECISO SIN QU AISLANTEPARA EVITAR POSIBLES FUGAS ELECTRICAS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2503214	42141808	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10x4mm, CON VASTAGO LARGO DE 15cm, EN CARBURO DE TUNGSTENO. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10X4mm, CON VASTAGO LARGO DE 15cm, FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, PARA CORTE PRECISO SIN QUE PARA EVITAR POSIBLES FUGAS ELECTRICAS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2503213	42141808	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10X7MM, CON VASTAGO LARGO DE 15CM, EN CARBURO DE TUNGSTENO. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA/ELECTRODO CUADRADA DE DIATERMIA 10X7mm, CON VASTAGO LARGO DE 15cm, FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, PARA CORTE PRECISO SIN QUE PARA EVITAR POSIBLES FUGAS ELECTRICAS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL

2587062	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL DE ALAMBRE TRENZADO-UTILIZADA EN POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL DE ALAMBRE TRENZADO- FLEXIBLE Y RIGIDO MEJORANDO EL AGARRE FACILITANDO LA RESECCION EN BLOQUE DE LESIONES PLANAS O SESILES-MANGO ERGONOMICO INTEGRADO CON MARCAS DE MEDICION-SE UTILIZA CON ENERIA DIATERMICA PARA LA EXTIRPACION ENDOSCOPICA DE POLIPOS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL-UN SOLO USO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504203	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA DE POLIPECTOMIA-DIAMETRO 2.0-3.0 MM DE ALMABRE MONOFILAMENTO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	EL ASA DE POLIPECTOMIA-PIEZA CON FINOS FILAMENTOS DE HILO TRENZADO-QUE SE PUEDE UTILIZAR CON CONEXIÓN A UNA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA-DE CORTES LIMPIOS Y PRECISOS PARA LA RESECCION DE POLIPOS DE DIFICIL ACCESO POR VIA ENDOSCOPICA-UN SOLO USO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2587063	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA OVALADA PARA GASTROSCOPIA GRANDE. MANGO EN MABS (METHYLMETHACRYLATE ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE)-CATETER DE TEFLON. ESTERI	ASA OVALADA PARA GASTROSCOPIA-GRANDE-CON ALAMBRE TRENZADO-FLEXIBLE- MANGO ERGONOMICO INTEGRADO CON MARCAS DE MEDICION. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2587064	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA OVALADA PARA GASTROSCOPIA MEDIANA. MANGO EN MABS (METHYLMETHACRYLATE ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE)-CATETER DE TEFLON. ESTER	ASA OVALADA DE ALAMBRE TRENZADO MEDIANA-FLEXIBLE. MANGO ERGONOMICO INTEGRADO CON MARCAS DE MEDICION. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL.

2587065	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA OVALADA PARA GASTROSCOPIA GRANDE. MANGO EN MABS (METHYLMETHACRYLATE ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE)- CATETER DE TEFLON. ESTERI	ASA OVALADA DE ALAMBRE TRENZADO PEQUEÑA-FLEXIBLE. MANGO ERGONOMICO INTEGRADO CON MARCAS DE MEDICION. UN SOLO USO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2503802	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 25X10mm PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 25X10mm PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2502786	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 10x10mm, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 10X10 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2502787	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 10x8mm, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 10X8 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2502788	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 13x13 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 13X13 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2502789	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 15x10mm, EMPAQUE INDIVIDUAL	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 15X10 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2502790	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 15X15 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL

							REDONDA 15x15mm	
2504619	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA 10X5 MM REUSABLE	ASA REDONDA DIATERMIA 10X5 MM REUSABLE
2503639	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA 15X12 MM	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 15X12 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL MOLDEADA EN POLIESTIRENO
2503638	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA 15X8 MM	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 15X8 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL MOLDEADA EN POLIESTIRENO
2503640	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA 20X15 MM	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 20X15 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL MOLDEADA EN POLIESTIRENO
2503641	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ASA REDONDA DIATERMIA 25X22 MM	ASA REDONDA DIATERMIA REDONDA 25X22 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL MOLDEADA EN POLIESTIRENO
2504520	42294913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE DILATACION BILIAR DIAMETRO Y LONGITUD DEL BALON 4MMX4CM RX USO UNICO	BALON DE DILATACION BILIAR USO UNICO RX. BALON DE DILATACION BILIARBALON PARA TRATAMIENTO DE ESTENOSIS BILIARES CON BANDAS RADIOPACA CAPACIDAD DE EMPUJE EN SU PASO A TRAVES DE ESTENOSIS- LA CODIGO DE 4 F (1,33 MM) ESTA DISEÑADA PARA UN PASO MENOS TRAUMATICO A TRAVES AUMENTAR
2504681	42294913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE DILATACION COLONICO D.E 8 mm / LONGITUD 5.5 cm	BALON DE POLIETILENO PARA DILATACION DE COLON D.E 8mm/L.5.5cm. D.E 8-9-10 cm-18 FR MINIMO-ADAPTABLE A LA ANATOMIA DE LA ESTENOSIS-DISEÑADOS PARA ALCANZAR TRES DIAMETROS SUCESIVOS-CON SISTEMA DE INFLADO
2504682	42294913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE DILATACION ESOFAGICO D.E 6MM/L.6CM	BALON DILATACION ESOFAGICO D.E 6mm/L.6cm. BALON DE DILATACION ESOFAGICA - BALON DE DILATACION ESOFAGICA DE 6MM DE DIAMETRO HINCHADOMINIMO, 24 FR MINIMO Y LONGITUD DE 5,5 CM COMO MINIMO.
2504683	42294913	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON DE DILATACION PILORICO D.E 6MM/L.5.5CM	BALON DILATACION PILORICO DE 6mm/L.5.5cm. BALON DE DILATACION PILORICA BALON DE DILATACION PILORICA DE 6MM DE DIAMETRO HINCHADO MINIMO, 18 FR MINIMO Y LONGITUD DE 5.5 CM COMO MINIMO.

2504684	42311600	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CLIPS RADIOPACO PARA HEMOSTASIA LONGITUD DE TRABAJO 155cm	CLIPS RADIOPACO PARA HEMOSTASIA L-155cm. EL CLIP DE RESOLUCION RADIOPACO ESTA DISEÑADO PARA HEMOSTASIA, MARCADO ENDOSCOPICO, CIERRE Y ANCLAJE DE TUBOS DE ALIMENTACION YEYUNAL. TAMBIEN SE HA ELIMINADO 510 (K) PARA LA HEMOSTASIA PARA EL RECORTE PROFILACTICO PARA REDUCIR EL RIESGO DE HEMORRAGIA TARDIA DESPUES DE LA RESECCION DE LA LESION
2587204	42294513	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	PK	A.02.02.01.003.006	CORTADOR DE VITRECTOMIA	EL CORTADOR DE VITRECTOMÍA Y LA MANGA DE IRRIGACIÓN AMO 20GA (PAQUETE) PROPORCIONA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE VITRECTOMÍA. LA VITRECTOMÍA AMO 20GA CUTTER PACK HA SIDO DISEÑADO COMO UN PRODUCTO DESECHABLE (DE UN SOLO USO) Y SE UTILIZA CON EL SISTEMA AMO WHITESTAR SIGNATURE. ESTE PRODUCTO HA SIDO ESTERILIZADO POR RADIACIÓN GAMMA. EL PAQUETE DE CORTADORES DE VITRECTOMÍA AMO 20GA CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN CORTADOR DE VITRECTOMÍA ANTERIOR DESECHABLE, UNA MANGA DE IRRIGACIÓN DESECHABLE, INDICACIONES PARA EL USO: EL PAQUETE DE CORTADORES DE VITRECTOMÍA AMO 20GA SE UTILIZA PARA ELIMINAR LA MATERIA VÍTREA DEL OJO
2500652	52141705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CUCHILLA DE AFEITAR COMPATIBLE CON MAQUINA RASUDORA CLIPPER, EMPAQUE INDIVIDUAL	CUCHILLAS FIJAS DE UN SOLO USO COMPATIBLE CON MAQUINA RASUDORA CLIPPER, QUE SE PONEN O SE REMUEVEN CON FACILIDAD, REDUCIENDO EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD PORTATIL CON CUCHILLA DESECHABLE QUE PERMITE UNA REMOCION DEL VELLO CORPORAL DE LOS PACIENTES PRE-QUIRURGICOS A 2 MM DE LA PIEL EN DONDE LA REMOCION DEL VELLO ES NECESARIA.
2503211	52141705	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CUCHILLA HOJAS PARA LAMINA PARA AFEITAR REVESTIDA EN ACERO INOXIDABLE CON PLATINA, CROMO CON POLITETRAFLUOETILENO CAJA X 3 UND	CUCHILLA HOJAS PARA LAMINA PARA AFEITAR REVESTIDA EN ACERO INOXIDABLE CON PLATINA, CROMO CON POLITETRAFLUOETILENO, CAJA X 3 UND

2503551	42291607	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CURETA DESECHABLE PARA DERMATOLOGIA N°4, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	CURETA DESECHABLE DE MANGO PLASTICO ACANALADO CON UN ANILLO AFILADO, DE BORDE CON CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE, ESTERIL
2504370	42291607	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CURETA DESECHABLE PARA DERMATOLOGIA N°5, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	CURETA DERMICA DE MANGO PLASTICO ACANALADO CON UN ANILLO AFILADO, DE BORDE CON CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE
2504342	42291607	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CURETA DESECHABLE PARA DERMATOLOGIA N°7, INDIVIDUAL	CURETA DERMICA DE MANGO PLASTICO N° 7 ACANALADO CON UN ANILLO AFILADO, DE BORDE CON CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE
2503549	42291607	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CURETA DESECHABLE PARA DERMATOLOGIA N°2, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	CURETA DESECHABLE DE MANGO PLASTICO ACANALADO CON UN ANILLO AFILADO, DE BORDE CON CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE
2503550	42291607	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	CURETA DESECHABLE PARA DERMATOLOGIA N°3, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	CURETA DESECHABLE DE MANGO PLASTICO ACANALADO CON UN ANILLO AFILADO, DE BORDE CON CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE
2504478	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	DISPOSITIVO ENDOSCOPICO PARA RESECCION MUCOSA	DISPOSITIVO ENDOSCOPICO PARA RESECCION MUCOSA. DISEÑADO PARA LA DISECCION DE LA MUCOSIDAD ENDOSCOPICA (EMR) ASISTIDO POR LIGACION DE PARACANAL DE TRABAJO 2.8mm REF 6164. KIT DE PATOLOGIA EMR
2503215	42141808	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO DE BOLA DE 3MM DE DIAMETRO CON MANGO DE 11CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ELECTRODO DE BOLA DE 3mm DE DIAMETRO, CON MANGO DE 11c-, PARA DIATERMIA/COAGULACION PARA BIOPSIA DE CUELLO UTERINO. ESTERIL, EMPAQU INDIVIDUAL

2503216	42141808	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO DE BOLA DE 5MM DE DIAMETRO CON MANGO DE 11CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ELECTRODO DE BOLA DE 5mm DE DIAMETRO, CON MANGO DE 11cm-PARA DIATERMIA/COAGULACION PARA BIOPSIA DE CUELLO UTERINO. ESTERIL, EMPAQU INDIVIDUAL
2504340	42294933	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO DE COAGULACION 3MM DE DIAMETRO CON MANGO DE 11CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	ELECTRODO DE COAGULACION 3MM DE DIAMETRO. ESTERIL. CON RODILLO EN EL EXTREMO
2500336	39121436	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO EQUIPO ARTROSCOPIA	ELECTRODO PARA VAPORIZAR. COAGULAR O REMODELAR TEJIDOS EN EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIAS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO CON CARACTERISTICAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO DISPONIBLE CON DIFERENTES ANGULOS DE CODIGO ACTIVA ESTRIADA CON O SIN LAPIZ MONOPOLAR DE ACTIVACION MANUAL Y ENCHUFE UNIVERSAL DE TRES CLAVIJAS ESFERICO Y/O PLANA. ESTERIL Y DE USO UNICO
2587066	42181708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	ELECTRODO MONOPOLAR PUNTA PEDIATRICA CONECTOR, MEDIDA: 7.2 A 7.6cm. ESTERIL. UNIDAD	ELECTRODO MONOPOLAR CODIGO PEDIATRICA. EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTO DE POLIMERO DE BAJA FRICCION. CONECTOR. COBERTURA PLASTICA. UNIDAD
2504128	42292900	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 31/33mm	GRAPADORA CIRCULAR CURVA 31/33mm GRAPA DE TITANIO ABIERTA-CON CABEZAL DE DOBLE HILERA CIRCULAR Y ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO, ESTERIL
2500550	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 20 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°20 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500546	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 10 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°10 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500547	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 11 EN ACERO	HOJAS BISTURI N°11 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL.

							INOXIDABLE GRADO MEDICO	DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500549	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500551	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 21 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°21 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500552	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 22 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°22 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500554	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 24 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°24 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2584105	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 10, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	HOJAS BISTURI 10 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2584106	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 11, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	HOJAS BISTURI 11 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2584107	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 12, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	HOJAS BISTURI 12 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2584108	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 15, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	HOJAS BISTURI 15 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2502791	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 20	HOJAS BISTURI 20 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM

2502792	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 21	HOJAS BISTURI 21 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2584109	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI ACERO AL CARBONO N° 22, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	HOJAS BISTURI 22 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE CON ALTARESISTNCIA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIUAL DE FACIL APERTURA, CO MM
2500553	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 23 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°23 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2500548	42291613	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	HOJAS BISTURI N° 12 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	HOJAS BISTURI N°12 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. ACERO CARBONO. ESTERIL. DESCARTABALE. LIBRE DE LATEX. CON FILO. EMPAQUE INDIVIDUAL. UN SOLO USO.
2501947	42294934	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.DESECHABLE PARA USO UNICO MANGO MULTIBANNDA CON CORDON DE LIBERACION QUE POSEA DOS TAMBORES DE 6 LIGADURAS
2504519	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	KIT DUAL TROCAR OPTICO 100 MM X 11MM	KIT DUAL TROCAR OPTICO 100 MM X 11MM. KIT DUAL PACK SISTEMA TROCAR OPTICO SEPARADOR ROSCADO EN Z DE 11 MM X 100MM (DOS CANULAS ROSCA GAS).
2504302	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	KIT DE TROCARES DE 5mm	KIT DE TROCARES DE 5mm COMPUESTO POR DOS CAMISAS Y UN OBTURADOR DE CUCHILLA PROTEGIDA ESTERIL DESCHABLE.
2584038	42312200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	LIGA CLIP EN TITANIO GRANDE, PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA	GRAPA METALICA PARA LIGADURA, ELABORADO EN TITANIO, NO ABSORBIBLE, RADIOLUCIDO, CON DISPOSICION DE PINZA PARA LA COLOCACION, DESCART UND
2584039	42312200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	LIGA CLIP EN TITANIO MEDIANO, PARA CIRUGIA	GRAPA METALICA PARA LIGADURA, ELABORADO EN TITANIO, NO ABSORBIBLE, RADIOLUCIDO, CON DISPOSICION DE PINZA PARA LA COLOCACION, DESCART UND
2565512	42312200	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	LIGA CLIP EXTRAMEDIANO LT300 X6 UND x CART	LIGA CLIP EXTRAMEDIANO EN TITANIO LT300 X6 UND x CART

2504201	42291800	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.003.006	LIGADORES MULTIPLES BANDAS PARA VARICES ESOFAGICAS Y ANORECTALES	LIGADORES DE MULTIPLES BANDAS PARA VARICES ESOFAGICAS Y ANORECTALES- SE UTILIZA PARA LA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS DE MANERA ENDOSCOPICA YA SEA EN LA UNION GASTROESOFAGICA O POR ENCIMA DE ELLA. TAMBIEN ES UTILIZADO PARA LIGAR LAS HEMORROIDES INTERNAS. CONSTA DE 9 BANDAS PRECARGADAS- CON CABLE DISPARADOR CONECTADO- MANGO DE LIGADOR DE MULTIPLES BANDAS- CATETER DE CARGA Y ADAPTADOR DE IRRIGACION.
2501171	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA COMPATIBLE CON CABLE VALLEY LAB	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE ACERO INOXIDABEL DE 16CM DE LONGITUD COMPATIBLE CON CABLE VALLEYLAB
2587061	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PINZA DE SELLADO Y CORTE, CORTE MANDIBULA CURVA PARA CIRUGIA ABIERTA, ESTERIL, DESECHABLE. UNIDAD	PINZA DE SELLADO Y CORTE, CORTE MANDIBULA CURVA PARA CIRUGIA ABIERTA LARGO DEL INSTRUMENTO DE 18 CM ROTACION DE 180° LONGITUD DE CORTE SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE
2504461	42294924	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PINZA SELLADO VASOS HASTA 5MM LONG 9CM. COMPUESTA POR UN MANGO EN FORMA DE TIJERA SUAVE Y DOS CONTROLES, DE PUNTA CURVA CONICA	PINZA SELLADO VASOS HASTA 5mm LONG 9cm. COMPUESTA POR UN MANGO EN FORMA DE TIJERA SUAVE Y DOS CONTROLES, DE CODIGO CURVA CONICA, ERGO PERIFERIA VASCULAR, GENERAL, MAMA, COLORECTAL, UROLOGIA, PLASTICA. COMPATIBLE CON EL GENRADOR DE ETHICON (GEN11)
2504505	42291616	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PINZA AGARRE ARTROSCOPIA 3X10 MM 130MM	PINZA DE AGARRE FUERTE PARA ARTROSCOPIA 3X10 MM 130MM. PRESION MENISCO FORCEPS, FUERTE
2503545	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N° 2, ESTERIL, LISTO PARA USAR. EMPAQUE INDIVIDUAL	CODIGOCH LISTO PARA UTILIZAR, BORDE CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE, MANGO ACANALADO, EL TAMAÑO LO DEFINE CADA CODIGOCH PARA SU IDENTIFICA

2503546	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N° 3	CODIGOCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N° 3 ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE DE CODIGO AFILADA
2503547	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N°4	CODIGOCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N°4 ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE DE CODIGO AFILADA
2503548	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N°5	CODIGOCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N° 5 ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE DE CODIGO AFILADA
2503698	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N°6	CODIGOCH DESECHABLE PARA BIOPSIA N°6 EN ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y MAGO ACANALADO
2504496	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNCH ESTERIL PARA BIOPSIA DE PIEL DIAMETRO N° 8	CODIGOCH LISTO PARA UTILIZAR, BORDE CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE, MANGO ACANALADO, EL TAMAÑO LO DEFINE CADA CODIGOCH PARA SU IDENTIFICA 8
2504327	42291600	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNZON O "PUNCH" ESTERIL PARA BIOPSIA DE PIEL- DIAMETRO 8mm	CODIGOZON "CODIGOCH" LISTO PARA UTILIZAR- BORDE CORTE AGUDO EN ACERO INOXIDABLE- MANGO ACANALADO- EL TAMAÑO LO DEFINE CADA CODIGOCH PARA SU I 8mm
2504210	42294206	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	QUERATOMO - 15 GRADOS PARA PUERTO LATERAL	QUERATOMO - 15 GRADOS PARA PUERTO LATERAL EN EMPAQUE INDIVIDUAL. MANGO PLASTICO ESTERIL
2504212	42294206	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	QUERATOMO CUCHILLETE OFTALMICO TIPO CRESCENT	QUERATOMO CUCHILLETE OFTALMICO TIPO CRESCENT ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL. BORDE CORTANTE REDONDEADO. ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO
2504211	42294206	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	QUERATOMO - DE CORNEA CLARA. 2,7 MM	QUERATOMO - DE CORNEA CLARA. 2,7 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO
2504185	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE CON GRAPA AJUSTABLE COMPATIBLE PARA GRAPADORA LINEAL	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE CON GRAPA AJUSTABLE COMPATIBLE PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTILC75 MM

							CORTANTE NTILC75 MM EN USO EN HONAC	
2504181	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80MM, GRAPA 3.8. CIRUGIA ABIERTA	RECARGA GRAPADORA EN TITANIO LINEAL CORTANTE DE 75 - 80mm, GRAPA 3.8mm CIRUGIA ABIERTA
2504182	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80MM, GRAPA 3.8. CIRUGIA ABIERTA	RECARGA GRAPADORA EN TITANIO LINEAL CORTANTE DE 75 - 80mm, GRAPA 3.8mm CIRUGIA ABIERTA
2504183	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80MM, GRAPA 4.8MM CIRUGIA ABIERTA	RECARGA GRAPADORA EN TITANIO LINEAL CORTANTE DE 75 - 80mm, GRAPA 4.8. CIRUGIA ABIERTA
2504184	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80MM TEJIDO NORMAL AZUL	RECARGA GRAPADORA EN TITANIO LINEAL CORTANTE DE 75 - 80mm, GRAPA 4.8. CIRUGIA ABIERTA
2504213	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA BLANCA 60mm CON GRAPAS DE TITANIO 2.5mm DE ALTURA DE COLOR BLANCO - RECARGA BLANCA DE 60	CARTUCHO 60mm CON GRAPAS DE TITANIO 2.5mm DE ALTURA DE COLOR BLANCO - RECARGA BLANCA DE 60 REF 30457. COLOCA DOS FILAS DOBLES ESCALONADAS DE GRAPAS DE TITANIO Y SIMULTANEAMENTE CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO ENTRE LAS DOS FILAS DOBLES.
2504214	42292904	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	RECARGA DORADA 60 MM	CARTUCHO RECARGA DORADO 60 MM PARA ENGRAPADORA ECHELON POWER PIEZA

2500431	42142518	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SET PARA BIOPSIA SISTEMA DE VACIO G17	SET PARA BIOPSIA CON SISTEMA DE VACIO G17.ESTERIL EN EL QUE SE DETERMINE FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTERILIZACION.EMPAQUE TRANSPARENTE-DIAGNOSTICAS.
2500430	42142504	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SET PARA BIOPSIA SISTEMA DE VACIO G21	SET PARA BIOPSIA CON SISTEMA DE VACIO G21.ESTERIL EN EL QUE SE DETERMINE FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTERILIZACION.EMPAQUE TRANSPARENTE-DIAGNOSTICAS.
2565511	42293004	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SIERRA DE GIGLI- DE 4 A 6 HEBRAS- EN ACERO INOXIDABLE TRENZADO	ALAMBRE CON DIENTES DE SIERRA EN ACERO INOXIDABLE QUIRUGICO EMPLEADO EN CIRUGIAS ORTOPEDICAS- TRENZADO CON DOS O TRES HILOS A LARGO
2504303	42294202	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE FIJACION LAPAROSCOPICA ABSORBIBLE DE MALLA, DE 5MM CON 12-15 FIJADORES	DISPOSITIVO DE FIJACION LAPAROSCOPICA ABSORBIBLE DE MALLA, CON CODIGOTOS DE AGARRE SINTETICOS
2504301	42296212	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA TROCAR ROSCADO OPTICO SIN CUCHILLA 11mmX100mm ESTERIL-DESCARTABLE	SISTEMA TROCAR ROSCADO OPTICO SIN CUCHILLA. CON UNA CANULA ROSCADA + OBTURADOR OPTICO- PUERTO PARA EL LENTE-VALVULA RETRACTIL. LIBRE DE LATEX-DESECHABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL
2504195	42296212	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 12mm EMPAQUE INDIVIDUAL	TROCAR OPTICO SEPARADOR ROSCADO EN Z DE 12mm X 100mm UNA CANULA ROSCADA EN Z MAS OBTURADOR OPTICO- SIN CUCHILLA CON PUERTO. COMPUESTO POR OBTURADOR CON CABEZAL ROMO Y TRANSPARENTE EN EL EXTREMO DISTAL. CODIGO "NARIZ DE DELFIN". DISENO DE BLOQUEO DEL ALCANCE PASIVO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO FECHA VENCIMIENTO Y LOTE.
2503871	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 5MM Ø (DIAMETRO) Y 100MM DE LONGITUD, EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO	TROCAR DE 5mm Ø (DIAMETRO) Y 100mm DE LONGITUD, EN MATERIAL PLASTICO GR DO MEDICO, CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO DILATADORA (A CON SISTEMA DE ANCLAJE A LA PIEL, NO FIJO. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE. USO: TECNICALAPAROSCOPIA.

							CANULA RADIOTRANSPARENTE CON PUNTA DILATADORA	
2503209	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 5MM Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE TROCAR DE 10mmØ (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO CORTANTE, VALVULA INSUFL ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. DES CARTABLE. USO: TECNICAS DE LAPAROSCOPIA
2503210	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 5MM Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE TROCAR DE 10mmØ (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO ROMA, VALVULA INSUFLADOR EMPAQUE INDIVIDUAL. DES CARTABLE. USO: TECNICAS DE LAPAROSCOPIA
2503208	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 5MM Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE TROCAR DE 5mm Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO CORTANTE, VALVULA INSUFL ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. DES CARTABLE. USO: TECNICAS DE LAPAROSCOPIA
2503207	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 5MM Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO	SISTEMA DE TROCAR DE 5mm Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO ROMA (ATRAUMATICA, VALVU FIJO. ESTERIL, EMPAQUE INDIVI- DUAL. DESCARTABLE. USO: TECNICAS DE LAPAROSCOPIA

							MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504618	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA TROCAR ROSCADO OPTICO SIN CUCHILLA 5MMX100MM ESTERIL, DESCARTABLE	SISTEMA TROCAR ROSCADO OPTICO SIN CUCHILLA 5mmX100mm. CONSTA DE 1 CANULA ROSCADA+ OBTURADOR DE CODIGO ATRAUMATICA TIPO SEPARADOR OPT TIPO KII + VALVULA PARA GAS. INDICADO PARA INTERVENCIONES LAPAROSCOPICAS DE CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL, TORACCICA, GINECOLOGICA Y URO
2504789	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 11mm Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	SISTEMA DE TROCAR DE 11mmØ (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO CANULA RADIOTRANSPARENTE CON CODIGO ROMA, VALVULA INSUFLADOR EMPAQUE INDIVIDUAL. DES CARTABLE. USO: TECNICAS DE LAPAROSCOPIA
2504247	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE TROCAR DE 12MM Ø (DIAMETRO), EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL	TROCAR OPTICO SEPARADOR ROSCADO EN Z DE 12MM X 100MM UNA CANULA ROSCADA EN Z MAS OBTURADOR OPTICO, SIN CUCHILLA CON PUERTO PARA LENT GAS
2504172	42294935	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-8	C/U	A.02.02.01.004.001	TROCAR TORAXICO RIGIDO	TROCAR TORAXICO RIGIDO ESTERIL EN PVC TERMOSENSIBLE CON LINEA RADIOPACA QUE CONSTA DE UN OBTURADOR MECANICO Y UNA CANULA FLEXIBLE CON ORIFICIOS PARA LAS GRAPAS O SUTURAS.

GRUPO INSUMOS DE DESINFECCION								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**

2503410		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ACIDO NITRICO 35% FRASCO POR 100ml	ACIDO NITRICO AL 35%- SUSTANCIA INCOLORA TRANSLUCIDA EN FRASCO POR 100 ML IDEAL PARA LA PREPARACION DE LIMPIADORES DOMESTICOS- DESINCRUSTANTES DE CERAMICAS- DETERGENTES ACIDOS PARA LA ELIMINACION DE ACUMULACIONES MINERALES Y CALCAREAS EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y PECUARIAS- EN GENERAL.
2503409		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ACIDO TRICLOROACETICO 35% FRASCO 500ml	ACIDO TRICLOROACETICO AL 35% ORGANICO DERIVADO DEL ACIDO ACETICO- SUSTANCIA CAUSTICA- CORROSIVA- HEMOSTATICO EFICAZ ALMACENADO EN FRASCO DE 500 ML- CAPAZ DE DESTRUIR EL TEJIDO- CONSERVESE EN RECIPIENTE DE VIDRIO BIEN TAPADO Y DESECHARSE COMO SUSTANCIA TOXICO.
2584133		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ACIDO TRICLOROACETICO 80% FRASCO 25ML	ACIDO TRICLOROACETICO AL 80% ORGANICO DERIVADO DEL ACIDO ACETICO- SUSTANCIA CAUSTICA- CORROSIVA- HEMOSTATICO EFICAZ ALMACENADO EN FRASCO DE 25 ML- CAPAZ DE DESTRUIR EL TEJIDO- CONSERVESE EN RECIPIENTE DE VIDRIO BIEN TAPADO Y DESECHARSE COMO SUSTANCIA TOXICO.
2504502		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ACIDO TRICLOROACETICO 85% FRASCO X 25ML	ACIDO TRICLOROACETICO AL 85% ORGANICO DERIVADO DEL ACIDO ACETICO- SUSTANCIA CAUSTICA- CORROSIVA- HEMOSTATICO EFICAZ ALMACENADO EN FRASCO DE 25 ML- CAPAZ DE DESTRUIR EL TEJIDO- CONSERVESE EN RECIPIENTE DE VIDRIO BIEN TAPADO Y DESECHARSE COMO SUSTANCIA TOXICO.
2504298		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ACIDO TRICLOROACETICO 85% FRASCO 500ML	ACIDO TRICLOROACETICO AL 85% ORGANICO DERIVADO DEL ACIDO ACETICO- SUSTANCIA CAUSTICA- CORROSIVA- HEMOSTATICO EFICAZ ALMACENADO EN FRASCO DE 500 ML- CAPAZ DE DESTRUIR EL TEJIDO- CONSERVESE EN RECIPIENTE DE VIDRIO BIEN TAPADO Y DESECHARSE COMO SUSTANCIA TOXICO.
2501160	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL ETILICO 70% - 96 %	ALCOHOL ETILICO 70% - 96 %-SOLUCION ANTISEPTICA DE ACCION RAPIDA Y AMPLIO ESPECTRO (BATERIAS GRAMNEGATIVAS Y GRAMPOSITIVAS- MICOBACTERIAS- HONGOS Y VIRUS) - INCOLORO - INFAMABLE Y SOLUBLE EN AGUA DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS. PRESENTACION 250 ML- 500 ML- 1000 ML SOLUCION DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS. LIQUIDO TRANSPARENTE DE OLOR CARACTERISTICO. usar 3765 ml. BACTERICIDA- FUNGICIDA Y VIRUCIDA- LIB

2504587	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL ETILICO 180G/KG + CLORURO DE DIDECILMETILAMONIO (AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION) 160G/KG. BOLSA CON 60 BOLSA DE 5G	ALCOHOL ETILICO 180g/kg + CLORURO DE DIDECILMETILAMONIO (AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION) 160g/kg. CARACTERISTICAS FISICO-QU BIODEGRADABLE.PRESENTACION-BOLSA RESELLABLE CON 60 BOLSAS DE 5g. REGISTRO INVIMA o. 2017002771
2501163	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO X 240ml CON VALVULA DISPENSADORA	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%- GEL BACTERICIDA- TUBERCULICIDA- FUNGICIDA Y VIRUCIDA AL 70% FRASCO X 240ml- ALCOHOL ETILICO- ALCOHOL ISOPROPI MANOS CON VALVULA DISPENSADORA
2584147	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO 65% FRASCO DISPENSADOR	GEL ANTISEPTICO 65 % PARA DESINFECCION DE MANOS- ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO- CONTIENE ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)- ALCOHOL ETILICO (ETANOL)- GELIFICANTES- EMOLIENTES Y EXCIPIENTES PRESENTACION - 500ml- 1000ml. 3785 ml.
2505731	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	ALCOHOL GLICERINADO/ISOPROPI 70% FRASCO - GALON	GEL ANTISEPTICO 70 % PARA DESINFECCION DE MANOS- ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO- CONTIENE ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)- ALCOHOL ETILICO (ETANOL)- GELIFICANTES- EMOLIENTES Y EXCIPIENTES PRESENTACION - 500ml- 1000ml. 3785 ml.
2505720	42281709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	CEPILLO LIMPIEZA ENDOSCOPIA 6mmX230cm	CEPILLO EN FORMA DE CATETER-TEXTURIZADO ANTIDESLIZANTE CON CERDAS DE POLIAMIDA-FLEXIBLE-CODIGO REDONDEADA-DIAMETRO 6MM X 230 cm PARA ALCANCE DE INSTRUMENTOS CON UN TAMAÑO DEL CANAL DE 4 A 5 mm-USO-LIMPIAR EL CANAL INTERIOR DE UN ENDOSCOPIO-DESECHABLE-
2505719	42281709	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	CEPILLO LIMPIEZA ENDOSCOPIA/ESTERILIZAR	CEPILLO EN FORMA DE CATETER-EN ACERO INOXIDABLE- ANTIDESLIZANTE-FLEXIBLE-CODIGO REDONDEADA-PARA LIMPIEZA DE DOBLE CABEZAL DE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION Y LOS PUERTOS DE LAS VALVULAS-AUTOCLAVABLE
2503815	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE ORTOFTALDEHIDO 0.55%	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON PRINCIPIO ACTIVO ORTOFTALDEHIDO 0.55%. PARA DESINFECCION MANUAL O AUTOMATICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

							GARRAFA PR 5 LITROS - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL	
2503243	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES A BASE DE AMONIO CUATERNARIO MAS ALDEHIDO-GALON	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL. CON BASE EN SALES DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION. BIODEGRADABLE.
2504892	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	TAB	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DICLOROCIANURATO SODIO TAB	TABLETAS DESINFECTANTES Y DE LIMPIEZA CON BASE DE DICLOROCIANURATO SODIO
2503252	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL GLUTARALDEHIDO 2%. GARRAFA POR 5 LITROS	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR GLUTARALDEHIDO AL 2% Y UN AGENTE INHIBIDOR DE CORROSION. PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO E IMPLEMENTOS MEDICOS
2503133	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2 % POR GALON	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR GLUTARALDEHIDO AL 2%. SIN ACTIVADOR. ANTICORROSIVO. BIODEGRADABLE
2505091	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	L	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A DE 1 LITRO	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR (CADA 100mL CONTIENE) GLUTARALDEHIDO 0.100 + FORMALDEHIDO 0.040g + CETRIMIDA 0.060g. SIN ACTIVADOR. ANTICORROSIVO. BIODEGRADABLE. PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES QUIRURGICAS Y AREAS HOSPITALARIAS
2505090	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A DE GALON	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR (CADA 100mL CONTIENE) GLUTARALDEHIDO 0.100 + FORMALDEHIDO 0.040g + CETRIMIDA 0.060g. SIN ACTIVADOR. ANTICORROSIVO. BIODEGRADABLE. PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES QUIRURGICAS Y AREAS HOSPITALARIAS
2504048	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE PEROXIDO HIDROG+PLATA 5 L	SOLUCION DESINFECTANTE COMPUESTO CON PEROXIDO DE HIDROGENO ESTABILIZADO CON PLATA

2503131	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ACIDO PERACETICO. GARRAFAx3.8 LIT	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE BASE DE ACIDO PERACETICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. NO FOSFATOS ORGANICOS
2502360	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE GLUTARALDEHIDO AL 2% GALON	SOLUCION DESINFECTACTE CON GLUTARALDEHIDO 2%. CON AGENTE INHIBIDOR DE CORROSION. SOLUBLE EN AGUA.
2505648	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO DE SODIO AL 0-05%-500 ppm DE 5 GALONES	DESINFECTANTE LIQUIDO DE AMPLIO ESPECTRO A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO ESTABILIZADO DE 0-05% A 500 ppm-ALTAMENTE EFECTIVO CONTRA BACTERIAS- VIRUS- HONGOS Y ESPORAS. DESINFECTANTE NATURAL POTENTE-NO TOXICO PARA LOS SERES HUMANOS-ANIMALES Y PLANTAS- ES ALTAMENTE EFICAZ COMO AGENTE MICROBIANO Y DE ACCION RAPIDA-EN FRASCO POR 5 GALONES-
2587190	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	PRODUCTO FORMULADO CON AMONIOS CUATERNARIOS DE 5° GENERACION. CON BASE EN SALES DE AMONIO. BIODEGRADABLE. EFECTIVO CON TODO TIPO DE AGUAS.
2503648	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTO NIVEL CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION-PRESENTACION FRASCO POR 500ml	DESINFECTANTE DE PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTO NIVEL CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION-LIQUIDO DE COLOR TRANSLUCIDO-CON PODER BACTERICIDA (BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y NEGATIVAS)-HONGOS Y LEVADURAS-USO-DESINFECCION DEL DISPOSITIVO MEDICO ENTRE PACIENTE Y PACIENTE-APLICAR GENEROSAMENTE-FROTAR-DEJAR SECAR-NO RETIRAR-PRESENTACION FRASCO POR 500ml
2500436	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, GLUTARALDEHIDO AL 2%. NO CORROSIVO	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR GLUTARALDEHIDO AL 2% Y UN AGENTE INHIBIDOR DE CORROSION. PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO E IMPLEMENTOS MEDICOS
2584033		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DESINFECTANTE ALTO NIVEL GLUTARALDHEI	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE CON GLUTARALDEHIDO. FORMALDEHIDO Y CETRIMIDA. ANTICORROSIVO. 5 LITROS

							DO 0,0564, FORMALDHEIDO 0,0128. CETRIMIDA 0,0513. GARRAFA DE 5 LITROS	
2502796	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE AL 5% ACIDO SULFONICO LINEAL+OTROS. GALON	DETERGENTE 5% CON ACIDO SULFONICO LINEAL, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, METASILICATO, HIDROXIDO DE SODIO Y GLICERINA. GALON
2584192	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE CON ENZIMA PROTEOLITICA BOLSA POR 5G. PAQUETE POR 12 BOLSAS	SOLUCION DETERGENTE CON ENZIMA PROTEOLITICA. NEUTRO. BIODEGRADABLE.
2501167	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA DILUIR A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE IV GENERACION Y DERIVADOS AMINOS. FRASCO x 1000ml/1 L	SOLUCION DETERGENTE DESINFECTANTE COMPUESTO DE PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO, CLORHIDRATO DE POLIEXAMETILENO BIGUANIDA. INHIBIDOR DE LA CORROSION, BIODEGRADABLE
2500840	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	BX	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE ENZIMATICO x 42 BOLSAS Y CADA BOLSA CONTIENE 12 SOBRES/CADA SOBRE POR 20G	SOLUCION DETERGENTE MULTIENZIMATICO Y/O POLIENZIMATICO. BACTERIOSTATICO. ATOXICO. BIODEGRADABLE.
2500643	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	SOB	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL. SOLUBLE EN AGUA. SOBRE DE 20 GRAMOS	SOLUCION DETERGENTE MULTIENZIMATICO Y/O POLIENZIMATICO. BACTERIOSTATICO. ATOXICO. BIODEGRADABLE. HIPOALERGENICO. NO CORROSIVO.
2584009	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE- NO IONICO-	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.

							NEUTRO X 2000ml	
2504243	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA DILUIR A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE V GENERACION Y DERIVADOS AMINOS. FRASCO X 1000ML/	SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL. CON BASE EN SALES DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION. BIODEGRADABLE. NO IONICO. INHIBIDOR DE LA CORROSION
2504889	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE DESINFECTANTE SUELOS POLVO 25MG	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS EN POLVO DE 25MG. DETERGENTE DESINFECTANTE DE ESPECTRO ANCHO DURANTE EL PERIODO EPIDEMICO PARA SUELOS Y SUPERFICIES CON ACTIVIDAD DE ALTO NIVEL FRENTE AL CLOSTRIDIUM DIFFICILE- NOROVIRUS- ROTAVIRUS- MYCOBACTERIM TERRAE Y AVIUM. ACTIVO FRENTE AL CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN 15 MINUTOS- ALTERNATIVA AL CLORO- DE DOSIS UNICA. CARACTERISTICAS- POLVO LIBERADOR DE ACIDO PARACETICO- POLVO BLANCO DE PEQUEÑA GRANULOMETRIA- POLVO HIGROSCOPICO- CONSERVAR AL ABRIGO DE LA HUMEDAD)- PH CON UNA DILUCION DE 0-5%- APROX. 9-3- DENSIDAD- 0.91- FORMULA SIN PERBORATO- SIN OLOR CARACTERISTICO TRAS DILUCION- SOLUCION DE COLOR AZUL TRAS DILUCION.
2504786	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE ENZIMATICO GARRAFA POR 5 LITROS. CONTIENE ENZIMAS PROTEOLITICAS (PROTEAZA) + SURFACTENTES.	SOLUCION DETERGENTE ENZIMATICO. CON ENZIMAS PROTEOLITICAS (PROTEASA) CON SURFACTANTES. BIODEGRADABLE

2502801	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL PENTAENZIMATICO- BACTERIOSTATICO- PH NEUTRO- GARRAFA X 5 LIT	SOLUCION DETERGENTE PENTAENZIMATICO. BACTERIOSTATICO. PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2504876	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE INSTRUMEN PENTAENZIMATICO 1L	SOLUCION DETERGENTE PENTAENZIMATICO. BACTERIOSTATICO. PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2503190	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRIENZIMATICOS FRASCO DE 750ML CON VALVULA DOSIFICADORA	SOLUCION DETERGENTE TRIENZIMATICO (PROTEASA. LIPASA Y AMILASA). PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2503768	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRIENZIMATICO CON ESTABILIZADOR DE ENZIMAS SECUESTRANTES- FRASCO POR 1 LITRO	SOLUCION DETERGENTE TRIENZIMATICO (PROTEASA. LIPASA Y AMILASA). PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2502734	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRIENZIMATICO - GARRAFA CON BOMBA DOSIFICADORA x4 LITROS	SOLUCION DETERGENTE TRIENZIMATICO (PROTEASA. LIPASA Y AMILASA). PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2502733	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRIENZIMATICO - GARRAFA CON BOMBA DOSIFICADORA x5 LITROS	SOLUCION DETERGENTE TRIENZIMATICO (PROTEASA. LIPASA Y AMILASA). PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS

2502350	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRIENZIMATICO CON ESTABILIZADOR DE ENZIMAS SECUESTRANTES-GALON/3780ML	SOLUCION DETERGENTE TRIENZIMATICO (PROTEASA. LIPASA Y AMILASA). PH NEUTRO. ATOXICO. NO CORROSIVO. BIODEGRADABLE. SIN FOSFATOS
2503982	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL PENTAENZIMATICO, BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, GALON	COMPLEJO PENTA-ENZIMATICO, BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, ATOXICO, (PROTEASA, LIPASA AMILASA, CARBOHIDRAZA, ENZIMAS HIDROLITICAS) CON ES TABILIZADOR DE ENZIMAS SECUESTRANTES, AGENTES CONSERVADORES COLORANTES Y EXCIPIENTES, PH NEUTRO, CON ESPUMA CONTROLADA, QUE NO DAÑEN INGUN METAL Y
2503419	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	SOB	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE PARA LAVAR INSTRUMENTAL SOB 50G. USO EN MATERIAL POCO CONTAMINADO O DE RIESGO MEDIO	SOLUCION DETERGENTE MULTIENZIMATICO Y/O POLIENZIMATICO. BACTERIOSTATICO. ATOXICO. BIODEGRADABLE. HIPOALERGENICO. NO CORROSIVO.
2500334	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LAVADO MANUAL DE MATERIAL DE LABORATORIO-FRASCO DE 1000ML	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.
2501101	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE- PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO 5000ml	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.
2502717	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE- PARA	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.

							LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO. GALON	
2501111	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE- PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO 2000ml	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.
2503159	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE- LLBRE DE FOSFATOS- PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO. GARRAFA POR 5000ML	SOLUCION DETERGENTE NO IONICO. BIODEGRADABLE. NEUTRO. LIBRE DE CLORO Y FOSFATOS Y ALCALIS. NO CORROSIVO. NO TOXICO.
2502351	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES FRASCOx1000ml	SOLUCION DETERGENTE BIODEGRADABLE. CON AGENTES POTENCIADORES
2502721	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE SUELO Y SUPERFICIE GARRAFx5000ml	SOLUCION DETERGENTE BIODEGRADABLE. CON AGENTES POTENCIADORES
2501103	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE UNIVERSAL NEUTRO SIN FOSFATOS. GARRAFA x 3 LITROS	SOLUCION DETERGENTE NEUTRO. SIN FOSFATOS. DESINFECTANTE Y BACTERICIDA
2503206	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	DETERGENTE NEUTRO PARA PARA SUELOS Y SUPERFICIES CON TENSIOACTIVOS ANFOTEROS Y NO IONICOS GARRAFAX5000 ML	SOLUCION DETERGENTE/LIMPIADOR NEUTRO A BASE DE TENSOACTIVOS ANFOTEROS. HUMECTANTES. BIODEGRADABLES.
2501221	42281704	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ESPONJA IMPREGNADA DETERGENTE	ESPONJA TUBULAR IMPREGNADA CON DETERGENTE PENTAENZIMATICO-ATOXICO-BIODEGRADABLE-DISEÑADA PARA ELIMINAR

							ENZIMATICO DE AMPLIO ESPECTRO DE 4 MM X 240 CM DESCARTABLE	TODOS LOS CONTAMINANTES DE LA ENVOLTURA EXTERIOR Y EL CANAL INTERIOR DE LOS ENDOSCOPIOS
2503020	42281603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	ESTERILIZANTE EN FRIO PARA INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE, DESPROTEINIZANTE	LIQUIDO DESPROTEINIZANTE DE RAPIDA ACCION, SIN FORMOL. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA. ESTERILIZANTE EN FRIO-DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL-BIODEGRADABLE-USOS-EQUIPO BIOMEDICO-INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO Y ODONTOLOGICO
2505853	51102708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	FORMOL-FORMALDEHIDO 10% SOLUCION ACUOSA INCOLORA DE OLOR FUERTE Y PENETRANTE-PRESENTACION EN FRASCO POR 200 ml	FORMOL SOLUCION ACUOSA QUE CONTIENE 10% EN PESO DE FORMALDEHIDO GASEOSO-LIQUIDO INCOLORO DE OLOR FUERTE Y PENETRANTE CUYOS VAPOPRES IRRITAN FUERTEMENTE LAS MUCOSAS-USOS-COMO DESINFECTANTE-PRESERVATIVO PARA EMBALSAMAR-REACTIVO DE LABORATORIO- PRESENTACION EN FRASCO POR 200 ml
2505781	51102708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	FORMOL-FORMALDEHIDO 10% SOLUCION ACUOSA INCOLORA DE OLOR FUERTE Y PENETRANTE-PRESENTACION EN GALON	FORMOL SOLUCION ACUOSA QUE CONTIENE 10% EN PESO DE FORMALDEHIDO GASEOSO-LIQUIDO INCOLORO DE OLOR FUERTE Y PENETRANTE CUYOS VAPOPRES IRRITAN FUERTEMENTE LAS MUCOSAS-USOS-COMO DESINFECTANTE-PRESERVATIVO PARA EMBALSAMAR-REACTIVO DE LABORATORIO- PRESENTACION EN GALON
2503406	51102708	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	FORMOL AL 37%. SOLICION ACUOSA DE FORMALDEHIDO. LIQUIDO INCOLORO DE OLOR PENETRANTE Y SOFOCANTE. GALON	FORMOL AL 37% ES UNA SOLUCION CONCENTRADA DE FORMALDEHIDO 37% SOLUCION LIQUIDA INCOLORA DE OLOR PENETRANTE-UTILIZADA COMO DESINFECTANTE-CONSERVANTE Y AGENTE DE FIJACION EN PROCESOS DE LABORATORIO-PRESENTACION EN GALON (3780ML)
2505701	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTE/ALCOHOL ETILICO FCO 1000ML	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL ETILICO FCO 1000ml. ANTISEPTICO. NO PEGAJOSO. LIBRE DE ENJUAGUE. SIN FRAGANCIA

2505707	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTE/ALCOHOL ETILICO FCO 300ML	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL ETILICO FCO 300ml. ANTISEPTICO. NO PEGAJOSO. LIBRE DE ENJUAGUE. SIN FRAGANCIA
2505559	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTE/ALCOHOL ETILICO FCO 3780ml	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL ETILICO FCO 3780ml. ANTISEPTICO. NO PEGAJOSO. LIBRE DE ENJUAGUE. SIN FRAGANCIA
2584173	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTERIAL /ALCOHOL ETILICO 60-70%-FCO 500ml.	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL ETILICO FCO 500ml. ANTISEPTICO. NO PEGAJOSO. LIBRE DE ENJUAGUE. SIN FRAGANCIA
2501310	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTERIAL /ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE Y GLICERINA-GARRAFA DE 100 ml	GEL ANTIBACTERIAL COMPUESTO POR ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE TRANSLUCIDO-INCOLORO Y GLICERINA-BIODEGRADABLE-ANTISEPTICO NO PEGAJOSO-LIBRE DE ENJUAGUE-SIN FRAGANCIA-USO-LAVADO DE MANOS-GARRAFA DE 100 ml
2505646	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTERIAL /ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE Y GLICERINA-GARRAFA DE 250 ml	GEL ANTIBACTERIAL COMPUESTO POR ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE TRANSLUCIDO-INCOLORO Y GLICERINA-BIODEGRADABLE-ANTISEPTICO NO PEGAJOSO-LIBRE DE ENJUAGUE-SIN FRAGANCIA-USO-LAVADO DE MANOS-GARRAFA DE 250 ml
2505763	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	GEL ANTIBACTERIAL /ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE Y GLICERINA-GARRAFA DE 20 LITROS	GEL ANTIBACTERIAL COMPUESTO POR ALCOHOL ETILICO USP-VEHICULO GELIFICANTE TRANSLUCIDO-INCOLORO Y GLICERINA-BIODEGRADABLE-ANTISEPTICO NO PEGAJOSO-LIBRE DE ENJUAGUE-SIN FRAGANCIA-USO-LAVADO DE MANOS-GARRAFA DE 20 LITROS
2504167	53131626	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. USO TOPICO.	GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. BACTERICIDA, TUBERCULICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA. PARA EVITAR RIESGO DE INFECCION EN SITIO QUIRURGICO

							PRESENTACION EN GALON	
2501219	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	GLUTARALDEHIDO POTENCIALIZADO 10.5% FRASCO X 1000ml	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE. CON GLUTARALDEHIDO POTENCIALIZADO 10-5% Y TENSIOACTIVOS
2502728	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	GLUTARALDHEIDO 0-05+FORMALDEHIDO 0-01+CETRIMIDA 0-05 BACTERICIDA-VIRUCIDA-ESPORICIDA. GALON	GLUTARALDHEIDO 0-0564 FORMALDHEIDO 0-0128 CETRIMIDA 0-0513. LIQUIDO TRANSLUCIDO LIGERAMENTE AZUL (SIN ACTIVACION)- O VERDE (ACTIVADO +/-1-28 MG- GLUTARAL- DEHIDO 56-4 +/- 5-64 MG- CETRIMIDA 51-3 +/- 5-13
2502923		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE PENETRANTE. PRESENTACION FRASCO DE 1000 ml	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION FRASCO DE 1000 ml
2502355		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE PENETRANTE. PRESENTACION EN GALON (3.855 ml)	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION EN GALON (3.785 ml)
2503859		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25-5.6% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE PENETRANTE. GARRAFA POR 5 LITROS	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25-5.6% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION EN GARRAFA POR 5 LITROS

2503774		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLO, LIBRE DE PARTICULAS-PRESENTACION FRASCO DE 1000 ml	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION EN FEASCO DE 1000 ml
2501114		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25-5.6%-OLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLO, LIBRE DE PARTICULAS-PRESENTACION - PRESENTACION EN GALON (3-785 ml)	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25-5.6% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION EN GALON (3.785 ml)
2505784		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 6%-OLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLO, LIBRE DE PARTICULAS-PRESENTACION - PRESENTACION EN GALON (3-785 ml)	HIPOCLORITO DE SODIO 6% (NaOcl), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARI LLO, LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE-USODESINFECCION DE MATERIAL-AREAS Y SUPERFICIESDE TIPO EXCLUSIVAMENTE INSTITUCIONAL-PRESENTACION EN GALON (3.785 ml)
2584088		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE CONTROL BACTERIOLOGICO Y MICROBIOLOGICO-	SOLUCION ACUOSA. ALCALINA. DESINFECTANTE. BLANQUEADOR. OXIDANTE. CON HIPOCLORITO DE SODIO 13%-FORMULACION LIQUIDA BALANCEADA Y ESTABILIZADA PARANDESINFECCION DE AGUAS EN TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS Y POTABILIZACION

							PRESENTACION EN GALON	
2501115		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE CONTROL BACTERIOLOGICO Y MICROBIOLOGICO-PRESENTACION CONTENEDOR TIPO GARRAFA DE 5 GALONES	SOLUCION ACUOSA. ALCALINA. DESINFECTANTE. BLANQUEADOR. OXIDANTE. CON HIPOCLORITO DE SODIO 13%-FORMULACION LIQUIDA BALANCEADA Y ESTABILIZADA PARANDESINFECCION DE AGUAS EN TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS Y POTABILIZACION-PRESNTACION CONTENEDOR TIPO GARRAFA DE 5 GALONES
2501135		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GAR	A.02.02.01.003.004	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% DE CONTROL BACTERIOLOGICO Y MICROBIOLOGICO-PRESENTACION CONTENEDOR TIPO GARRAFA DE 5 GALONES	SOLUCION ACUOSA. ALCALINA. DESINFECTANTE. BLANQUEADOR. OXIDANTE. CON HIPOCLORITO DE SODIO 15%-FORMULACION LIQUIDA BALANCEADA Y ESTABILIZADA PARANDESINFECCION DE AGUAS EN TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS Y POTABILIZACION-PRESNTACION CONTENEDOR TIPO GARRAFA DE 5 GALONES
2505908	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	JABON CLORHEXI+POLI BIGUANIDINA FCO3785ml	JABON CLORHEXIDINA+POLIBIGUANIDINA FCO3785ml. LIQUIDO TRANSPARENTE. LIBRE DE PARTICULAS. DE ALTA ESPUMACION. BIODEGRADABLE. DESINFECTACTE. ESTERIL.
2505705	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	JABON QX-CLORHEXIDI+CETRIMIDA FCOX3785ML	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA (DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO PRINCIPIO ACTIVO) 4%+CETRIMIDA. LIQUIDO TRANSPARENTE DE ALTA VISCOSIDAD. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. BIODEGRADABLE.
2502739	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLOREXIDINA 4% + CETRIMIDA, PARA LAVADO QUIRURGICO. FRASCO X 1000ML	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA. LIQUIDO TRANSPARENTE. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS Y AROMA. JABON DE AMPLIO ESPECTRO. BIODEGRADABLE. PRESENTACION FRASCO DE 120ML HASTA 1000ml. INDICADO PARA LAVADO PRE-QUIRUGICO. PROTEGIDO DE LA LUZ.

2501165	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLOREXIDINA 4% + CETRIMIDA, PARA LAVADO QUIRURGICO. FRASCO x 120ml	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA (DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO PRINCIPIO ACTIVO) 4%+CETRIMIDA. LIQUIDO TRANSPARENTE. LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO. BIODEGRADABLE. ESTERIL.
2503280	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLOREXIDINA 4% + CETRIMIDA, PARA LAVADO QUIRURGICO POR 500 ML	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO PRINCIPIO ACTIVO) 4%+CETRIMIDA. LIQUIDO TRANSPARENTE DE ALTA VISCOSIDAD, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. JABON DE AMPLIO ESPECTRO, LIBRE DE AROMA, INDICADO PARA EL LAVADO PRE-QUIRUGICO DE MANOS, ANTISEPSIA DE PIEL, LAVADO DE HERIDAS INFECTADAS Y NO INFECTADAS, LACERACIONES, PACIENTES QUEMADOS. MANTENGASE BIEN TAPADO Y PROTEGIDO DE LA LUZ. BIODEGRADABLE. PRESENTACION FRASCO POR 500ml
2505926	53131608	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	JABON A BASE DE ACIDO LACTICO + NANOMATERIALES TRIENZIMATICO - PRESENTACION GALON	AC- LACTICO+NANOMATERIALES+TRIE JABON GALON COMPUESTO CON ACIDO LACTICO- ACIDO TRIETANOLAMINA- TRIETHANOLAMINE POLISORBATO- POLISORBATE AGUA DESTILADA-AQUA NANOMATERIALES- ZINC OXIDE NANOMATERIALES- CUPRIC OXIDE NANOMATERIALES - TITANIUM OXIDE ACEITE ESENCIAL DE LIMONCILLO- LEMONGRASS ESSENTIAL OIL CYMBOPOGON ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO- THYME OIL BIOPOLIMEROS NATURALES- NATURAL BIOPOLYMERS APARIENCIA / ASPECTO LIQUIDO COLOR LIGERAMENTE BLANQUESINO OLOR AGRADABLE / FRESCO PH. 5– 6 CODIGOTO DE FUSION / RANGO 0 °C CODIGOTO DE EBULLICION/ RANGO 100 °C CODIGOTO DE INFLAMABILIDAD NO APLICA PRESION DE VAPOR SIMILAR AL AGUA SOLUBILIDAD / SOLUBILIDAD EN OTROS SOLVENTES COMPLETAMENTE SOLUBLE VISCOSIDAD DENSIDAD
2503137	42312311	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	KIT	A.02.02.01.003.004	KIT DE LIMPIEZA PARA COLONOSCOPIO	KIT DE LIMPIEZA PARA COLONOSCOPIO: 1 CEPILLO FLEXIBLE DE NYLON. CEPILLO DE DOBLE CABEZA. CEPILLO DE LIMPIEZA Y ESPONJA DE SECADO. 1 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE VALVULA DE DOBLE CABEZA. CON CEPILLO DE CERDAS PARA AFLORA Y ELIMINAR LA CARGA BIOLOGICA. BOLSA DE TRANSPORTE

2584200	42312311	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO	KIT DE LIMPIEZA CEPILLOS INDIVIDUALES: 1 CEPILLO CORTO DOBLE. 1 CEPILLO CONICO. 1 CEPILLO CORTO. 1 CEPILLO FLEXIBLE DE NYLON DOBLE CODIGO CON CERDAS.
2502357	42312311	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	KIT	A.02.02.01.003.004	KIT LUBRICACION INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIO	LUBRICANTE DE ORIGEN VEGETAL SOLUBLE EN AGUA. JUEGO DE CEPILLOS LARGOS FLEXIBLES
2505570	761219	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	KIT	A.02.02.01.003.004	KIT PARA INACTIVAR DERRAMES BIOLOGICOS	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DEL KIT. BENZIRAL DE 60 ML. DETERGENTE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR. GUANTES DE CAUCHO. BOLSA ROJA CONTRAMARCADA CON RIESGO BIOLOGICO. SOBRE SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS X 35 G. RECOGEDOR Y ESCOBILLA. 1 PANO ABSORBENTE. TAPABOCAS INDUSTRIALES (DESECHABLES). PROTOCOLO DE INACTIVACION DE DERRAMES. CINTA DE ACORDONAMIENTO / AISLAMIENTO. CADA PRODUCTO TIENE UNA VIDA UTIL DIFERENTE
2501222	42281701	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR AUTOCLAVE-SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PARA AUTOCLAVES X 500 ml	LIQUIDO COMPUESTO POR ACIDO FOSFORICO, PROPYLGLICOLETHE, DETERGENTE NO IONICO Y AGUA-REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION EN AUTOCLAVES - FRASCO X 500ml
2503712	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES X 750ml CON PULVERIZADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES ELEVADAS/ALTO NIVEL A BASE DE ALCOHOL ETILICO + CLORURO DE ALQUILBENCILDIMETILAMONIO. ASOCIAC ADHESIVA, LIMPIA SIN DAÑAR LAS SUPERFICIES. BIODEGRADABLE, NO CORROSIVO, NO IRRITA LA PIEL. ACTIVO CONTRA: C. DIFFICILE Y NOROVIRUS. 750ml
2502800	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES X 750ml CON PULVERIZADOR	FRASCO CON PULVERIZADOR ESPUMOSO COMPUESTO DE PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO, ACETATO DE GUANIDINIO, N-PROPANOL, TENSIONACTIVO NOI MEDICOS, SUPERFICIES DE AREAS DE ALTO RIESGO, NO CONTIENE SUSTANCIAS CRM, SIN PERFUME NI ALCOHOL AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO
2584725	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR DESINFECTANTE SUPERFICIES X GALON	BACTERICIDA EN CONDICIONES DE SUCIEDAD, TUBERCULOSIDA, FUNGICIDA, ACTIVO SOBRE VIH, ROTAVIRUS Y HERPES VIRUS.CLORURO DIMETIL AMONIO, EN SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS.

								CON O SIN DISPENSADOR SIN GAS PROPELENTE, RECARGABLE X GALON
2584137	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES X5LITROS	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DURAS NO POROSAS, BACTERICIDA EN CONDICIONES DE SUCIEDAD, TUBERCULOSIDA, FUNGICIDA, ACTIVO SOBRE VIH, R DIDECILMETILAMONIO X5LITROS
2502727	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 500 CC	FRASCO CON PULVERIZADOR ESPUMOSO, COMPUESTO POR PROPIONATO DE GUANIDINION-PROPANOL, TENSIOACTIVO NO IONICO. PERFUME Y EXCIPIENTES A CONTACTO DE 500 CC
2503123	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS X 750ML	FRASCO CON PULVERIZADOR ESPUMOSO, COMPUESTO POR PROPIONATO DE GUANIDINION-PROPANOL, TENSIOACTIVO NO IONICO. PERFUME Y EXCIPIENTES A CONTACTO DE 750 CC
2502352	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO + OTROS X GALON	LIMPIADOR RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS COMPUESTO DE PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO, ACETATO DE GUANIDINO, N-PROPANOL, TENSIOACTIVO X GALON
2502057	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	LIMPIADOR ULTRASONICO FCO 473ml	QUE ELIMINE CONTAMINANTES COMO SANGRE, SALIVA Y RESIDUOS. PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL, CORONAS, PUENTES, DENTADURAS Y CODIGOS DE CA-ULTRASONIDO
2500541	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	LIQUIDO ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSION X GALON	LIQUIDO ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSION: LIQUIDO CLARO, OLOR SUAVE, pH 1 SOLUCION ACIDA QUE ELIMINE ACIDO, SOLUBLE EN AGUA, REMUEVEM PRESENTACION EN GALON
2500543	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	GLN	A.02.02.01.003.004	LIQUIDO LUBRICANTE E INHIBIDOR DE OXIDO. GALON	LIQUIDO LUBRICANTE E INHIBIDOR DE OXIDO LUBRICANTE BACTERIOSTATICO DE ACEITE MINERAL NO CORROSIVO SIN SILICONA NO PEGAJOSO EFECTIVO NEUTRO. X GALON

2503147	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	PAÑO ABSORBENTE ANTIBACTERIAL ROLLO DE 42X28CM	PAÑO ABSORBENTE ANTIBACTERIAL ROLLO, PRECORTADO, ES UN PAÑO DE ALTA RESISTENCIA, GRAN ABSORCION Y DURABILIDAD, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES CORTANTES, RUGOSAS Y ABRASIVAS. SE DESEMPEÑA MUY BIEN PARA LIMPIAR LIQUIDOS, ACEITES Y GRASAS. SU PRESENTACION ES UN ROLLO DE 80 PAÑOS BLANCOS, DE 42 CMS X 28 CMS, MUY REUTILIZABLE. SE PUEDE LAVAR DESPUES DE CADA USO, UTILIZANDO DETERGENTES. NO SE RECOMIENDA DEJAR EN REMOJO.
2505554	42281800	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	PAQUETE DE PRUEBA PARA ESTERILIZACION A VAPOR-PRESENTACION 16 PAQUETES+4CONTROLES BIOLOGICOS	PAQUETE DE PRUEBA CERTIFICADO BAJO EL ESTANDAR DE USO- PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACION DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL I RAPIDA. REF 41382
2503981		ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PARA AUTOCLAVES. FRASCO SPRAY X 650ML	DETERGENTE, PARA AUTOCLAVE Y UNIDAD DE ULTRASONIDOS LIMPIADOR AUTOCLAVE: DETERGENTE NO IONICO Y AGUA. REMOVEDOR DE OXIDO Y CORROSION PARA AUTOCLAVES A VAPOR EN ACERO INOXIDABLE, EFECTI FRASCO SPRAY DE 650ml
2504344	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCION DE AGUA SUPER OXIDADA-PRESENTACION GARRAFA POR 5 LITROS.	SOLUCION DE AGUA CON POTENCIAL DE OXIDACION-REDUCCION, DESINFECTANTE, ANTISEPTICA, BIOCIDA-PRINCIPIOS ACTIVOS: AGUA SUPEROXIDADA, CLORURO DE SODIO (NACL), ACIDO HIPOCLOROSO (HOCL)-USO DIARIO-PRESENTACION GARRAFA DE 5 LITROS
2505894	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	SOLUCION ANTIBACTERIAL /ALCOHOL<1% 100ml	SOLUCION ANTIBACTERIAL/ALCOHOL1% 100ml COMPONENETES: GRADUACION ALCOHOLICA % ACIDO LACTICO, ACIDO FORMICO, AGRIOS GRANDIS (POMELO) EXTRACTO ACEITE DE THYMUS VULGARIS, ACEITE DE RICINO HIDROGENADO PEG-40, MENTOL, MEZCLA DE TENSOACTIVOS NO IÒNICOS Y ANFOTERICOS, TRIETANOLAMINA, COLORANTE REGISTRO SANITARIO NSOC01783-20CO
2502804	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	SOLUCION DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1% ALCOHOL	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1%, ALCOHOL ETILICO AL 61% Y AGENTES HUMECTANTES. BACTERICIDA. GERMICIDA. ANTISEPTICO.

							ETILICO AL 61% X 500 CC	
2584128	42281506	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	RENOVADOR INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE GLN	SUSTANCIA QUE ELIMINA LOS RASTROS PROTEICOS, DEPOSITOS DE HIERRO Y MANCHAS DE OXIDO. COMPOSICION: ACIDO FOSFORICO, TENSIOACTIVOS NOIONICOS SE ENCARGA DE PULIR 1 GLN
2501220	42281506	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE. FRASCO X 1000ml CON VALVULA DOSIFICADORA	SUSTANCIA QUE ELIMINA LOS RASTROS PROTEICOS, DEPOSITOS DE HIERRO Y MANCHAS DE OXIDO. COMPOSICION: ACIDO FOSFORICO, TENSIOACTIVOS NOIONICOS SE ENCARGA DE PULIR 1 LT
2505825	42281800	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	TIRA INDICADORA GLUTARALDEHIDO FCO X100	TIRA INDICADORA GLUTARALDEHIDO ES UN LAMINA DE PAPEL RECTANGULAR QUE CUENTAN CON UNA ALMOHADILLA REACTIVA EN UNO DE SUS EXTREMOS-PERMITE LA DETERMINACION DE GLUTARALDEHIDO DE FORMA RAPIDA Y CONFIABLE-PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN CUANTO A VALIDACION DE PROCESOS DE DESINFECCION Y VERIFICACION DE LA CONCENTRACION DEL PRINCIPIO ACTIVO EN LAS SOLUCIONES DESINFECTANTES REUSABLES
2584031	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	TOALLA ALCOHOLADA ANTISEPTICA+ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	TOALLA ALCOHOLADA ANTISEPTICA. UTILIZADA COMO ANTISEPTICO PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL ANTES DE LA INYECION O LA EXTRACCION DE SANGRE ANTIBACTERIANA 30x64 mm
2501046	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	TOALLA ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO PARA DESINFECCION. EMPAQUE INDIVIDUAL	SOPAÑIN ES UNA TOALLA ANTISEPTICA EN SACHET INDIVIDUAL IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. ES UN ANTISEPTICO DE USO EXTERNO- QUE POR EL AMPLIO ESPECTRO DE SU PRINCIPIO ACTIVO PROPORCIONA UN EFECTO MICROBICIDA INSTANTANEO SOBRE LA PIEL. SU EMPAQUE ES SEGURO- POR LO QUE NUNCA ESTA EXPUESTO A GERMENES Y BACTERIAS- E TAL MANERA QUE NO PIERDE SU ACTIVIDAD. CON ESTE PRODUCTO SE MINIMIZA EL RIESGO DE INFECCION- ES DE FACIL MANEJO Y NO IRRITA LA PIEL.

2502695	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	TOALLAS DESINFECTANTES ALCOHOL+AMONIOS	TOALLAS EN BOLSA DE SEGURIDAD PARA USAR SIN ALDEHIDO CON ALCOHOL + AMONIOS CUATERNARIOS- PARA LIMPIEZA DE LA PIEL ANTE UNA CODIGO DE ALGUN OBJETO CODIGOZOCORTANTE- UTIL EN EL HOGAR-AMBULANCIAS-HOSPITALES- CONSULTORIOS - LABORATORIO Y DESINFECTA DEJANDO MINIMOS RESIDUOS
2503161	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	TOALLAS DESINFECTANTES SIN ALCOHOL	TOALLAS EN BOLSA DE SEGURIDAD PARA USAR SIN ALCOHOL Y ALDEHIDO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN UN MINUTO, PARA SUPERFICIES PLASTICAS CO VIRUCIDA PAQUETE X 100 UNIDADES
2504022	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	TRICLOSAN 0.2 %+AC LACTICO JABON ANTISEPTICO LIQUIDO. GALON	TRICLOSAN 0.2 %+AC LACTICO JABON ANTISEPTICO LIQUIDO. COMPONENTES: TRICLOSAN 0.2%, ACIDO LACTICO, EXCIPIENTES. ASPECTO FISICO: LIQUI CONPROPIEDADES ANTISEPTICAS POR SU CONTENIDO DE TRICLOSAN SEGUN NORMA FARMACOLOGICA 13.1.6.0.N10, COMO ANTISEPTICO Y DESINFECTANTEE SA
2505581	42281604	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	FCO	A.02.02.01.003.004	TRICLOSAN 0.2%+ACLACTICO JABON FCO 500ML	TRICLOSAN 0.2% + ACLACTICO JABON FRASCO DE 500ml JABON ANTISEPTICO LIQUIDO. COMPONENTES: TRICLOSAN 0.2%, ACIDO LACTICO, EXCIPIENTES. ASPECTO FISICO: LIQUIDO CON PROPIEDADES ANTISEPTICAS POR SU CONTENIDO DE TRICLOSAN. EMULSIONANTE DE ACCION GERMICIDA QUE LIMPIA LA PIEL REMOVIENDO LA SUCIEDAD, BACTERIAS, CELULAS MUERTAS, Y GRASA
2504538	42281603	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-9	C/U	A.02.02.01.003.004	VASO PEROXIDO DE HIDROGENO 59% 3/45CICLOS-AGENTE ESTERILIZANTE - BIODEGRADABLE-PRESENTACION-VASO/TAZA POR 15 CICLOS	AGENTE ESTERILIZANTE A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 59%. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONCENTRACION % de H2O23 58,4 - 59,4. ESTADO CUMPLELAS NORMAS USA EPA REGISTRATION N.º. (EPA Reg. N.º 1043-123). APLICACIONES: DESCONTAMINACION DE SALAS, AISLADORES, EXCLUSAS DE 15

BORDELINE								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2505281	42311600	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO AGENTE HEMOSTATICO 22X12CM (5X9") RAYON 70%	APOSITO AGENTE HEMOSTATICO 22x12CM (5X9" APOSITO CON AGENTE HEMOSTATICO – TEJIDO DE GASA CON RAYON 70% Y POLIESTER 25% -CM. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2502731	51211615	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	FCO	A.02.02.01.003.005	AZUL DE METILENO/CLORURO DE METILTIONINA X 500ML. COLORANTE, ANTISEPTICO, MEDICAMENTO. FRASCO POR 500ml	AZUL DE METILENO CUYO NOMBRE CIENTIFICO ES CLORURO DE METILTIONINA. COMPUESTO QUIMICO HETEROCICLICO AROMATICO CON FORMULA MOLECULAR ESTABLE AL AIRE.SOLUBLE ENAGUA Y EN CLOROFORMO, MODERADAMENE SOLUBLE EN ALCOHOL. USO: COMO TINTURAPARA TEÑIR CIERTAS PARTES DEL CUERPO, MEDICAMENTO, FRASCO POR 500ml
2584083	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO MICROFIBRILAR 2.5 X 5 CM	AGENTE HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE, COMPUESTO DE SAL DE COLAGENO DE CORION BOVINO PURIFICADO. PRESENTA ESTRUCTURA MICROFIBRILAR, Q HEMORRAGIAPOSTOPERATORIA
2504476	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 10X12CM. DE COLAGENO PURIFICADO Y LIOFILIZADO, PROPORCIONA UNA MATRIZ PARA LA ADHERENCIA DEL COAGU	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 10x12cm. DE COLAGENO PURIFICADO Y LIOFILIZADO, QUE PROPORCIONA UNA MATRIZ PARA LA ADHERENCIA DEL CO INTRAOPERATORIO.
2504471	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 6X8CM. DE COLAGENO PURIFICADO Y LIOFILIZADO, PROPORCIONA UNA MATRIZ PARA LA	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 6x8cm. DE COLAGENO PURIFICADO Y LIOFILIZADO, QUE PROPORCIONA UNA MATRIZ PARA LA ADHERENCIA DEL COAG INTRAOPERATORIO.

							ADHERENCIA DEL COAGULO	
2505974	42181503	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	GASA DE MALLA FINA IMPREGNADA CON PETROLATO BLANCO (VASELINA) de 7.6 cm X 45.7 cm	APOSITO IMPREGANDO DE PETROLATO (VASELINA) PARA MANTENER LA HUMEDAD Y MINIMIZAR EL SECADO Y LA ADHERENCIA DE LA HERIDA-QUE SE ADAPTE A LOS CONTORNOS DEL CUERPO PARA SELLAR LAS FUGAS DE AIRES Y LA PERDIDA DE LIQUIDOS-NO TOXICO-NO IRRITANTE PARA USAR EN SITIOS DE INJERTO DE PIEL, TRATAMIENTO DE QUEMADURAS Y ABRASIONES ENTRE OTROS
2504220	42312400	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	GEL CON MIEL ACTIVA LEPTOSPERMUM 100% EN TUBO 42.5 GR	PASTA EN GEL CON MIEL ACTIVA LEPTOSPERMUM 100% EN TUBO 42.5 GR
2504474	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDADA MALLA 10CMX12CM.DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENEDA OXIDADA MALLA 10CMX12Cm. DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA, VELOCIDAD DE ABSORCION CONTR PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS, PARA AYUDAR A CONTROLAR LA HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA Y DE ARTERIAS PEQUEÑAS. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL
2504475	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDADA MALLA 10CMX20CM.DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENEDA OXIDADA MALLA 10CMX20Cm. DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA, VELOCIDAD DE ABSORCION CONTR PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS, PARA AYUDAR A CONTROLAR LA HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA Y DE ARTERIAS PEQUEÑAS. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL

2504473	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDADA MALLA 2.5CMX5CM.DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENEDA OXIDADA MALLA 2.5CMX5cm. DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA, VELOCIDAD DE ABSORCION CONTR PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS, PARA AYUDAR A CONTROLAR LA HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA Y DE ARTERIAS PEQUEÑAS. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL
2504472	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDADA MALLA 10CMX10CM.DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENEDA OXIDADA MALLA 10cmX10cm. DE ORIGEN VEGETAL, HEMOSTASIA RAPIDA, VELOCIDAD DE ABSORCION CONTR PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS, PARA AYUDAR A CONTROLAR LA HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA Y DE ARTERIAS PEQUEÑAS. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL
2502302	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	FCO	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERABLE MALLA 5CMX10CM	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENEDA OXIDADA MALLA 5CMX10Cm. DE ORIGEN VEGETAL. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL. PARA CONTROLAR HEMORRAGIAS
2504221	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO A BASE DE POLIMERO DE POLIACRILATO TUBO POR 25G	APOSITO EN HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO A BASE DE POLIMERO DE POLIACRILATO, AGUA, GLICERINA, SODIO EDTA, HIDROXIDO DE SODIO. AYUDA AL DESBRIDAMIENTO
2502943	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	KIT DE MATRIZ DE GELATINA HEMOSTATICA BIOABSORBIBLE	KIT DE MATRIZ DE GELATINA HEMOSTATICA BIOABSORBIBLE (02 JERINGAS, UNION, RECIPIENTE, ACTIVADOR)

2504477	51131810	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-002-10	C/U	A.02.02.01.003.005	SELLADOR DE FIBRINA HUMANA 1ML. SELLANTE PARA CIRUGIA COMPUESTO POR FIBRINA Y COLAGENO HUMANO. PROPORCIONA HEMOSTASIA SOSTENIDA	SELLADOR DE FIBRINA HUMANA 1ml. SELLANTE PARA CIRUGIA COMPUESTO POR FIBRINA Y COLAGENO HUMANO. PROPORCIONA HEMOSTASIA SOSTENIDA, CON PACIENTE.

MATERIAL ODONTOLOGICO
CIRUGIA ORAL - V1

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502913	42152508	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4mm) Y LONGITUD ENTRE 16-35 mm. CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO 0.4 mm) Y LONGITUD ENTRE 15-22 mm- CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- BISEL (LARGO- MEDIO O CORTO)- PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE CODIGOTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO.
2502129	42152508	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3mm) Y LONGITUD ENTRE 16-22 mm- CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3 mm) Y LONGITUD ENTRE 16-25 mm. CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- BISEL (LARGO- MEDIO O CORTO)- PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE CODIGOTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO.
2503044	42221512	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA DE APSPIRACION QUIRURGICA DESECHABLE	CANULA QUIRURGICA DE UNA VIA- DE 2-5 Y 4-8 mm DE DIAMETRO- CON UNA LONGITUD DE LA CANULA DE APROXIMADA DE 13.5- 17 CM. ELABORADA EN POLIPROPILENO

2501280	42312301	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA COLAGENO PARA EXODONCIA 5X5 CM. DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA)-LIOFILIZADO. ESTERIL. EMPAQUE BLISTER POR 10 UNIDADES	ESPONJA COLAGENO PARA EXODONCIA 5x5 cm. DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA)-LIOFILIZADO. ESTERIL. ESPONJA HEMOSTATICA ABOSORBIBLE A BASE DE GELATINA FARMACEUTICA PURA. ABSROBE ENTRE 40-50 VECES SU PROPIO PESO. PROTEGE Y ACELERA EL PROCESO DE CICATRIZACION. USO:PR OCESOS POST EXODONCIA. EMPAQUE BLISTER POR 10 UNIDADES
2501944	42293902	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA ESTERIL-HEMOSTATICA-GELATINA DE PLATA COLOIDAL-POSTEXODONCIA. FRASCO POR 50 UNIDADES	ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE-COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA Y POLVO DE PLATA (COLOIDAL)- QUE LE DA UN EFECTO ANTIB ACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA DE PLATA COLOIDAL FINAMENTE DISPERSA- ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICI AL RAPIDA-AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO-ESTABILIZACION DEL COAGULO- EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTRIL. PRESENTACION: F RASCO POR 50 UNIDADES (14x7x7). REF1: RO274007
2503481	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.003.006	FERULA DE GUIA DE BROCADO OSEO (ACRILICA)	FERULA DE GUIA DE BROCADO OSEO (ACRILICA): GUIA QUIRURGICA EN ACRILICO PARA LA COLOCACION DE IMPLANTES
2505577	4813001	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#170L CABEZA LARGA Y CORTE LISO	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#170L REF. 500 314 171 006
2505578	4813001	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO TUNGSTENO HP#170L (44.5mm) CABEZA LARGA DE CORTE LISO	FRESA CARBURO TUNGSTENO HP#170L (44.5mm) REF. 500 104 171 006
2501981	4813001	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA QUIRURGICA TALLO LARGO REF 702 UNIDAD	FRESA CARBURO TUNGSTENO HP#702 T/LARGO REF. 500 104 168 007 016

2501982	4813001	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA QUIRURGICA TALLO LARGO REF 703 UNIDAD	FRESA CARBURO TUNGSTENO HP#703 T/LARGO REF. 500 104 168 007 021
2501976	4813001	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA ZECRYA UNIDAD	FRESA PARA CIRUGIA ORAL- CONICA- FILOS HELICOIDALES- AUTOCLAVABLE- CODIGO ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO-HEMISFERICO Y CORTANTE- PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD- PARTE ACTIVA DE 11 mm- CUMPLA NORMA ISO 3823-1
2502973	42152507	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.003.005	GASA/ESPONJA DE 4 DOBLECES- ABSORBENTE PARA EXODONCIA- NO ESTERIL. PAQUETE DE 200 UNIDADES	GASA/ESPONJA DE 4 DOBLECES- ABSORBENTE PARA EXODONCIA 5 X 5CM NO ESTERIL- NO MOTAS NI HILACHAS- NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS- QUE PERMITA LA APLICACION DE UNGUENTOS Y DESINFECTANTES. PAQUETE POR 200 UNIDADES. REF1:mm0016
2501987	51131806	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	FCO	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO- SULFATO FERRICO FRASCO X 15ML	SOLUCION HEMOSTATICA DE SULFATO FERRICO DEL 13% AL 20%- PARA CONTROL DE SANGRADO LEVE DE LOS TEJIDOS GINGIVALES DURANTE PROCEDIMIENT OS OPERATORIOS. GEL CON LIGERO OLOR A ACERO- PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA- SENSIBLE A LA LUZ. FRASCO DE 15ML
2502991	42151806	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	C/U	A.02.02.01.004.001	LIJA ABRASIVA METALICA X 4 mm- CON GRANOS ABRASIVOS	TIRA METALICA EN ACERO GRADO MEDICO DE ALTA RESISTENCIA; DELGADA- FLEXIBLE- EN DOS TAMAÑOS DE GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN LA PREPARACION MANUAL DEL ESPACIO INTERPROXIMAL- ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METALICA. TAMAÑO: 4-6mm. USO: IDEAL PARA PROCEDIMIENTOS ORTODONTICOS- PULIDOS INTERPROXIMALES. AUTOCLAVABLES.
2503089	51141619	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	FCO	A.02.02.01.003.005	PASTA FIBRINA SINTETICA- HEMOSTATICO FRASCO DE 10-12G. PASTA BLANDA HOMOGENEA COLOR AMBAR	PASTA BLANDA HOMOGENEA- DE TEXTURA CREMOSA- COLOR AMBAR- OLOR CARACTERISTICO A EUGENOL- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. INDICADA EN EL TRATAIENTO PREVENTIVO O CURATIVO DE LA ALVEOLITIS. PRESNTACION FRASCO DE 10-12g
2505901	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-1	PK	A.02.02.01.003.006	TUBO DE IRRIGACION PARA CONSOLA QX PK X5	TUBO DE IRRIGACION PARA CONSOLA QX PK X5 RQ.

ENDODONCIA								
Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500863	42142525	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS RADICULARES- USO ENDOCONTICO. AGUJA CALIBRE 27 G (GAUGE). CAJA 20-30 UNIDADES	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES- USO ENDODONTICO- CANULA EN ACERO INOXIDABLE- ALTAMENTE FLEXIBLE- CODIGO INACTIVA- IRRIGACION LATERAL- PARA PREVENIR EL DISPENSADO DE QUIMICOS MAS ALLA DEL APICE. TAMAÑO 27 G- ESTANDARIZADO ISO 35 Y 45. COMPATIBLE CON LA JERINGA PARA IRRIGAR CONDUCTOS OFERTADA
2501142	9110	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	TUB	A.02.02.01.003.005	CEMENTO DE RETROSELLADO CON SUPER EBA KIT	CEMENTO DE RETROSELLADO CON SUPER EBA KIT- DE USO ENDODONTICO
2501143	42152423	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	KIT	A.02.02.01.003.005	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR- A BASE DE RESINA EPOXICA. KIT CON TUBO A 4 gr Y TUBO B 4 gr- LENTULO Y BLOCK DE MEZCLA	CEMENTO ENDODONTICO A BASE DE RESINA EPOXICA PARA EL SELLADO DE CONDUCTOS RADICULARES- DE FRAGUADO LENTO. COMPOSICION- RESINA EPOXICA- OXIDO DE ZIRCONIO- OXIDO DE HIERRO- PASTA AMINA- ACEITE DE SILICONA ENTRE OTROS. BIOCOMPATIBLE- SIN EUGENOL POR LO CUAL NO AFECTA LA POLIMERIZACION DE COMPOSITE Y ADHESIVOS. PRESENTACION- KIT CON TUBO DE PASTA A 4 gr + TUBO DE PASTA B 4 gr. LENTULO Y BLOCK DE MEZCLA.
2501905	42152423	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	TUB	A.02.02.01.003.005	CEMENTO PARA OBTURAR CONDUCTO RADICULAR KIT (PASTA TUBO DE 12 gr BASE- CATALIZADOR DE 12-18 gr	CEMENTO OBTURAR CONDUCTO RADICULAR KIT. CEMENTO PARA OBTURAR CONDUCTO RADICULAR A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO POLIMERICO- SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES. COMPONENTES- OXIDO DE CALCIO Y RESINAS DE TRIMETILOLPROPANO- SALICILATO DE NEOPENTILGLICOL Y SALICILATO DEI SOBUTILO. CARACTERISTICAS- RADIOPACO- BAJA SOLUBILIDAD EN LIQUIDOS TISULARES- FACILDE MEZCLAR- DE APLICACION FACIL- NO MANCHA LA ESTRUCTURA DEL DIENTE. SIN EUGENOL. PRESENTACION- KIT DE UN TUBO DE 12 gr DE BASE Y UN TUBO DE 12 gr CATALIZADOR.

2502922	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONO DE GUTAPERCHA F1- COMPATIBLE CON EL SISTEMA PRO TAPER	ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DEL SISTEMA PRO TAPER- SIENDO IGUAL EN CODIFICACION DE COLOR Y TAMAÑO AL DE LAS LIMAS. COMPUESTOS POR OXIDO DE ZINC- GUTAPERCHA- SULFATO DE BARIO Y COLORANTES ENTRE OTROS
2501914	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 15 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRERSPONDIENTE- BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL
2501921	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 1A SERIE CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE- BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS
2501915	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 20 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR GUIA CROMATICA ISO- BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS (120 Pcs)- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIONES. EN TUBOS INDIVIDU ALES ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA
2501916	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 25 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRERSPONDIENTE- BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL
2502742	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 45 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630 Y SEGUN COLOR GUIA CROMATICA ISO- BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS (120 Pcs)- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIONES. EN TUBOS INDIVIDUALES.
2501917	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC- AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO.

							30 mm CAJA X 6 TUBOS	ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRERSPONDIENTE-BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL
2501918	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 35 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC-AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRERSPONDIENTE-BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL
2501919	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 40 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC-AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630/6877 Y SEGUN COLOR DE LA LIMA CORRERSPONDIENTE-BIOCOMPATIBLES- RADIOPACOS- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACION. COMPATIBLES CON LAS LIMAS OFERTADAS. EMPAQUE EN TUBO INDIVIDUAL
2501920	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.003.005	CONO GUTAPERCHA 45 mm CAJA X 6 TUBOS	CONTENIDO- GUTAPERCHA- OXIDO DE ZINC-AGENTES COLORANTES Y LIBRE DE CADMIO. ESTANDARIZADOS SEGUN ISO 3630 Y SEGUN COLOR GUIA CROMATICA ISO- BIOCOMPATIBLES-RADIOPACOS (120 Pcs)- FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIONES. EN TUBOS INDIVIDUALES.
2502917	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA F1-F3	ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DEL SISTEMA PRO TAPER.ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DELS ISTEMA PRO TAPER-SIENDO IGUAL EN CODIFICACION DE COLOR Y TAMAÑO AL DE LAS LIMAS. COMPUESTOS POR OXIDO DE ZINC- GUTAPERCHA- SULFATO DE BARIO Y COLORANTES ENTRE OTROS
2502921	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA F4-F5-COMPATIBLES CON EL SISTEMA PRO TAPER	ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DEL SISTEMA PRO TAPER. ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DEL SISTEMA PRO TAPER- SIENDO IGUAL EN CODIFICACION DE COLOR Y TAMAÑO AL DE LAS LIMAS. COMPUESTOS POR OXIDO DE ZINC-GUTAPERCHA- SULFATO DE BARIO Y COLORANTES ENTRE OTROS

2505213	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA LARGE	CONOS DE GUTAPERCHA LARGE
2505212	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA MEDIUM	CONOS DE GUTAPERCHA MEDIUM
2505211	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA PRIMARY	CONOS DE GUTAPERCHA PRIMARY
2505210	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUTAPERCHA SMALL	CONOS DE GUTAPERCHA SMALL
2503094	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	CONOS DE GUATAPERCHA SISTEMA WAVEONE PARA LIMAS DE GIRO ALTERNO CAJA POR 60 UNIDADES	CONOS GUATAPERCHA PARA LIMAS DE GIRO ALTERNO. CAJA POR 60 UNIDADES
2501923	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	CONOS DE PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIE CAJA X 200 UNIDADES	CONOS DE PAPEL ESTERILES- ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGUN LIMAS- (PRIMERA SERIE)- EMPAQUE RIGIDO RESISTENTTE A LA HUMEAD Y A L A LUZ- QUE NO PERMITA CONTAMINACION DEL CONTENIDO CAJA X 120 - 200 UNIDADES
2501924	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	CONOS DE PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 2A SERIE	CONOS DE PAPEL ESTERILES- ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGUN LIMAS- (SEGUNDA SERIE)- EMPAQUE RIGIDO RESISTENTTE A LA HUMEAD Y A L A LUZ- QUE NO PERMITA CONTAMINACION DEL CONTENIDO CAJA X 200 UNIDADES
2503095	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	CONOS DE PAPEL PARA LIMAS DE GIRO ALTERNO. CAJA POR 180 UNIDADES	CONOS DE PAPEL PARA LIMAS DE GIRO ALTERNO. CAJA POR 180 UNIDADES
2502905	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	PUNTAS DE PAPEL PARA EL SECADO DE CONDUCTOS RADICULARES	CODIGOS DE PAPEL PARA EL SECADO DE CONDUCTOS RADICULARES DEL SISTEMA PROTAPER-ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE CON EL SISTEMA
2502908	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	PUNTAS DE PAPEL PARA EL SECADO DE	CODIGOS DE PAPEL PARA EL SECADO DE CONDUCTOS RADICULARES DEL SISTEMA

							CONDUCTOS RADICULARES	PROTAPER-ESTANDARIZADO Y COMPATIBLE CON EL SISTEMA
2501930	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	DESENSIBILIZANTE DENTINAL FCO 5ml	DESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI-INFLAMATORIO/ANTISEPTICO TOPICO. CON INGREDIENTE ACTIVO- PARACLOROFENOL ALCANFORADO/PREDNISOLONA.
2502988	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	EDTA DISODICO AL 17% FRASCO/120 ml	ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO- LIQUIDO TRANSPARENTE INODORO LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. SOLUCION QUELANTE- USADA EN LA INSTRUMEN TACION DENTINAL
2503090	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	ESPACIADOR DIGITAL 20 mm SURTIDOS- CAJA POR 6 UNIDADES	ESPACIADOR EN NIQUEL-TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE- PARA LA CONDENSACION LATERAL DE LA GUTAPERCHA- FLEXIBLE PARA LA APLICACION DE ALTA PRESICION LATERAL EN CANALES CURVADOS- SUPERFICIE LISA- N° 20 mm DE LONGITUD- TAMAÑOS DEL 15 AL 40- SEGUN NORMA ISO. CAJA POR 6 UNI DADES
2503042	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	ESPACIADOR DIGITAL 25 mm SURTIDOS- EN NIQUEL TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE	ESPACIADOR EN NIQUEL-TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE- PARA LA CONDENSACION LATERAL DE LA GUTAPERCHA- FLEXIBLE PARA LA APLICACION DE ALTA PRESCIION LATERAL EN CANALES CURVADOS- SUPERFICIE LISA- N° 25 mm DE LONGITUD- TAMAÑOS DEL 15 AL 40- SEGUN NORMA ISO. CAJA POR 6 UNI DADES
2504842	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	ESPACIADOR DIGITAL CONICO A DE 25 mm - ACERO INOXIDABLE	ESPACIADOR DIGITAL CONICO A DE 25mm. INDICADO COMO AUXILIAR EN LA OBTURACION DE CANALES RADICULARES PARA LA TECNICA DE CONDENSACIONLATERAL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE- DIN 1.4310 (AISI 302)- TENIENDO APROXIMADAMENTE- 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL
2503157	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.006	ESPONJERO PLASTICO PARA COLOCAR LIMAS- REDONDO QUE SE PUEDA ESTERILIZAR	ESPONJERO PLASTICO (CLEAN STAND). USO ESPECIFICO- ENDODONCIA PARA COLOCAR LAS LIMAS. DESCRIPCION DEL MATERIAL DE PROXIMAL A DISTAL-REDONDO- PLASTICO- DE COLOR NEGRO- AUTOCLAVABLE. COMPUESTO DE DOS PARTE LA BASE Y UNA ARGOLLA QUE VA SOBRE LA BASE PARA SOSTENER LA ESPUMA DONDE SE CLAVAN LAS LIMAS. LONGITUD TOTAL- 3 cm DE ALTO -DIAMETRO 3.5 cm MATERIA PRIMA DE FABRICACION PLASTICO. DATOS ADICIONALES DE TRATAMIENTO ESPECIAL PARA SU MANTENIMIENTO

2502131	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	EUGENOL FRASCO X 15 ml-ANTISEPTICO Y ANODINO	EUGENOL- LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO-COLOR AMARILLO CLARO-OLOR CARACTERISTICO- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO- CON PROPIEDADES ANALGESICAS- ANALGESICAS-ESCENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA
2503921	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005.02	FRESA ENDO ACCES Nº 1 DE CARBURO Y TUNGSTENO-CONICA DE DIAMENTE PLATEADO CON PUNTA REDONDA	FRESA ENDO ACCES Nº 1- DE CARBURO Y TUNGSTENO. CONICA DE DIAMANTE PLATEADO-CON CODIGO REDONDA. USO- PARA APERTURA Y DEFINCION DE LAS PAREDES DE LA CAVIDAD DISTAL.
2503922	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA ENDO ACCES Nº 2 DE CARBURO Y TUNGSTENO-CONICA DE DIAMENTE PLATEADO	FRESA ENDO ACCES Nº 2- DE CARBURO Y TUNGSTENO. CONICA DE DIAMANTE PLATEADO-CON CODIGO REDONDA. USO- PARA APERTURA Y DEFINCION DE LAS PAREDES DE LA CAVIDAD DISTAL
2503923	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA ENDO ACCES Nº 3 DE CARBURO Y TUNGSTENO-CONICA DE DIAMENTE PLATEADO	FRESA ENDO ACCES Nº 3- DE CARBURO Y TUNGSTENO. CONICA DE DIAMANTE PLATEADO-CON CODIGO REDONDA. USO- PARA APERTURA Y DEFINCION DE LAS PAREDES DE LA CAVIDAD DISTAL
2501968	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA ENDOZECRYA CON PUNTA REDONDEADA-PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD-UNIDAD	FRESA CON CODIGO REDONDEADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD- PARTE ACTIVA LARGA Y CONICA CON 6 LAMINAS HELICOIDALES-RESISTENTE A LA FRACTURA- A LA CORROSION-BAJA VIBRACION- AUTOCLAVABLE- SIN CORTE EN LA CODIGO. CUMPLA NORMA ISO 6360
2501978	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA GATES N° 1 PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD-RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360
2501979	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA GATES N° 2 PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD-RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 32 mm

2502980	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA GATES N° 3 UNIDADES	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360. EN 32 mm
2502743	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	FRESA PEESO 1 CAJA X 6 UNIDADES	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360. PRESENTACION EN la CAJA
2502744	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	FRESA PEESO 2 CAJA X 6 UNIDADES	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360. PRESENTACION EN la CAJA
2502745	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	FRESA PEESO 3 CAJA X 6 UNIDADES	FRESA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- RESISTENTE A LA FRACTURA- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION- CUMPLA NORMA ISO 6360. PRESENTACION EN la CAJA
2501985	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPA MOLAR ERUPCIONADA N° 14 - 14A UNIDAD	EN ACERO INOXIDABLE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES ERUPCIONADAS- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2505591	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS (CLAMPS) MOLARES N° W14A S/ALAS	GRAPAS (CLAMPS) MOLARES N° W14A S/ALAS PARA COLOCAR TELA DE CAUCHO. MOLARES INFERIORES. LAS HORQUILLAS PLANAS IMPIDEN LA COLISION GINGIVAL
2501179	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS DIENTES ANTERIORES N° 12 UNIDAD	EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE DIENTES ANTERIORES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2505295	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS DIENTES MOLARES INFERIOR N°7	EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE PREMOLARES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2501180	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS DIENTES PREMOLARES N°1 EN ACERO INOXIDABLE- UNIDAD	EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE PREMOLARES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2584629	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS MOLARES N° 7 Y N° 8- EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES-	EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN-A UTOCLAVABLES

							RESISTENTE A LA FRACTURA	
2501181	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	KIT	A.02.02.01.004.001	GRAPAS MOLARES TEMPORA N° W3- 2A EN ACERO INOXIDABLE- UNIDAD	EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES TEMPORALES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2501425	42152500	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS PREMOLARES N° 00-0-1-2-2A- QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLE S	GRAPAS EN ACERO INOXIDABLE MATE- PARA AISLAMIENTO TOTAL DE DIENTES ANTERIORES- RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION- RIGIDAS-QUE NO SE DEFORMEN- AUTOCLAVABLES
2501986	42151802	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	GUTAPERCHA EN BARRA CAJA X 9 UNIDADES	PARA REALIZAR PRUEBAS DE VITALIDAD
2501990	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	KIT	A.02.02.01.003.005	HIDROXIDO CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE X 12G /CATALIZADOR X 12-18G)	HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR- CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA- ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL. PRESENTACION KIT BASE 12 gr-CATALIZADR 12-18 gr
2505635	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO FCO 10 g	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO- POLVO BLANCO FINO- INODORO- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ES UN PRODUCTO QUE AL SER MEZCLADO E INTRODUCIDO EN EL FONDO DEL CONDUCTO ES FORMADOR DE DENTINA SECUNDARIA; O AL MEZCLARSE CON UN AGENTE ANESTESICO FORMA UNA PASTA HOMOGENEA- UTIL EN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES. AL SER APLICADO EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO RADICULAR- ENTRA EN CONTACTO CON EL MUÑON PULPAR- PRESERVANDO SU VITALIDAD Y ACELERANDO LA FORMACION CEMENTARIA APICAL- PRESENTACION FRASCO POR 10 gr
2503014	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA USO ODONTOLOGIC O- FRASCO DE 100 A 120 ml	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOcl)- SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS- DE OLOR CARACTERISTICO- LIBRE DE PARTICU LAS EXTRAÑAS. USO- AGENTE BACTERICIDA UTILIZADO COMO IRRIGANTE DE CONDUCTOS- POR SU pH ALCALINO ES EL DISOLVENTE MAS EFICAZ DEL TEJI DO PULPAR. PRESENTACION- FRASCO DE 100 A 120ml

2503489	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL)- SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS- USO ODONTOLOGICO. GALON	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NaOcl)- SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS- DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE- IRRITANTE- CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL- TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO
2502013	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 21 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTAR ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502014	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE- N° 15-20-25-30-35-40	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630-1 ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502015	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 28 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502016	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 31 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE- N° 15-20-25-30-35-40	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502017	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS SEGUNDA SERIE LONGITUD 21 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502054	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA SEGUNDA SERIE SURTIDA LONG 21 mm TIPO K-FLEXOFILE CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm
2502018	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS SEGUNDA SERIE LONGITUD 25 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502019	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS SEGUNDA SERIE LONGITUD 28 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502020	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS SEGUNDA SERIE LONGITUD 31 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2503093	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE GIRO ALTERNO LARGA 21-25-31 mm	LIMA EN NIQUEL TITANIO (NITI MWIRE- ALEACION QUE MEJORA LA RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA- ANGULO DE CORTE REVERSO-CORTE SENTIDO ANTIHORARIO- ANGULO HELICOIDAL Y PASO DE ROSCA VARIABLE. DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE- TRIANGULAR CONVEXA CERCA DE LA CODIGO Y TRIANGULAR CON CONCAVIDADES CERCA DE LA BASE DEL INSTRUMENTO. BLISTER POR TRES UNIDADES
2503091	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE GIRO ALTERNO PEQUEÑA 21-25-31 mm	LIMA EN NIQUEL TITANIO (NiTi MWire- ALEACION QUE MEJORA LA RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA- ANGULO DE CORTE REVERSO-CORTE SENTIDO AN TIHORARIO- ANGULO HELICOIDAL Y PASO DE ROSCA VARIABLE. DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE- TRIANGULAR CONVEXA CERCA DE LA CODIGO Y TRIANGULAR CON CONCAVIDADES CERCA DE LA BASE DEL INSTRUMENTO. BLISTER POR TRES UNIDADES
2503092	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE GIRO ALTERNO PRIMARIA 21-25-31 mm	LIMA EN NIQUEL TITANIO (NITI MWIRE- ALEACION QUE MEJORA LA RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA- ANGULO DE CORTE REVERSO-CORTE SENTIDO ANTI -HORARIO- ANGULO HELICOIDAL Y PASO DE ROSCA VARIABLE. DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE- TRIANGULAR CONVEXA CERCA DE LA CODIGO Y TRIANGULAR CON CAVIDADES CERCA DE LA BASE DEL INSTRUMENTO. BLISTER POR TRES UNIDADES
2502041	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N°40 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APR OXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502042	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 40 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. EST ANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502043	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 40 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502756	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 45 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502758	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 45 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502760	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 50 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR

								ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502762	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 50 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502764	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 55 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APR OXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. EST ANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502766	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 55 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502768	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 60 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502770	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 60 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502772	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 70 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502774	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 70 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502776	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 80 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502778	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 80 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR

								ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502749	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA DE NIQUEL-TITANIO MANUAL1A SERIE (SURTIDA) LONGITUD 21 mm- CON TOPES DE SILICONA. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDAD- FABRICADA EN UNA ALEACION DE NIQUEL-TITANIO (CON PROPORCION DE 56% DE NI Y 44% DE TI)- ELECTROPULI DO- PRESENTANDO SECCION TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA- DONDE CADA CALIBRE POSEE UN FORMATO DIFERENCIADO Y EXCLUSIVO. ESTANDARIZADA ISO 3630- CON TOPE DE CAUCHO. SERIE ISO 15 AL 60 EN 25 mm
2502012	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DE NIQUEL-TITANIO MANUAL1A SERIE (SURTIDA) LONGITUD 31 mm- CON TOPES DE SILICONA. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDAD- FABRICADA EN UNA ALEACION DE NIQUEL-TITANIO (CON PROPORCION DE 56% DE NI Y 44% DE TI)- ELECTROPULIDO- PRESENTANDO SECCION TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA- DONDE CADA CALIBRE POSEE UN FORMATO DIFERENCIADO Y EXCLUSIVO. ESTANDARIZA DA ISO 3630- CON TOPE DE CAUCHO. SERIE ISO 15 AL 60 EN 25 mm
2502750	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA DE NIQUEL-TITANIO MANUAL1A SERIE (SURTIDA) LONGITUD 25 mm- CON TOPES DE SILICONA. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDAD- FABRICADA EN UNA ALEACION DE NIQUEL- TITANIO (CON PROPORCION DE 56% DE NI Y 44% DE TI)- ELECTROPULIDO- PRESENTANDO SECCION TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA- DONDE CADA CALIBRE POSEE UN FORMATO DIFERENCIADO Y EXCLUSIVO. ESTANDARIZADA ISO 3630- CON TOPE DE CAUCHO. SERIE ISO 15 AL 60 EN 25 mm. SURTIDAS. CAJA POR 6 UNIDADES
2502021	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 15 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502022	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 15 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630-1 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502044	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 40 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502023	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 15 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502024	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA NO.15 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502025	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 20 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR

								ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502026	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 20 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502027	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 20 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502028	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 20 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502029	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 25 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502030	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 25 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502031	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 25 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA X 6 UNIDADES. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502032	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 25 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502033	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 30 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502034	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 30 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR

								ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502035	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 30 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502036	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 30 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502037	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 35 LONGITUD 21 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502038	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 35 LONGITUD 25 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2502039	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 35 LONGITUD 28 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502040	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA N° 35 LONGITUD 31 mm TIPO K-FLEXOFILE. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310-ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502051	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE (0.6-0.8-10) LONG 21 mm CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODONTICA- NO FORZADO
2502052	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE (0.6-0.8-10) LONG 25 mm	EN ACERO INOXIDABLE- ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTARE STANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODONTICA - NO FORZADO
2502053	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE (0.6-0.8-10) LONG 31 mm CAJA X 6 UNIDADES	EN ACERO INOXIDABLE- ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODONTICA - NO FORZADO
2502045	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 10 LONGITUD 21 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 1 mm

2502046	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 10 LONGITUD 25 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPL IR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 1 mm
2502047	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 6 LONGITUD 21 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.06 mm
2502048	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 6 LONGITUD 25 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.06 mm
2503335	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 6 LONGITUD 25 mm. EN ACERO INOXIDABLE. PRESENTACION - CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPL UNIDADES
2502049	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 8 LONGITUD 21 mm. CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm
2502050	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 8 LONGITUD 25 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm
2584542	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA PRESERIE NO. 8 LONGITUD 31 mm. CAJA POR 6 UNIDADES	ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm

2502055	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA SEGUNDA SERIE SURTIDA LONG 25 mm TIPO K-FLEXOFILE CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPL IR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm
2502056	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA SEGUNDA SERIE SURTIDA LONG 31 mm TIPO K-FLEXOFILE CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE- FLEXIBILIDAD NO EXCESIVA QUE PERMITA LA INSTRUMENTACION- CODIGO PILOTO GUIA- CON TOPE DE CAUCHO- DEBE CUMPLIR CON LA ESTANDARIZACION ISO 3630- PARTE ACTIVA DE 18 mm- DIAMETRO DE LA CODIGO 0.08 mm
2503256	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA TIPO H (HEDSTROM) 15-40 25 mm- EN ACERO INOXIDABLE- UTILIZADAS EN EL ENSANCHAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR. CAJA POR 6 UNIDADES	LIMA TIPO H (HEDSTROM). EN ACERO INOXIDABLE Y SE FABRICAN POR DESGASTE MECANICO DE LAS ESTRIAS DE LA LIMA EN EL VASTAGO METALICO DEL EXTREMO CORTANTE. CORTAN UNICAMENTE EN SENTIDO DE RETRACCION. SE UTILIZAN PARA EL ENSANCHAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR. DE DIRENTES TAMAÑOS Y CODIGO DE COLORES SEGUN NORMA. CAJA POR 6 UNIDADES
2502752	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APROXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO
2502754	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA DE PRIMERA SERIE LONGITUD 31 mm SURTIDAS TIPO K-FLEXOFILE CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310- ELECTROPULIDO- PERTENECIENTE A LA CLASIFICACION AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NIQUEL- APR OXIMADAMENTE). SECCION TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR- DE ALTA FLEXIBILIDAD- CODIGO PILOTO GUIA NO CORTANTE- CON TOPE DE CAUCHO. ESTANDARIZACION ISO 3630 Y ESTAR ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS- ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO

2503099	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS DE GIRO ALTERNO SURTIDAS EN NIQUEL TITANIO- ANGULO DE CORTE REVERSO- KIT 9 UNIDADES	LIMA EN NIQUEL TITANIO WAVEONE (NiTi MWire- ALEACION QUE MEJORA LA RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA- ANGULO DE CORTE REVERSO- CORTE SENTIDO ANTIHORARIO- ANGULO HELICOIDAL Y PASO DE ROSCA VARIABLE. DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE- TRIANGULAR CONVEXA CERCA DE LA CODIGO Y TRIANGULAR CON CONCAVIDADES CERCA DE LA BASE DEL INSTRUMENTO. KIT POR 9 UNIDADES- 3 PRIMARIAS- 3 PEQUEÑAS Y 3 LARGAS DE DIFERENTET AMAÑO
2503013	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS HEDSTROM 1ª SERIE 25 mm EN ACERO INOXIDABLE- DE FORMA EN ESPIRAL- CONOS SUPERPUESTO S- BAJA FLEXIBILIDAD	LA LIMA HEDSTROEM SE FABRICA EN DIMENSINONES ESTANDARIZADAS. EN ACERO INOXIDABLE CON ALTO PODER DE CORTE- PARA LA INSTRUMENTACION DE ANGULO HELICOIDADL SE APROXIMA A 90°- O SEA- PERPENDICULAR AL EJE CENTRAL- POR ESO NO CORTAN EN ROTACION Y SU CORTE SE PORDUCE AL TI FLEXIBILIDAD
2503262	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°06-21 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°06-21mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBILIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULARES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503326	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°06-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°06-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI RADICULARES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUAL INVIMA
2503263	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°55-25 mm-	LIMA K-FILE N°55-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR

							MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503327	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°10-25mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°10-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI RADICULARES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUAL INVIMA
2503266	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°08-21 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°08-21 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBILIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SUR TIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503264	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°08-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°08-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA

2503273	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°50-25mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 UNIDADES CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°08-28 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SUR TIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503267	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°10-21 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°10-21 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503272	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°50-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°10-31 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503268	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°50-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°50-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SUR TIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA

2503265	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA K-FILE N°70-25mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA	LIMA K-FILE N°70-25 mm- MANUAL- DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- TRABAJADA POR TORSION CON RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA- FLEXIBI LIDAD PROGRESIVA- CORTE EN LA CODIGO ENTRANDO Y SALIENDO. UTILIZADAS PARA LA PREPARACION QUIMICO-QUIRURGICA DE LOS CONDUCTOS RADICULA RES- SEGUN NORMA ISO- CALIBRES DEL 006-140 Y CONICIDAD .002. PRESENTACION CAJA POR 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA- INDIVIDUALES O SURTIDAS. NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
2503365	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	BX	A.02.02.01.004.001	LIMAS PROTAPER SIGUIENTE ACABADO FILES X1- X2- X3 LARGO 25 mm. CAJA x 3 UNIDADES	LIMA DE ALEACION NIQUEL TITANIO- ALAMBRE M-RECTANGULO UNICO DESCENTRADO EN CORTE TRANSVERSAL- ROTACION CONTINUA-VELOCIDAD 300 RPM- AMARILLO- AZUL Y ROJO
2505216	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES PRIMARY 25mm - WAVE ONE GOLD	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR-ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS PRIMARY X 25 mm
2505217	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES PRIMARY 25mm - WAVE ONE GOLD	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR-ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS PRIMARY X 31 mm

2505218	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES MEDIUM 25 mm - WAVE ONE GOLD	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS MEDIUM 25 mm
2505219	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES MEDIUM 31 mm - WAVE ONE GOLD	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS MEDIUM 31 mm
2505220	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES LARGE 25 mm	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS LARGE 25 mm
2505221	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES LARGE 31mm	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS LARGE 31 mm

2505214	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES SMALL 25mm	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS SMALL DE 25 mm
2505215	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS UNICAS DE CONDUCTOS RECIPROCANTES PARA CONDUCTOS RADICULARES SMALL 31 mm -	LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS CODIGOTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA- CON CONICIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO – (TECNOLOGIA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CICLICA)- QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR- ASEGURAN UNA PREPARACION DEL CONDUCTO MAS SEGURA- RAPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLISTER ESTERIL POR TRES LIMAS SMALL DE 31 mm
2502891	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S1 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502892	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S2 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVRXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502893	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S2 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVRXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO. COM MILITAR
2502894	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS SX EN 19 mm- DE SECCION	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO

							TRIANGULAR CONVEXA	
2502895	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F1 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502896	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F1 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502897	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F2 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502898	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F2 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502899	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F3 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502900	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F3 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502886	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S1 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502887	42151620	**ZMQX**	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S1 EN 25 mm- DE SECCION	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA-ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO. COM MILITAR

							TRIANGULAR CONVEXA	
2502888	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S2 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502889	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S2 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVRXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502901	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F4 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO. COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION
2502902	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS F4 EN 25 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO. COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION
2502890	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMAS ROTATORIAS S1 EN 21 mm- DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA- ELECTRO PULIDAS- CON CONICIDADES MULTIPLES EN LA MISMA LIMA. FABRICADAS EN NIQUEL TITANIO
2502061	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.006	CONTENEDOR (REGLA) MINI ENDOBLOCK PLASTICO UNIDAD- PARA ENDODONCIA. AUTOCLAVABLE	CONTENEDOR (REGLA) DE LIMAS- PLASTICO- AUTOCLAVABLE- CON MEDIDAS ESTANDARIZADAS ISO. ACCESORIO UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LIMAS PARA ENDODONCIA- CON CAPACIDAD DE MEDIDA ENTRE 10 mm A 30 mm- CON INCREMENTOS DE 0.5 mm- AUTOCLAVABLE- DE 32 GUIAS DE PROFUNDIDAD EN DOS FILAS
2502063	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	MOMIFICANTE PULPAR- ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE FRASCO GOTERO DE 7 ml	LIQUIDO TRANSPARENTE DE OLOR CARACTERISTICO- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. MOMIFICANTE PULPAR EN DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES. ANTISEPTICO TOPICO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2%.
2501997	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	PERBORATO DE SODIO FCO X 10 gr- PARA	PERBORATO DE SODIO PARA USO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

							BLANQUEAMIENTO DENTAL	
2500108	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	PEROXIDO DE UREA + EDTA 10% FRASCO X 5-7 gr	BASE SOLUBLE ACUOSA INDICADA PARA REMOVER CALCIFICACIONES Y LUBRICAR EL CANAL RADICULAR. REPARADOR QUIMICO-MECANICO DE CANALES RADICULARES- A BASE DE GLYCOL- PEROXIDO DE UREA Y EDTA
2503875	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% + DIOXIDO DE SILICIO + HIDROGENO DE POTASIO. JPR 1.2 ml	SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% + DIOXIDO DE SILICIO + HIDROGENO DE POTASIO PARA DIENTES NO VITALES. VISCOCIDAD IDEAL PARA UNA COLOCACION Y SELLADOS SENCILLOS CON LARGA VIDA UTIL. PRESENTACION EN JERINGA PRELLENADA LISTA PARA USARD E 1.2 ml (1.45 gr)
2500070	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	PUNTAS DE PAPEL ABSORBENTE NO. 15-40-PRIMERA SERIE- FORMA CONICA Y AHUSAMIENTO UNIFORME	CODIGOS DE PAPEL ABSORBENTE 15 A 40 mm-PRIMERA SERIE. FABRICADAS CON PAPEL ABOSORBENTE- FORMA CONICA Y AHUSAMIENTO UNIFORME. COMPOSICION- PAPEL FILTRO- GOMA NATURAL. PROPIEDADES- SER BIEN TOLERADOS POR LOS TEJIDOS PERIAPICALES- FACIL MANIPULACION E INTRODUCCION AL CONDUCTO-BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION; CON DIMENSIONES SIIMILARES A LOS CONOS DE GUTAPERCHA- INSOLUBLE EN LOS FLUIDOS ORGANICOS. USO- PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION. CUMPLIR NORMA ISO 7551. VIDA UTIL 5 AÑOS. PRESENTACION- TUBO POR 20 CONOS O CODIGOS
2500087	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.002	PUNTAS DE PAPEL ABSORBENTE NO. 45-80-SEGUNDA SERIE- FORMA CONICA Y AHUSAMIENTO UNIFORME	CODIGOS DE PAPEL ABSORBENTE 45 A 80 mm-SEGUNDA SERIE. FABRICADAS CON PAPEL ABOSORBENTE- FORMA CONICA Y AHUSAMIENTO UNIFORME. COMPOSICION- PAPEL FILTRO- GOMA NATURAL. PROPIEDADES- SER BIEN TOLERADOS POR LOS TEJIDOS PERIAPICALES- FACIL MANIPULACION E INTRODUCCION AL CONDUCTO-BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION; CON DIMENSIONES SIIMILARES A LOS CONOS DE GUTAPERCHA- INSOLUBLE EN LOS FLUIDOS ORGANICOS. USO- PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION. CUMPLIR NORMA ISO 7551. VIDA UTIL 5 AÑOS. PRESENTACION- TUBO POR 20 CODIGOS - CONOS

2505909	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	REFRIGERANTE PULPA/ENDODONCIA SPRAY200ml	REFRIGERANTE PULPA/ENDODONCIA SPRAY200ml- AEROSOL PARA CONGELAR ALGODON PARA PROBAR LA RESPUESTA DE LAS FIBRAS NERVIOSAS ESTIMULANDO LAS TERMINACIONES NERVIOSAS DE LA PULPA.
2505592	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.005	SUSTITUTO BIOACTIVO DENTINA (SILICATO TRICALCICO)	UNICO MATERIAL BIOCOMPATIBLE Y BIOACTIVO QUE PUEDE SER UTILIZADO DONDE SEA QUE LA DENTINA ESTE DAÑADA- TANTO A NIVEL RADICULAR COMO CORONAL. MULTIPLES CASOS PODRAN SER SOLUCIONADOS CON BIODENTINE; CARIES- PERFORACIONES- REABSORCIONES INTERNAS Y EXTERNAS- CIRUGIA APICAL- EXPOSICION PULPAR- PULPOTOMIAS Y APEXIFICACION. TIEMPO DE FRAGUADO 12 MIN. VERSUS LAS 2 O 3 HORAS DEL RESTO DE LOS MTA. ESTO SE LOGRA AL TENER UN SILICATO TRICALCICO PURIFICADO Y UN ACTIVADOR (CLORURO CALCICO) PRESENTE EN EL LIQUIDO. PRESENTACION- CAJAS DE 5CAPSULAS Y DE 15 CAPSULAS. RENDIMIENTO- 5 PACIENTES Y 15 PACIENTES RESPECTIVAMENTE.
2501432	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TELA DE CAUCHO 5X5 UNIDAN- FABRICADA DE LATEX REFINADO- DIFERENTES COLORES	TELA DE CAUCHO 5x5- LA GOMA DE LA TELA ESTA COMPUESTA POR LATEX REFINADO- HIDROCARBUROS DEL CAUCHO 30-35%- AGUA 60-65%- PROTEINAS- LIPOIDES DE HIDRATOS DE CARBONO 1%- COMPONENTES INORGANICOS 0.5%. ELONGACION HASTA 800% SIN DESGARRE- CON BUENA RESISTENCIA Y ALARGAMIENTO- BAJA EN POLVO. DE TRES ESPESORES (DELGADO- MEDIO Y GRUESO)- DIFERENTES COLORES QUE CONTRASTEN A LOS TEJIDOS ORALES- AJUSTE EN LA RETRACCION DE LOS TEJIDOS BLANDOS
2583809	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TELA DE CAUCHO 6 X 6 UNIDAN- FABRICADA DE LATEX REFINADO- BAJA EN POLVO- DIFERENTES COLORES	TELA DE CAUCHO 6x6- LA GOMA DE LA TELA ESTA COMPUESTA POR LATEX REFINADO- HIDROCARBUROS DEL CAUCHO 30-35%- AGUA 60-65%- PROTEINAS- LIPOIDES DE HIDRATOS DE CARBONO 1%- COMPONENTES INORGANICOS 0.5%. ELONGACION HASTA 800% SIN DESGARRE- CON BUENA RESISTENCIA Y ALARGAM IENTO- BAJA EN POLVO. DE TRES ESPESORES (DELGADO- MEDIO Y GRUESO)- DIFERENTES COLORES QUE CONTRASTEN A LOS TEJIDOS ORALES- AJUSTE EN LA RETRACCION DE LOS TEJIDOS BLANDOS
2502109	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.004.001	TIRANERVIO SURTIDO BLISTER X 10 UNIDADES	DE MANGO PLASTICO EN LOS COLORES DE LAS LIMAS- 21 mm DE LONGITUD EN ACERO INOXIDABLE QUE LE DA FLEXIBILIDAD Y DUREZA

2502111	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	C/U	A.02.02.01.003.006	TOPE DE CAUCHO PK 50 UNIDADES	TOPES EN CAUCHO EN LOS COLORES QUE CONCUERDEN EN LAS LIMAS DE ENDODONCIA
2502112	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	SOB	A.02.02.01.003.005	TRIOXIDO MINERAL AGREGADO SOBRE X 1 gr (5 UNIDADES)	MATERIAL DE OBTURACION RETROGRADA- DE USO ENDODONTICO- COMPUESTO DE ALUMINIO-SILICATO- OXIDO TRICALCICO Y OXIDO DE SILICATO-BIOCOMPATIBLE.
2502114	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-2	FCO	A.02.02.01.003.005	XILOL/XYLOL FRASCO DE 15 A 30 ml- DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO. USO ODONTOLOGICO	LIQUIDO TRANSPARENTE- DE OLOR CARACTERISTICO- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO- DESENGRASANTE DE SUPERFICIES- ANTES DE RESTAURACIONES. SE EMPLEA EN LA DESOBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES- FACILITANDO EL ABLANDAMIENTO RAPIDO Y LA LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR EN PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS O RESTAURATIVOS. PRESENTACION EN FRASCO OSCURO DE VIDRIO. MATENGASE BIEN TAPADO A TEMPERATURA INFERIOR A 15°. PROTEGIDO DE LA LUZ. USO PROFESIONAL ODONTOLOGICO.

HIGIENE ORAL

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501925	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	C/U	A.02.02.01.003.006	COPA CAUCHO DESECHABLE	COPA DE GOMA- DE VASTAGO METALICO- EMPATE UNIVERSAL. DISEÑO ESPECIAL CON LAMINAS INTERIORES Y EXTERIORES QUE CONDUCEN LA PASTA HACIA LA SUPERFICIE DEL DIENTE. USO- LIMPIEZA Y PULIDO EFICAZ- EVITANDO LAS SALPICADURAS Y REDUCIENDO EL CALENTAMIENTO- PARA CONTRANGULO CON PARTE ACTIVA EN CAUCHO
2501940	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	PK	A.02.02.01.003.006	ENHEBRADORES PAQUETE X 24-25 UNIDADES	OJALES DE NYLON FLEXIBLES QUE PERMITEN ENHEBRAR EL HILO DENTAL Y DESLIZARLO ENTRE CORONAS- ALREDEDOR APARATOS DE ORTODONCIA E IMPLANTES
2503250	42151905	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	FCO	A.02.02.01.003.005	FLUOR EN BARNIZ 5% TUBO POR 10 ml. USO- OBTURACION DE LOS TUBULOS DENTINARIOS- TRATAMIENTO	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (1 ml CONTIENE 50 mg DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO- OBTURACIOND E LOS TUBULOS DENTINARIOS- TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA- PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL- SE FIJA RAPIDAMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. PRESENTACION TUBO POR 10 ml

							DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA	
2501048	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	KIT	A.02.02.01.004.008	KIT DE SALUD ORAL ADOLESCENTES	CEPILLO DENTAL ADULTO- CREMA DENTAL- SEDA DENTAL- PORTACEPILLO- REVELADOR DE PLACA BACTERIANA
2500251	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	KIT	A.02.02.01.004.008	KIT DE SALU ORAL ADULTOS	CEPILLO DENTAL ADULTO CON MANGO ERGONOMICO- SEDA DENTAL PLANA-CREMA DENTAL 30 g
2505132	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	KIT	A.02.02.01.004.008	MACROMODELO DELTAL ENSEÑANZA + CEPILLO	MODELO DE ESTUDIO PLASTICO CON ARTICULACION DEL MAXILAR Y MANDIBULAR-PARA ENSEÑAR EN CONSULTORIOS Y FACULTADES EL CEPILLADO DENTAL Y USO DEL HILO DENTAL. ASI COMO MODELO DE ESTUDIO PARA DESCRIBIR POSIBLES TRATAMIENTOS DENTALES. PRESENTACION COMERCIAL- CAJA X 1 UND.
2502100	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	FCO	A.02.02.01.003.005	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FCO 500 TAB	PASTILLA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA (ERITROSINA- FUSCINA). UTILIZADA EN HIGIENE ORAL. PRESENTACION EN FRASCO DE 500 TABLETAS.
2584750	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-3	C/U	A.02.02.01.003.005	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO GOTERO X 10 ml	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO X 10 ml- SOLUCION COLORANTE UTILIZADA PARA DETECTAR BIOFILM O PLACA (CALCIFICACDA). LA PLACA ANTIGUA SE PIGMENTA DE COLOR AZUL OSCURO Y LA PLACA BLANDA SE DETECTA CON UNA PIGMENTACION ROSADA INTENSA. INGREDIENTE ACTIVO ERITROSINA SODICA AZUL BRILLANTE.

LABORATORIO DENTAL

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500327	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	GLN	A.02.02.01.003.005	ACRILICO LIQUIDO AUTOCURADO USO LABORATORIO DENTAL. PRESENTACION GALON	ACRILICO LIQUIDO DE AUTOCURADO ES UNA RESINA ACRILICA (MONOMERO) INDICADO PARA LA FABRICACION DE PROTESIS TOTALES-PARCIALES- REMOVIBLES Y TEMPORALES. COMPUESTO POR METIL-METACRILATO-ETILENGLICOL DIMETACRILATO. USO EN LABORATORIO DENTAL

2500326	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	KIT	A.02.02.01.003.005	ACRILICO PATRONES NUCLEO (KIT) FRASCO POLVO DE 30-60 gr FRASCO LIQUIDO 30-55 ml	KIT DE ACRILICO DE AUTOCURADO POLVO-LIQUIDO CALCINABLE. NO SE CONTRAE PARA LA ELABORACION DE PATRONES DE NUCLEO-COFIAS- FIJACION DE PUENTES EN PROTESIS FIJA PARA SOLDAR COFIAS. PRESENTACION SET FRASCO LIQUIDO DE 30-55 ml. FRASCO POLVO DE 30-60 gr
2503865	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	BARRA FRESADA SOBRE IMPLANTE- DE ESTRUCTURA METALICA- MATERIAL METAL BASE (CROMO-COBALTO)	BARRA FRESADA SOBRE IMPLANTE DE ESTRUCTURA METALICA- MATERIAL METAL BASE (CROMO-COBALTO CERTIFICADO). SU DISEÑO ES INDIVIDUAL POR PACIENTE
2500838	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	BX	A.02.02.01.003.005	CERA BLANCA EN BARRA PRESENTACION EN la CAJA	CERA EN BARRAS DE COLOR BLANCA INDICADA PARA LA ELABORACION DE ENCERADOS DIAGNOSTICOS
2501983	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.004	CERA BLANCA EN BARRA UNIDAD	CERA EN BARRAS DE COLOR BLANCA INDICADA PARA LA ELABORACION DE ENCERADOS DIAGNOSTICOS
2504753	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.02	CERAMICA DE FELDESPATO DE ESTRUCTURA FINA- SUPERFICIES HOMOGENEAS. CORRECTIVA ADICIONAL PARA LOS SISTEMAS MASTER-CLASICO FRASCO 12 gr	CERAMICA DE FELDESPATO DE ESTRUCTURA FINA- SUPERFICIES HOMOGENEAS Y LISAS- EXCELENTE ESTABILIDAD. COMPORTAMIENTO DE REFRACCION Y DEL CUELLO- LA DENTINA O EL ESMALTE. DISPONIBLE EN DIFERENTES COLORES (COR1- COR2- COR3). ADICIONAL DE LOS SISTEMAS MASTER-CLASICOC 12 gr
2503477	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.03	CORONA COMPLETA METAL PORCELANA (METAL BASE)	CORONA COMPLETA METAL PORCELANA (METAL-BASE)- ELEMENTO PROTESICO QUE REEMPLAZA UN DIENTE EN MATERIAL DE METAL Y PORCELANA
2503482	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CUBETA INDIVIDUAL	CUBETA REALIZADA EN ACRILICO DE ACUERDO CON CADA PACIENTE
2584732	9110	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	CUCHILLO DE PROTESIS CON	CUCHILLO EN ACERO INOXIDABLE CON MANGO ERGONOMICO DE MADERA- TIPO ZAPATERO

							MANGO ERGONOMICO DE MADERA	
2584734	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	DIENTES ACRILICOS POSTERIORES SUPERIORES TAMAÑOS Y COLORES SURTIDOS	DIENTES EN ACRILICO RESISTENTES AL DESGASTE- AL CALOR. DISEÑO ANATOMICO. ACRILICO DE 2 CAPAS CROMATICAS CON FLUORECENCIA Y CROSS LINK. TAMAÑO Y COLORES SURTIDO. REGLILLA X 8 UND.
2501931	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	DIENTE ACRILICO ANTERIORES SUPERIORES EN COLORES Y TAMAÑOS SURTIDOS.	RESISTENTE AL DESGASTE- AL CALOR- A LOS SOLVENTES- DISEÑO ANATOMICO- DOS CAPAS CROMATICAS CON FLUORESENCIA Y CROSS LINK TAMAÑO Y COLORES SURTIDOS.
2501932	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	DISCO DE CARBURO DE CORTE BILATERAL PEQUEÑOS	DISCO DE CARBURO PEQUEÑOS DE CORTE BILATERAL RESISTENTE A LA FRACTURA CUANDO SE ESTA UTILIZANDO. PARA USO CON MANDRIL
2503074	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.03	DISCO DE DIAMANTE PARA PORCELANA	DISCO FINO DOBLE CARA DE 0-08 mm DE GROSOR FLEXIBLE-MONTADO
2504686	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.03	DISCOS DIMANTADOS POR AMBOS LADOS CON SEGMENTOS ALARGADOS- DE 0.16 mm A 0.25 mm- UNIDAD	DISCO DIAMANTADO POR AMBOS LADOS- CON SEGMENTOS ALARGADO QUE PERMITE MANTENER SU REFRIGERACION- FLEXIBILIDAD Y SU TRANSPARENCIA DURANTE SU USO. PARA PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE 0.16 mm A 0.25 mm UNIDAD
2504687	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.03	DISCO DIAMANTADO SINTERIZADO POR AMBOS LADOS RIGIDO DE 0.15mm A 0.25mm	DISCO DIAMANTADO SINTERIZADO AMBOS LADOS RIGIDO PARA PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE 0.15mm A 0.25mm
2503078	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.002.007	DISCO GAMUZA PARA BRILLADO DE ACRILICO	DISCOS/FELPA DE GAMUZA SUAVE PARA BRILLADO DE ACRILICOS GRANDE
2505262	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	DISCO METALICO MONTADO DE	DISCO METALICO MONTADO DE GRANO DE DIAMANTE DE DOBLE CARA- DIAMETRO DE 0.20 mm X 22 mm

							GRANO DE DIAMANTE DE DOBLE CARA-DIAMETRO DE 0.20 mm X 2 mm.	
2503075	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	BX	A.02.02.01.003.007.02	DISCOS FINOS PARA INDIVIDUALIZAR PORCELANA. CAJA POR 25 UNIDADES	DISCOS ULTRADELGADOS PARA INDIVIDUALIZAR PORCELANA CAJA X 25 UNIDADES
2503483	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.007.02	ENCIA ROSADA CERAMICA SENCILLA UNIDAD	ENCIA ROSADA-CERAMICA SENCILLA- MATERIAL CERAMICO DE COLOR ROSADO QUE REEMPLAZA LA ENCIA. UNIDAD
2503077	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DE GRANO DE DIAMANTE SINTERIZADO	FRESAS DE GRANO DE DIAMANTE SINTERIZADO PARA MATERIALES DE ALTA DUREZA (METALES). PIEDRAS DIAMANTADAS SINTERIZADAS SURTIDAS
2503002	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE CILINDRICA TERMIN REDONDA- CON TRIPLE RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE	FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD-INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA- LA PARTE ACTIVA6 360
2584735	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	RO	A-02-02-01-003-003-05	HILOS EN CERA PARA BEBEDEROS CALIBRE 2-5 mm. ROLLO DE 250 gr APROXIMADAMENTE 50 m	HILOS EN CERA PARA BEBEDEROS DE PROTESIS FIJAY REMOVIBLE. FACIL DE MODELAR- SE QUEMA SIN DEJAR RECIDUOS. PRESENTACION EN ROLLO DE 250 gr DE 50 m. MATERIAL COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES.
2505291	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	PLG	A.02.02.01.004.001	LIJA DE ACABADO/PULIDO GRANO EXTRA-FINO	LIJA DE ACABADO/PULIDO GRANO EXTRA-FINO
2502007	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	PLG	A.02.02.01.004.001	LIJA DE AGUA GRANO FINO PLIEGO	PARA LIJAR SUPERFICIES ASPERAS. RESISTENTE Y ESTABLE PARA FACIL MANEJO.
2505253	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO DE MEZCLA PARA REVESTIMIENTO DE PROTESIS FIJA. COMPATIBLE	LIQUIDO SIN ANTICONGELANTE- PARA PRECALENTAMIENTO RAPIDO Y CONVENCIONAL DE MEZCLA PARA REVESTIMIENTO DE PROTESIS FIJA. COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENTE. PRESENTACION BOTELLA DE 1000 ml-5000 ml

							CON SISTEMA EXISTENTE. PRESENTACION BOTELLA DE 1000 ml-5000 ml	
2584733	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	VI	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO ELIMINADOR DE TENSION EL LA CERA PRESENTACION EL FCO DE 120 ml	LIQUIDO EMPLEADO EL LA REDUCCION DE LA TENSION EN LA CERA QUE PREVIENE LA APARICION DE POROS. PRESENTACION EN FCO DE 120 ml
2504421	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	FCO	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO MODELADOR DE OPACOS EN POLVO-FRASCO DE 50 ml A 250 ml	LIQUIDO ESPECIAL PARA LA MEZCLA DE OPACOS EN POLVO EN EL RECUBRIMIENTO TOTAL DE LAS COFIAS METALICAS. FCO DE 50 ml A 250 ml
2504420	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	FCO	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO PARA MODELAR PORCELANA FCO DE 50 ml A 250 ml	LIQUIDO ESPECIAL PARA LA MEZCLA DE MATERIALES DE DENTINAS- INCISALES Y COMPLEMENTARIOS EN LA FABRICACION DE CORONAS DENTALES. FCO DE 50 ml A 250 ml
2503652	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO SEPARADOR DE YESO-YESO. AISLA EL YESO DEL ACRILICO. GALON	LIQUIDO SEPARADOR DE YESO-YESO. AISLA EL YESO DEL ACRILICO. UTILIZADO EN LA TECNICA DE ENMUFLADO QUE EVITA EL CONTACTO DIRECTO DEL ACRILICO DEL YESO- SIN ALTERAR LAS DIMENSIONES. PRESENCION EN GALON
2505246	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA COLADO DE PRECISION CAJA POR 50 BOLSAS DE 60 gr	MATERIAL DE REVESTIMIENTO COHESIONADA CON FOSFATO- PARA COLADO DE PRECISION DE ALEACIONES DE METALES PRECIOSOS. CONTROL DE LA EXPANSION- TIEMPO DE MANIPULACION ADECUADA. COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENTE. PRESENTACION CAJA DE 50 BOLSAS DE 60 gr
2503480	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	NUCLEO ALEACION PLATA PALADIO	NUCLEO DE ALEACION PLATA PALADIO- PIN INTRARADICULAR
2503076	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	PASTA DE BRILLO EN SECO PARA ACRILICOS	PASTA PULIDORA ABRILLADORA
2502070	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	LB	A.02.02.01.003.005	PIEDRA POMEZ BOLSA X 1 lb	POLVO DE PIEDRA POMEZ UTILIZADO EN LIMPIEZAS Y BRILLO DE PROTESIS ACRILICAS-PLACAS NEUROMIORELAJANTES-PROVISIONALES-PROTESIS ESTETICAS.

2584739	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRAS MONTADAS VERDES DE TALLE LARGO DORADO	PIEDRAS MONTADAS VERDES DE TALLE LARGO PARA PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. PIEDRAS PARA DESGASTE DE MARGENES- MINIMINIZA LA CREACION DE CALOR. GRANO GRUESO REFERNCIAS SURTIDAS
2584740	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PLACAS BLANDAS NO.8	LAMINAS BLANDAS No.8 PARA LA REALIZACION DE PLACAS NEUROMIORELAJANTES. PRESENTACION EN UNIDAD
2587181	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PLACA DE ACETATO No. 6	LAMINAS DE ACETATO No. 6- DELGADAS PARA REALIZAR PLACAS DE PROTECCION Y RETENEDORES
2584742	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PLACAS DE ACETATO N° 8	LAMINAS DE ACETATO N° 8 PARA LA REALIZACION DE PLACAS NEUROMIORELAJANTES- PRESENTACION UNIDAD
2584730	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	BX	A.02.02.01.003.005	PONTICOS DE CERA DE MOLDEADO RAPIDO- DIFERENTES FORMAS. PRESENTACION - CAJA DE 50 A 300 PIEZAS	PONTICOS DE CERA PARA MODELADO RAPIDO- UTILIZADO PARA PUENTES DE PROTESIS FIJA. DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS; ANATOMICAS. PRESENTACION CAJA DE 50 A 300 PIEZAS
2502074	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	PORTA DISCOS UNIDAD	PORTA DISCO DE MADRIL DE TALLE LARGO- DE BAJA VELOCIDAD PARA MONTAJE DE DISCOS DE CUALQUIER TAMAÑO- CON REFUERZO. PRESENTACION POR UNIDAD
2503868	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	POSTES INDIVIDUALIZADOS PARA IMPLANTES- EN MATERIAL- METAL - BASE	POSTES INDIVIDUALIZADOS PARA IMPLANTES- EN MATERIAL- METAL - BASE. REALIZADOS AL REQUERIMIENTO DE CADA PACIENTE EN DIFERENTES ANGULACIONES.
2503866	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	BARRAS CAD - CAM PARA IMPLANTES EN MATERIAL DE ZIRCONIO	BARRA PARA IMPLANTES EN MATERIAL DE ZIRCONIO- DISEÑADA CON EL SISTEMA CAD -CAM
2503867	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.004.001	PROTESIS HIBRIDAS CON ESTRUCTURA METALICA- MATERIAL METAL-BASE (CROMO-COBALTO)- SU DISEÑO ES INDIVIDUAL A	PROTESIS HIBRIDAS CON ESTRUCTURA METALICA- MATERIAL METAL BASE (CROMO-COBALTO)- SU DISEÑO ES INDIVIDUAL A REQUERIMIENTO POR PARTE DEL PACIENTE

							REQUERIMIENTO POR PARTE DEL PACIENTE	
2503862	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS MUCOSOPORTADA EN ACRILICO INYECTABLE	PROTESIS MUCOSOPORTADA- EN ACRILICO INYECTABLE (MATERIAL SEMI-RIGIDO DENOMINADO POLIAMIDA DE ALTO IMPACTO)- QUE SE APOYA EXCLUSIVAMENTE EN COLORACION MUY SEMEJANTES A LA DEL PACIENTE.
2503864	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS MUCOSOPORTADA EN POLIAMIDA (NYLON)-BIOCOMPATIBLE. DE DISEÑO INDIVIDUAL A REQUERIMIENTO POR PARTE DEL POR PACIENTE	PROTESIS MUCOSOPORTADA EN POLIAMIDA (RESINA DE NYLON TERMOPLASTICO)- FLEXIBLE-BLANDA- BIOCOMPATIBLE- DE PERFECTA ADAPTACION.
2503474	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS PARCIAL ACRILICA-MUCOSOPORTADA. CUALQUIER CANTIDAS DE DIENTES ACRILICOS	PROTESIS PARCIAL ACRILICA- MUCOSOPORTADA- CUALQUIER CANTIDAD DE DIENTES ACRILICOS. ADITAMENTO QUE PERMITE LA REPOSICION DE UNO O MAS PERDIDAS DE DIENTES.
2503475	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE-CUALQUIER CANTIDAD DE DIENTES DE ALTO IMPACTO	PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE- CUALQUIER CANTIDAD DE DIENTES DE ALTO IMPACTO. ADITAMENTO QUE PERMITE LA REPOSICION DE UNO O MAS PERDIDAS DE DIENTES
2503472	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS TOTAL MUCOSOPORTADA CON DIENTES EN ACRILICOS.	PROTESIS TOTAL MUCOSOPORTADA CON DIENTES EN ACRILICO. ADITAMENTO QUE PERMITE LA REPOSICION LOS DIENTES AUSENTES.
2503473	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PROTESIS TOTAL MUCOSOPORTADA CON DIENTES EN ACRILICO ALTO IMPACTO	PROTESIS TOTAL MUCOSOPORTADA CON DIENTES EN ACRILICO- ALTO IMPACTO. ADITAMENTO QUE PERMITE LA REPOSICION DE LOS DIENTES PERDIDOS.

2503476	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	PROVISIONAL TERMOCURADO - DIENTE ACRILICO QUE REEMPLAZA DE MANERA PROVISIONAL UN DIENTE	PROVISIONAL ACRILICA- ELABORADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOCURADO- EN MATERIAL BIOCOMPATIBLE QUE EVITE LA CONDUCCIÓN DE LOS ESTIMULOS TERMICOS Y QUIMICOS AL DIENTE. ALTA ADAPTACIÓN MARGINAL- PARA EVITAR LA INFILTRACIÓN MARGINAL Y MANTENIMIENTO DEL TEJIDO GINGIVAL.
2503101	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTA SILICONA ROSADA PARA ACABADO DE ACRILICO GRANDE	CODIGOS DE SILICONA ROSADAS- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- INDICADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN APARATOLOGIIA Y PROTESIS ACRILICAS. RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION
2502132	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS SILICONA GRISES- ACABADO DE ACRILICO- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	CODIGOS DE SILICONA GRISES- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- INDICADA PARA REALIZAR ACABADOS EN APARATOLOGIA Y PROTESIS ACRILICAS- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION
2502133	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS SILICONA VERDES PULIR ACRILICO- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	CODIGOS DE SILICONA VERDES PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- INDICADA PARA REALIZAR ACABADO EN APARATOLOGIIA Y PROTESIS ACRILICAS- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION
2502068	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS DE SILICONA GRANDES AMARILLAS PARA PULIR ACRILICO UNIDAD	CODIGOS DE SILICONA AMARILLAS PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- INDICADA PARA REALIZAR ACABADO EN APARATOLOGIIA Y PROTESIS ACRILICAS- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION
2502135	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS SILICONA AZULES PARA ACABADO DE ACRILICO- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	CODIGOS DE SILICONA AZULES PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- INDICADA PARA REALIZAR ACABADO EN APARATOLOGIIA Y PROTESIS ACRILICAS- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION
2503484	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	REBASE DE PARCIAL- TOTAL O REMOVIBLE	REBASE DE PARCIAL- TOTAL O REMOVIBLE- PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA AJUSTAR LA PROTESIS DESADAPTADA

2584745	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	GLN	A.02.02.01.003.005	REVESTIMIENTO PARA SOLDADURA PRESENTACION DE 453 gr A 4.5 kg- COLOR BLANCO	REVESTIMIENTO PARA SOLDADURA-COHESIONADO CON FOSTATO. AJUSTE OPTIMO, PERO FACIL DE RETIRAR. ADECUADO PARA TEMPERATURAS DE HASTA 1.200 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION EN BOLSAS DE 453 gr A 4.5 kg - COLOR BLANCO
2504756	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.005	SELLADOR DE MODELO DE FORMA FLUIDA-INCOLORO-OLOR CARACTERISTICO FCO 50 ml CON BROCHA.	SELLADOR DE MODELO DE FORMA FLUIDA. SELLA LOS POROS DEL YESO Y EVITA QUE EL YESO ABSORBA LA HUMEDAD DE LA CERAMICA. INCOLORO- OLOR CARACTERISTICO. SU COMPONENTE ES ACETATO DE ETILO NOTRICELULOSA PLASTIFICANTE. PRESENTACION EN FRASCO- CON BROCHA DE 50 ml.
2503863	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	SOBREDENTADURA SOBRE BARRA IMPLANTOSOPORTADA EN ACRILICO	SOBREDENTADURA SOBRE BARRA-IMPLANTOSOPORTADA EN ACRILICO Y DIENTES EN ACRILICO DE ALTO IMPACTO- SU DISEÑO ES INDIVIDUAL A REQUERIMIENTO DEL PACIENTE.
2503110	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TAZA DE CAUCHO USO ODONTOLOGICO	TAZA DE CAUCHO USO ODONTOLOGICO
2584746	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	LB	A.02.02.01.003.005	YESO PIEDRA TIPO II BULTO DE 50 lb	YESO PIEDRA TIPO II SULFATO DE CALCIO DESHIDRATADO. EMPLEDO EN EL PROCESO DE MONTAJE EN ARTICULADOR DE MODELOS DE TRABAJO DENTALES- EN EL ENMUFLADO PRESENTACION EN BULTO DE 50 lb
2502115	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	LB	A.02.02.01.003.005	YESO PIEDRA TIPO III BULTO 50 LB O 22.6 kl	SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO-FRAGUADO RAPIDO, PERO SUFICIENTE PARA SU MANIPULACION- BUENA REPRODUCION- YESO DENTAL DE ALTA RESISTENCIA PRESENTACION BULTO DE 50 lb O 22.6 kl
2502116	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-4	LB	A.02.02.01.003.005	YESO TIPO IV EXTRADURO BULTO DE 6 kg A 25 kg	SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO-FRAGUADO RAPIDO, PERO SUFICIENTE PARA SU MANIPULACION- BUENA REPRODUCION. YESO EXTRADURO RESISTENTE A LA COMPRESION Y A LA ABRASION. USO ESPECIAL PARA LA REALIZACION DE PROTESIS FIJA.

ODONTOLOGIA GENERAL								
Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501996	42152465	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO FRASCO X 1000 ml- PARA USO DE ROTATIVOS ODONTOLOGICOS	DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPO LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO (NSK)
2501995	42152465	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO FRASCO X 500 ml- PARA USO DE ROTATIVOS ODONTOLOGICOS	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PIEZAS DE PARTES DE LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD-TURBINAS. CON AGENTE DE PROPULSION INDIVIDUAL NO CONTAMINANTE CON PROPELENTE ECOLOGICO. ACEITE DE BASE MINERAL-CON UN ADITIVO QUE LE OTORGA UN ALTO PODER RESIDUAL- CON EFECTIVA PROTECCION DE LOS RODAMIENTOS
2502880	42151505	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ACIDO FOSFORICO AL 37%- JERINGA PRE LLENADA 5-12 ml	AGENTE GRABADOR PARA ESMALTE Y DENTINA-TIPO GEL DE ALTA VISCOSIDAD- GEL DE COLOR AZUL PARA VISIBILIDAD- CON ESPESANTE INORGANICO- SIN ADHESIVO
2584580	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ACRILICO AUTOCURADO POLVO COLOR N°67 FRASCO X 45/60G- PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES. POLVO DE GRANO FINO	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR NO. 67- FRASCO x 45/60g. POLIMERIZACION RAPIDA DE 6 A 9 MINUTOS- CON METILM ETACRILATO- FACIL DE PULIR- UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES. DE GRANO FINO EL POLVO
2584581	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR NO. 62 FRASCO X 60 GR	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) Color No. 62 FRASCO X 60 GR

2503041	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ADHESIVO DE AUTOGRABAO FRASCO 5-6 ml DE UNA UNICA CAPA TECNOLOGIA DE RELLENO	ADEHSIVO DE RESINA UNIVERSAL-AUTOGRABADOR DE UNA UNICA CAPA-TECNOLOGIA DE RELLENO PARA UN DESEMPEÑO DE ADHESIVO OPTIMIZADO- DESMINERALIZA Y ADHIERE A LA DENTINA Y ESMALTE EN UN SOLO PASO- DISMINUYE LA SENSIBILIDAD POST OPERATORIA- TOLERANTE A LA HUMEDAD. PARA RESTAURACIONES DIRECTAS- INDIRECTAS. PRESENTACIN FRASCO 5-6 ml
2502965	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ADHESIVO PARA RESINA ACRILICA FRASCO X 6 ml	RESINA ACRILICA PARA PATRONES DE RETENEDORES INTRARADICULARES- ULTRAFINA DE AUTOCURADO
2502130	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41 MM. CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO 0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 23-35 MM. CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO-BISEL (LARGO- MEDIO O CORTO)- PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE CODIGOTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO.
2584578	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ALGINATO CROMATICO PARA IMPRESIONES BOLSA X 450 A 500 GR	ALGINATO CROMATICO PARA IMPRESIONES- DE ALTA PRECISION- SIN POLVO- CON AROMA-PROPIO mm
2501054	42152506	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.000.001.09	ALGODON ODONTOLOGICO (TRENZADO Y/O LISO) PAQUETE X 1000 UNIDADES	ALGODON ELABORADO A PARTIR DE LA FIBRA TEXTIL (ALGODON NOILS) COMPUESTA DE UN 88-96% DE CELUOSA. ROLLOS 100% ALGODON- PARA USO ODONTOLOGICO- RESISTENTES Y FLEXIBLES QUE GARANTICEN BUENA ABSORCION (HIDROFILOS). SIN DESPREDIMIENTO DE FIBRAS DURANTE SU USO. PROCESOE STANDARIZADO Y CERTIFICADO NORMA ISO 9001- 2000
2501338	42151660	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	APLICADOR MICROPINCEL FINO DE 1.5 MM DE FACIL MANEJO FRASCO DISPENSADOR X 100 UNIDADES	APLICADOR DE FACIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DE ESTE CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN-PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A AREAS DE DIFCIL ACCESO SEGUN EL MATERIAL

2503032	42151660	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	APLICADOR MICROPINCEL PUNTA CILINDRICA/ULTRAFINA- FINA Y NORMAL PAQUETE POR 100 UNIDADES	APLICADOR MICROPINCEL ULTRAFINO CON CODIGO CILINDRICA- QUE LE PERMITE ACCEDER SIN DIFICULTAD A CIERTAS ZONAS DE LA CAVIDAD DENTAL. LOS MICROAPLICADORES PERMITEN DOBLAR LA CODIGO PARA CREAR UN ANGULO QUE FACILITE SU USO
2501694	42152502	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	RO	A.02.02.01.002.007	BABERO DESECHABLE ROLLO DE 80-100 UNIDADES	BABERO IMPERMEABLE PRE-FORMADO-ELABORADO EN TELA SMS/SS CON TIRAS PARA AMARRAR TAMBIEN PRE-PERFORADAS. TAMAÑO EXTRAGRANDE DE (50 A 60) cm X (50-60) cm. DE 60-100 UNIDADES. DIFERENTES COLORES.
2501695	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	RO	A.02.02.01.004.001	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA- EN ACERO INOXIDABLE. ROLLO X 3 m	BANDA EN ACERO INOXIDABLE- PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES- FACIL DE COLOCAR- QUITAR- FLEXIBLE- FUERTE PARA RESISTIR LA PRESION DE CONDENSACION DEL MATERIAL OBTURANTE. EXTRAFINA (0.5 MM) DE 7 MM DE ANCHO.
2501696	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	RO	A.02.02.01.004.001	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA- EN ACERO INOXIDABLE- ROLLO X 3 METROS	BANDA EN ACERO INOXIDABLE- PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES- FACIL DE COLOCAR- QUITAR- FLEXIBLE- FUERTE PARA RESISTIR LA PRESION DE CONDENSACION DEL MATERIAL OBTURANTE. EXTRAFINA (0.5 mm) DE 5 mm DE ANCHO.
2501900	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CARETA VISOR PROTECCION LUZ FOTOCURADO UNIDAD	CARETA LIVIANA CON SOPORTE METALICO DE DISEÑO ERGONOMICO Y APOYO ANATOMICO EN EL PUENTE NASAL PARA PROTECCION- CON VISORES INTERCAMB IABLES- TRANSPARENTES Y PROTECTORES DE LUZ FOTOCURADO CON LEVENTE DE LAMINA DE 90° Y ANTIEMPAÑANTE
2501904	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.003.005	CEMENTO FOSFATO DE ZINC- KIT-FRASCO+POLVO (OXIDO DE ZINC) 32G + FCO + LIQUIDO (ACIDO FOSFORICO 35%) 15-17ml	CEMENTO FOSFATO DE ZINC- DE REACCION ACIDO-BASE- ALTA RESISTENCIA Y BAJA SOLUBILIDAD. SE PRESENTA EN FORMA DE POLVO Y LIQUIDO. EL POLVO A BASE DE OXIDO DE ZINC 90% Y OTROS OXIDOS COMO EL DE MAGNESIO-BISMUTO Y SILICIO. EL LIQUIDO ES UNA COMBINACION DE ACIDO FOSFORICO (55 AL 65%) Y AGUA EN PORCIONES MAS O MENOS IGUALES-CON ALGUNAS SALES DE ZINC Y ALUMINIO COMO BUFFER. CON FRAGUADO POR CRISTALIZACION EN UN TIEMPO MINIMO DE 4 MINUTOS Y MAXIMO DE 8 MINUTOS. APLICACIONES-EN BASE CAVITARIA- EN CEMENTACION DE INCRUSTACIONES Y APARATOS DE ORTODONCIA-SELLADO DE CONDUCTOS RADICULARES Y

								CEMENTACION DE CORONAS Y PUENTES. FRASCO + POLVO 32g Y FRASCO + LIQUIDO 15-17ml
2503373	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.003.005	CEMENTO IONOMERO VIDRIO AUTOCURADO KIT (FRASCO POLVO DE 10 A 15 G / FRASCO LIQUIDO DE 5.6 A 8.5 ml)	IONOMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE CON LIBERACION DE FLUOR- ADHESION QUIMICA-BIOCOMPATIBLE RADIOPACO PARA RECONSTRUCCION DE MUÑONES. MATERIALES QUE SE MEZCLAN A PARTIR DE UN POLVO DE VIDRIO Y DE ACIDO POLICARBOXILICO- QUE FRAGUAN EN UNA REACCION ACIDO BASE. USO-TERAPIA DE OBTURACION CONVENCIONAL. EN DIFERENTES TONOS RADIOPACOS. COMPOSICION- RELACION POLVO/LIQUIDO 3.4-1-ACIDO EN POLVO 25%- ACIDO EN LIQUIDO 75%. PRESENTACION- KIT (FRASCO POLVO DE 10 A 15 GR / FRASCO LIQUIDO DE 5.6 A 8.5 ml)
2501999	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.003.005	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA-JERINGA DISPENSACION CLICKER X 12 GR + PRIMER 6.5 ml	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA FOTOCURADO- MODIFICADO POR RESINAS Y PRESENCIA DE REACCION ACIDO-BASE- CON RELLENO DE NANOTECNOLOGIA Y SISTEMA PASTA/PASTA. ALTA LIBERACION DE FLUOR- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE-POLIMERIZACION POR CAPAS- RADIOPACO. INDICADO EN RESTAURACIONES DE DIENTES PRIMARIOS- RESTAURACIONES PEQUEÑAS CLASE I- RESTAURACIONES CLASE III Y V-RESTAURACIONES TEMPORALE S-RECONSTRUCCION DE MUÑONES. FACIL DE MEZCLAR Y DISPENSAR. PRESENTACION KIT-CLICKER DE 12 gr (A2- A2- A3)- PRIMER 6.5 ml
2504827	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO-LINER O FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO. PRESENTACION - CLICKER 10 gr	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO-LINER O FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO. LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR BIOCOMPATIBILIDAD ALTA- NO REQUIERE PRE-TRATAMIENTO DE LA DENTINA- ALTA ADHESION A DENTINA- REDUCE EL EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMERIZACION. FOTOCURADO.TIENE LIBERACION DE FLUOR Y REMINERALIZACION DEL FONDO DE LA CAVIDAD. USO- BASE/LINER BAJO RESTAURACIONES DE COMOPOSITE- AMALGAMAS- CERAMICAS- METAL. PRESENTACION- CLICKER 10gr
2501145	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	CEMENTO IONOMERO VIDRIO CEMENTANTE. KIT (FRASCO POLVO DE 35 gr Y FRASCO	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL TIPO I- RADIOPACO- LIBERACION DE FLUOR-SELLADO MARGINAL- DURADERO-BIOCOMPATIBLE- AMPLIO TIEMPO DE TRABAJO. COMPUESTO POR FLUOR SILICATO DE VIDRIO-ACIDO POLICARBOXILICO- LIQUIDO COMPUESTO POR ACIDO TARTARICO Y AGUA. SOLUBILIDAD

							LIQUIDO DE 15-35 ml	INFERIOR AL 0.1 %- ADHESION QUIMICA- INDICADO PARA CEMENTAR INCRUSTACIONES INLAYS Y ONLAYS METALICOS- CORONAS Y PUENTES METAL- CERAMICOS- BANDAS DE ORTODONCIA
2501998	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.003.005	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA LINER CAVITARIO (FOTOCURADO) KIT (FRASCO POLVO X 9-12 gr FRASCO LIQUIDO X 5-6 ml)	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASE O LINER CAVITARIO CON LIBERACION DE FLUOR- ALTA FUERZA COMPRESIVA Y TENSION DIAMETRAL- BIOCOMPATIBLE- BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA- RADIOPACO- MODIFICADO CON RESINA PARA ADHESION QUIMICA A ESTRUCTURA DENTARIA- FORMADO POR CRISTALES DE FLUORALUMINOSILICATO. EL LIQUIDO DEBE SER ACIDO POLIALQUENOICO- AGUA Y 2 HEMA
2501902	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL- RADIOPACO. FRASCO X 38-40 gr	MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL- SIN EUGENOL- RADIOPACO- QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO- DE COLOR SIMILAR AL DIENTE- PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION- OXIDO DE ZINC- SULFATO DE ZINC- HIDRATO- SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO- RESINA EVA- FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II- CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA. FRASCO X 38-40 gr
2501909	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL UNIDAD	CEPILLO CON MANGO DE LONGITUD MEDIA DE FACIL AGARRE Y MANIPULACION- DE CERDAS DURAS QUE PERMITAN EL RETIRO DE MATERIAL DEL INSTRUMENTAL
2501908	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CEPILLO PARA PROFILAXIS- MANGO METALICO- DESECHABLE PARA CONTRA-ANGULO- UNIDAD	CEPILLO DESECHABLE DE BASE METALICA- DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGENEAS- PARA LIMPIEZA INTERPROXIMAL
2501910	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CEPILLOS SILICONADO/POLIAMIDA PARA PULIR RESTAURACIONES EN RESINA/UNIDAD	CEPILLOS SILICONADOS/POLIAMIDA PARA PULIR RESTAURACIONES EN RESINA- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- MANGO DE LATON- PULIDO DE SUPERFICI ES OCLUSALES- SUPERFICIES CERVICALES Y ZONAS INTERPROXIMALES-CON CARBURO DE SILICIO INCORPORADO A SUS FIBRAS- COPA REGULAR- COPA PEQUEÑA

2501631	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.003.006	CEPILLO PULIR RESINA CAJA X 3 UNIDADES /COPA REGULAR- COPA PEQUEÑA- PUNTA	CEPILLOS DE POLIAMIDA PARA PULIR RESTAURACIONES EN RESINA- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- MANGO DE LATON- CON CARBURO DE SILICIO INCORPORADO EN SUS FIBRAS COPA REGULAR- COPA PEQUEÑA- CODIGO - INTERPROXIMAL X 3 UNIDADES.
2503920	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CESTA O CANASTILLA PARA POSICIONADOR RADIOGRAFICO - EN PLASTICO	CESTA O CANASTILLA PARA POSICIONADOR RADIOGRAFICO- EN PLASTICO RESISTENTE- AUTOCLAVABLE
2503319	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CUBETA PLASTICA INSTRUMENTAL MEDIANA- RESISTENTE A SOLVENTES- PARA INACTIVAR INSTRUMENTAL	CUBETA RESISTENTE A SOLVENTES- PARA DESACTIVAR INSTRUMENTAL CONTAMINADO CUBETA PLASTICA RESISTENTE A SOLVENTES- TAPA A JUSTABLE CON SEGURO LATERAL- DE COLOR AZUL- TAMAÑO DE 36cm DE LARGOx24cm DE ANCHOx16cm DE ALTO
2584603	42151663	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.001	CUÑAS DE MADERA SURTIDAS EN FORMA DE PIRAMIDE ALARGADA. PAQUETE POR SEIS (6) UNIDADES	CUÑA DE MADERA DURA- DE NARANJO- ROBLE- NOGAL- EN FORMA DE PIRAMIDE ALARGADA- DE TAMAÑO ADECUADO AL ESPACIO INTERDENTARIO- EN PAQUET E DE SEIS TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR EL COLOR. PARA PROCEDIMIENTOS DE OPERATORIA PARA ADOSAR MATRICES AL DIENTE
2503491	42151805	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISCO DE SILICONA PARA PULIR RESINA	DISCO ABRASIVO DE RESINA Y OXIDO DE ALUMINIO- CON MANDRIL PLASTICO. RESINA DE DIMETACRILATO- OXIDO DE ALUMINIO Y DIOXIDO DE SILICE.P RESENTACION-PARTE ACTIVA DE DIFERENTES FORMAS-GRANDE- COPA- DISCO- ETC. USO- SISTEMA DE ACABADO Y PULIDO DE RESTAURACIONES EN DOSPASOS. USO EXCLUSIO ODONTOLOGICO. DESCARTABLES
2501935	42151805	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISCO PULIDOR RESINA EXTRAFINO DE CONTORNEADO Y PULIDO TAMAÑO 1/2 GRANO GRUESO	DISCO PULIDOR DE RESINA PARA ACABADO Y PULIDO DE RESINAS COMPUESTAS- AMALGAMAS- METALES. MONTADO SOBRE PLASTICO DE DISTINTO GROSOR- DE ABRASIVO ADECUADO PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADO PARA OPTIMIZAR LA ESTETICA DE LOS COMPOSITE. COMBINA UN

								APOYO FLEXIBLE CON (O SIN) UN OJILLO REDONDO. CODIFICADO POR COLORES
2501937	42151805	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISCO PULIDOR RESINA EXTRAFINO DE CONTORNEADO Y PULIDO TAMAÑO 3/8 GRANO FINO. BOLSA X 85 UNIDADES	DISCO PULIDOR DE RESINA DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE PLASTICO DE DISTINTO GROSOR- DE ABRASIVO ADECUADO PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADO PARA OPTIMIZAR LA ESTETICA DE LOS COMPOSITE. COMBINA UN APOYO FLEXIBLE CON (O SIN) UN OJILLO REDONDO
2501938	42151805	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISCO PULIDOR RESINA EXTRAFINO DE CONTORNEADO Y PULIDO TAMAÑO 3/8 GRANO MEDIANO. BOLSA X 85 UNIDADES	DISCO PULIDOR DE RESINA DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE PLASTICO DE DISTINTO GROSOR- DE ABRASIVO ADECUADO PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADO PARA OPTIMIZAR LA ESTETICA DE LOS COMPOSITE. COMBINA UN APOYO FLEXIBLE CON (O SIN) UN OJILLO REDONDO
2501939	42151805	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISCO PULIDOR RESINA EXTRAFINO DE CONTORNEADO Y PULIDO TAMAÑO 3/8 GRANO SUPERFINO. BOLSA X 85 UNIDADES	DISCO PULIDOR DE RESINA DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE PLASTICO DE DISTINTO GROSOR- DE ABRASIVO ADECUADO PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADO PARA OPTIMIZAR LA ESTETICA DE LOS COMPOSITE. COMBINA UN APOYO FLEXIBLE CON (O SIN) UN OJILLO REDONDO
2584759	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	ENJUAGUE ORAL CON DESENSIBILIZANTE FRASCO X 180ml CON COPA DOSIFICADORA	ENJUAGUE ORAL CON DESENSIBILIZANTE- LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO. PRINCIPIO ACTIVO NITRATO DE POTASIO 5.0g + EXIPIENTES. pH- 6-6- 7.2. CON SABOR A MENTA. USO- EN LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINAL SECUNDARIA A TRATAMIENTO QUIRURGICO Y/O PROFILAXIS. PRESENTACION- FRASCO X 180 ml CON COPA DOSIFICADORA
2501943	42151627	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A-02.02.01.003.007	ESPEJO DE BOCA SIN MANGO N°5 SIN AUMENTO	ESPEJO DE BOCA N°5 SIN AUMENTO- DE SUPERFICIE FRONTAL- REDONDO- CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO.

2501957	42151635	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	PK	A.02.02.01.003.006	EYECTOR DE SALIVA PAQUETE X 100 UNIDADES	DISPOSITIVO ODONTOLOGICO PARA LA EVACUACION DE FLUIDOS. BOQUILLAPLASTICA EN PVC- CUERPO EN PVC TRANSLUCIDO Y FLEXIBLE- ALAMBRE RECUBIERTO SIN MEMORIA. EL MATERIAL PLASTICO ES NO TOXICO- LA BOQUILLA CON ACABADO REDONDEADO PARA EVITAR LESIONES. LARGO13/15cm- DIAMETRO INTERNO 4 + O - 0.5mm
2504831	42151905	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	FLUOR EN BARNIZ 5% 0.50 ml EN 20 ml MONODOSIS- CON ALTO CONTENIDO DE FLUOR. MONODOSIS	BARNIZ BLANCO DE FLUORURO DE SODIO AL 5%- CON ALTO CONTENIDO DE FLUOR- TECNOLOGIA DE FOSFATO DE CALCIO (TCP) QUE AYUDAD A LA LIBERACION PROLONGADA DE FLUOR- CALCIO Y FOSFATO. USOS- PARA OBTURACION DE TUBULOS DENTINALES QUE AYUDA A REDUCIR LA SENSIBILIDAD- PREVENCION DE CARIES. ENDURECE RAPIDAMENTE EN PRESENCIA DE SABIVA. VISIBLE A LA APLICACION. PRESENTACION- MODOSIS.
2500204	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO REDONDA N° 2 UNIDAD	FRESAS CARBURO REDONDA No.2. PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD- EFICIENTE EN EL CORTE- DURABILIDAD DE ALTO GRADO A LA FRACTURA BAJA VIBRACION Y CAPACIDAD PARA REMOVER RESTAURACIONES
2500205	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO REDONDA N° 3 UNIDAD (SURTIDA)	FRESAS CARBURO SURTIDAS REDONDA No.3. PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD- EFICIENTE EN EL CORTE- DURABILIDAD DE ALTO GRADO A LA FRACTURA BAJA VIBRACION Y CAPACIDAD PARA REMOVER RESTAURACIONES
2505436	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#701 T/CORTO	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#701 T/CORTO REF. 500 315 168 007 012
2505437	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#702 T/CORTO	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#702 T/CORTO REF. 500 315 168 007 016
2505438	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#703 T/CORTO	FRESA CARBURO TUNGSTENO FG#703 T/CORTO REF. 500 315 168 007 021
2500061	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DE ARKANSA BLANCA- UNIDAD	FRESA DE ARKANSA USO ODONTOLOGICO- FRESA DE ARKANSA- BLANCA- CONICA Y REDONDA

2503048	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL CONO INVERTIDO TAMAÑO SURTIDO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-DOTADO DE SELECCIONA PARA LOS INSTRUMENTOS. DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE-LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2501965	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PERA N° 808/009-808/010	FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA- LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR- GRANO (MEDIO Y GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR- RESISTENTE A LA CORROSION. MARCA Y LOTE IMPRESO EN EL VASTAGO. CUMPLA NORMA ISO 6360
2503045	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE CILINDRICA TAMAÑO SURTIDO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-DOTADO DE SELECCIONA PARA LOS INSTRUMENTOS. DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE-LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503049	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE INTERPROXIMAL TAMAÑO SURTIDO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-DOTADO DE SELECCIONA PARA LOS INSTRUMENTOS. DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE-LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503781	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE LLAMA SURTIDA DIFERENTES GRANOS	FRESA DIAMANTE LLAMA- CON RECUBRIMIENTO GALVANICO- GRANO DE DIAMANTE HOMOGENEO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO Y CE-LARGA VIDA UT IL- DIAMETRO DEL MANGO PERFECTAMENTE AJUSTABLE A LA PIEZA DE MANO- CON EFICACIA DE CORTE SOBRESALIENTE. MARCA Y LOTE IMPRESO EN EL VASTAGO. CUMPLA NORMA ISO 6360. USO- TALLADO-DISPONIBLE EN DIFERENTES GRANOS. DIAMETRO DE LA CABEZA- 016mm. ISO 233 Ø 016mm-LONGITUD DE LA CODIGO 19.0mm

2503047	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PERA TAMAÑO SURTIDO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-DOTADO DE SELECCIONA PARA LOS INSTRUMENTOS. DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE-LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503016	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE OPERATORIA SURTIDAS PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD-INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA- LA PARTE ACTIVA6 360
2503772	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE REDONDA SURTIDAS DIAMETRO DIFERENTES GRANOS	FRESA DIAMANTE REDONDA- CON RECUBRIMIENTO GALVANICO- GRANO DE DIAMANTE HOMOGENEO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO Y CE- LARGA VIDAU TIL-DIAMETRO DEL MANGO PERFECTAMENTE AJUSTABLE A LA PIEZA DE MANO- CON EFICACIA DE CORTE SOBRESALIENTE. MARCA Y LOTE IMPRESO EN ELV ASTAGO. CUMPLA NORMA ISO 6360. USO- FRESA DE ALTA VELOCIDAD. DISPONIBLE EN DIFERENTES GRANOS. LONGITUD DE LA CABEZA- 0.8mm. ISO 801 Ø 008mm-LONGITUD DE LA CODIGO 19.0mm
2503046	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE TALLA TRONCOCONICA SURTIDAS	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-DOTADO DE SELECCIONA PARA LOS INSTRUMENTOS. DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE-LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503769	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA PLANA (TPP) 170/010-012-014-016-023. LONGITUD CABEZA 4-5MM. DIFERENTES GRANOS	FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA CODIGO PLANA (TPP)- CON RECUBRIMIENTO GALVANICO-GRANO DE DIAMANTE HOMOGENEO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMA S ISO Y CE-LARGA VIDA UTIL- DIAMETRO DEL MANGO PERFECTAMENTE AJUSTABLE A LA PIEZA DE MANO- CON EFICACIA DE CORTE SOBRESALIENTE. MARCA Y LOTE IMPRESO EN EL VASTAGO. CUMPLA NORMA ISO 6360. USO- TALLADO-DISPONIBLE EN DIFERENTES GRANOS. LONGITUD DE LA CABEZA 4-5mm. ISO 170 Ø 010-012-014- 016-023.

2503770	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA DIAMANTE TPR 196/009-012-016-025	FRESA DIAMANTE TPR 196/009-012-016-025
2503017	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA PARA PULIDO SURTIDAS PARA ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES DE OBTURACION Y COMPOSITE/CARA PALATINA-ZONA PROXIMAL-ZONA CERVICAL	FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA EL PULIDO DE OBTURACIONES ELABORADAS EN RESINA- LA PARTE ACTIVA VIENE EN DIFERENTE GROSOR DE GRANO (FINO-ULTRAFINO- BLANCO Y AMARILLO)- RESISTENTE A LA CORROSION
2503050	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA TAMAÑO SURTIDO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTE BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-SELECCIONADA PARA LOS INSTRUMENTOS DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE- LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503715	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA PULIR RESINA PERA DORADA N°023	FRESA CON CUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO (QUE ABSORBE PARTE DEL CALOR DE LA FRICCION Y DURA MAS). INDICADA PARA TALLADOS- CONFIGURAR- PARA MEDIR PROFUNDIDAD CON TOPE LATERAL. RESISTENTE A LA CORROSION. NORMA ISO 6360
2503051	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA TAMAÑO SURTIDO	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTA BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO- DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-SELECCIONADO PARA LOS INSTRUMENTOS DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE- LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503052	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA PUNTO CONTACTO SURTIDAS	INSTRUMENTO DE DIAMANTE QUE CONSTA BASICAMENTE DE UN MANGO Y UN CUERPO PERFILADO DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO-SELECCIONADA PARA LOS INSTRUMENTOS DE GIRO SILENCIOSO Y SIN VIBRACIONES- ALTA EFICIENCIA AL DESGASTE- LARGA DURACION Y GARANTIA DE CALIDAD ISO. CORTAS
2503116	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESERO METALICO CON TAPA	FRESERO METALICO CON TAPA

2501898	46181804	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	GAFAS PROTECCION EN POLICARBONATO PARA LAMPARA DE FOTOCURADO-GRADUABLE. UNIDAD	GAFAS DE PROTECCION DE OJOS DE USO EN ODONTOLOGIA PARA LAMPARAS DE FOTOCURADO. LIGERA- LENTE EN POLICARBONATO ENVOLVENTE PARA MAYOR COBERTURA LATERAL- PUENTE NASAL DE GOMA ANTIDESLIZANTE- PROTECCION UV525NM- ANTIEMPAÑANTE- ANTI-RASGUÑO- LONGITUD DE PANTALLA GRADUABLE
2584715	42151600	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	GANCHO PARA RADIOGRAFIA METALICO	EN ACERO INOXIDABLE
2503088	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	HIDROXIDO DE CALCIO JPR 2 gr. PASTA BLANCA DE TEXTURA CREMOS-INODORA-REABSORBIBLE - CON ACCION ANALGESICA Y HEMOSTATICA	PASTA BLANCA DE TEXTURA CREMOS- INODORA-REABSORBIBLE- CON ACCION ANALGESICA Y HEMOSTATICA. PASTA RADIOPACA- QUE NO ENDURECE. INGREDIENTE ACTIVO- HIDROXIDO CE CALCIO- OXIDO DE ZINC Y SUFATO DE BARIO. USO- PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS- EN FRACTURA HORIZONTAL DE LA RAIZ- TRATAMIENTO DE CONDUCTOS CON EXHUDADO CRONICO- ENTRE OTROS. PROTEGER DE LA LUZ. JERINGA DE 2 gr
2502008	42151806	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	SOB	A.02.02.01.004.001	LIJA ABRASIVA METALICA SOBRE 12 X UNIDADES	TIRA METALICA POR 4 mm- COM GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL- ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METALICA- ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL
2502009	42151806	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.002	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA CAJA X 100 UNIDADES	TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL- ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA- ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES- DOS ANCHOS DIFERENTES PARA ADECUARSE EN EL CASO QUE SEAN MOLARES- PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS
2584724	42281600	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE TURBINAS PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD-LIMPIADOR BACTERIOSTATI	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE TURBINAS PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD- LIMPIADOR BACTERIOSTATICO- FUNGISTATICO- DETERGENTE. DE SINFECTANTE- BACTERICIDA (TBC- MRSA)- LEVURICIDA- VIRUCIDA CONTRA VIRUS ENVUELTOS HBV- HCV- VIH- HERPES SIMPLEX- INFLUENZA

							CO-FUNGISTATICO	
2584709	42281600	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO LIMPIEZA DESINFECTANTE ODONTOLOGICO DE 500 ml	LIQUIDO PARA LIMPIEZA- DESINFECCION- MANTENIMIENTO INTERNO DE MANGUERAS- NO PRODUCE ESPUMA- COMPATIBLE CON LOS MATERIALES A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO Y ACIDO AMIDOSULFON
2502059	31371400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A-02.02.01.003.007	LOSETA DE VIDRIO UNIDAD	EXTREMOS Y BORDES ROMOS- GROSOR ADECUADO PARA TRABAJAR SOBRE SU SUPERFICIE SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE FRACTURA
2503601	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23 mm- DESCARTABABLE DE TORNILLO PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD	MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23 mm- DESCARTABLE PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD Y CONTRA- ANGULO DE TORNILLO
2502064	42150000	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO X 175 gr- POLVO FINO DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO- INODORO	CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO- POLVO MUY FINO- IMPALPABLE- DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO- INODORO. LIBRE DE GRANULOS Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. UTILIZADO PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO CUANDO SE COMBINA CON EL EUGENOL. PROTEGER DE LA LUZ. USO- PROFE SIONAL ODONTOLOGICO.
2502151	42152601	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.002	PAPEL ARTICULAR DE DOBLE COLOR CUADERNILLO X 12 HOJAS RECTAS	CUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ- ULTRADELGADO- RESISTENTE AL ROMPIMIENTO. DE 12 MICRAS- PARA VERIFICACION DE OCLUSION. POR 12 HOJAS
2502065	53131506	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	PASTA PARA PROFILAXIS FRASCO 340 GR PARA PROFILAXIS DENTAL- TUBO COLAPSIBLE	PASTA SUAVE- VISCOSA- DE BASE HIDROSOLUBLE- SABORIZADA- MINIMA ABRASION- DE GRANO FINO/MEDIO O GRUESO. PARA PROFILAXIS DENTAL- CON FLUOR O SIN FLUOR- CON SILICATO DE ALUMINIO O SILICATO DE ZIRCONIO- SILICATO DE SODIO O PIEDREA POMEZ Y OTROS. SE UTILIZA PARA PROCES OS DE LIMPIEZA Y PULIDO DENTAL SIN DAÑAR EL ESMALTE. TUBO COLAPSIBLE POR 340 GRAMOS.

2502915	53131506	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PASTA PARA PROFILAXIS POTE X 50 GR. PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL- FRASCO POR 50G	PASTA SUAVE- VISCOSA- DE BASE HIDROSOLUBLE- SABORIZADA- MINIMA ABRASION- DE GRANO FINO/MEDIO O GRUESO. PARA PROFILAXIS DENTAL- CON FL UOR O SINFLUOR- CON SILICATO DE ALUMINIO O SILICATO DE ZIRCONIO- SILICATO DE SODIO O PIEDREA POMEZ Y OTROS. SE UTILIZA PARA PROCESOS DE LIMPIEZA Y PULIDO DENTAL SIN DAÑAR EL ESMALTE. FRASCO POR 50g
2502996	42150000	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PASTA PARA PULIR RESINA JERINGA X 5 GR	PASTA DIAMANTADA PARA PULIMENTO DE RESINA TIPO LUMINESCENCE
2503006	42150000	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	EDTA + PEROXIDO DE UREA JERINGA X 5- 9 gr- CREMA PARA LA PREPARACION DE CONDUCTOS RADICULARES	CREMA PARA LA PREPARACION DE CONDUCTOS RADICULARES- QUE CONTIENE ACIDO ETILDIAMINA TETRA-ACETICO 15% Y PEROXIDO UREICO 10%- SOLUBLE EN AGUA QUE LUBRICA EL CONDUCTO PERMITIENDO LA ENTRADA DE LOS INSTRUMENTOS FACILMENTE
2502071	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA- SURTIDAS- DE DIFERENTES FORMAS	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINAS EN DIFERENTES FORMAS CILINDRICA- CONO INVERTIDO- LLAMA- REDONDA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
2502139	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA CILINDRICA- PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA EN DIFERENTES FORMAS CILINDRICA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD.
2502138	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA CONICA- PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA EN DIFERENTES FORMAS CONICA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD.
2502137	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA LLAMA- PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA EN DIFERENTES FORMAS LLAMA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
2502136	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA REDONDA- PARA PIEZA DE	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINA EN DIFERENTES FORMAS LLAMA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD

							ALTA VELOCIDAD	
2502075	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	PORTADISCOS CONTRANGULO	UTILIZADO PARA EL MONTAJE DE LOS DISCOS PARA PULIR RESINA EN CONTRAANGULO DE PIEZA DE BAJA.
2502079	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTA CAUCHO SILICONADA PULIR RESINA	CODIGOS PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD- CODIGOS DE ACABADO Y PULIDO TANTO OCLUSAL COMO INTERPROXIMAL- LA PARTE ACTIVA VIENE EN 4 DIFERENTES FORMAS (LLAMA PEQUEÑA- LLAMA GRANDE- COPA Y DISCO) CON TRES GRADOS DE ABRASION- RESISTENTE A LA CORROSION- BAJA VIBRACION.
2500047	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDAD. PRESENTACION EN UNIDAD	CODIGOS PARA JERINGA TRIPLE- EN ACERO INOXIDABLE- AUTOCLAVABLE. CODIGO PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDAD
2502881	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTAS PARA PULIR RESINA- PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD-	CODIGO ABRASIVA DE RESINA Y OXIDO DE ALUMINIO- CON MANDRIL PLASTICO. RESINA DE DIMETACRILATO- OXIDO DE ALUMINIO Y DIOXIDO DE SILICE. PRESENTACION- PARTE ACTIVA DE DIFERENTES FORMAS- LLAMA PEQUEÑA- LLAMA GRANDE- COPA- DISCO- ETC. USO- SISTEMA DE ACABADO Y PULIDO DE RESTAURACIONES EN DOS PASOS. USO EXCLUSIO ODONTOLOGICO. DESCARTABLES.
2502146	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA INCISAL- DE NANOPARTICULA- JERINGA DE 3-4 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.
2502095	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL A1. JERINGA X 3.5 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.

2502096	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL A2. JERINGA X 3.5 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.
2502097	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL A3. JERINGA X 3.5-5 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.
2587186	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA JERINGA PRELLENADA	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.
2500897	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA ESMALTE B1 JERINGA X 3.5-4 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA DE FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA UNIVERSAL.
2500930	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA ESMALTE B2 JERINGA X 3.5-4 gr	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTICULA- FACIL MANIPULACION- RADIOPACA- BAJA CONTRACCION DURANTE LA POLIMERIZACION- RESISTENCIA AL DESGASTE- PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES- EN DIFERENTES TONOS- COMPATIBLES CON EL ADHESIVO RESINA OFERTADO.
2504644	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA PARA POSTERIORES- CON NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACION - PRESENTACION	RESINA CON NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACION DE DIENTES POSTERIORES- DE COLOCACION EN UN SOLO BLOQUE. RESINA DE NANO RELLENO. COLOCACION EN BLOQUE DE HASTA 5 mm. MONOMEROS QUE DISMINUYEN EL ESTRES DE POLIMERIZACION. RAPIDO Y FACIL DE UTILIZAR. PRESENTACION JERINGA PRELLENADA X 4 gr COLORES SURTIDOS

							POR 4 gr COLORES SURTIDOS	
2502089	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA FLUIDA A1 JERINGA X 2 gr	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO-FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO QUE PERMANEZCA EN SU LUGAR HASTA SER FOTOPOLIMERIZADO- RESISTENCIA AL DESGASTE- RADIOPACA- EN DIFERENTES TONOS-COMPATIBLE CON EL ADHESIVO- RESINA COMPUESTA OFERTADO PARA TENER MEJORES PROPIEDADES. PRESENTACION EN JERINGA PRELLENADA.
2501138	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA FLUIDA A2 JERINGA DE 1 A 3 gr-MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO-FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO-FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO QUE PERMANEZCA EN SU LUGAR HASTA SER FOTOPOLIMERIZADO- RESISTENCIA AL DESGASTE- RADIOPACA- EN DIFERENTES TONOS-COMPATIBLE CON EL ADHESIVO- RESINA COMPUESTA OFERTADO PARA TENER MEJORES PROPIEDADES.
2501139	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA FLUIDA A3 JERINGA DE 1 A 3 gr-MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO DE BAJA VISCOASIDAD-FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO DE BAJA VISCOSIDAD- FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO QUE PERMANEZCA EN SU LUGAR HASTA SER FOTOPOLIMERIZADO- RESISTENCIA AL DESGASTE- RADIOPACA- EN DIFERENTES TONOS-COMPATIBLE CON EL ADHESIVO- RESINA COMPUESTA OFERTADO PARA TENER MEJORES PROPIEDADES
2500346	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA FLUIDA A 3.5 JERINGA PRELLENADA X 2 gr- MATERIAL RESTAURADOR - FOTOPOLIMERIZABLE	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO-FOTOPOLIMERIZABLE- CON NANORRELLENO QUE PERMANEZCA EN SU LUGAR HASTA SER FOTOPOLIMERIZADO- RESISTENCIA AL DESGASTE- RADIOPACA- EN DIFERENTES TONOS-COMPATIBLE CON EL ADHESIVO- RESINA COMPUESTA OFERTADO PARA TENER MEJORES PROPIEDADES
2503775	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA A3-RESINA HIBRIDA MICRO-RELLENA- PRE-FOTOCURADA PARA	RESINA COMPUESTA HIBRIDA MICRO-RELLENA-PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. CON RESISTENCIA AL DESGASTE- ALTA RESISTENCIA MECANICA. PARA RESTAURACIONES DIRECTAS POSTERIORES-RECONSTRUCCION DE MUÑONES. JERINGA PRELLENADA DE 3-5 gr

							RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. Jeringa prellenada (JPR) 3-5G	
2504435	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA PARA POSTERIORES B1 JPR 4 gr COMPUESTA-CON TECNOLOGIA DE NANORELLENO-DE UNA SOLA CAPA- FACIL DE USAR	RESINA COMPUESTA HIBRIDA MICRO-RELLENA-CON TECNOLOGIA DE NANORESTAURACION- LO QUE MEJORA LA RESISTENCIA- MEJOTRA LA MANIPULACION Y RESISTENCIA AL DESGASTE. PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. ALTA ESISTENCIA MECANICA. PARA RESTAURACIONES DIRECTAS. PRESENTACION- JERINGA PRELLENADA DE 4 gr
2503776	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA B2-RESINA HIBRIDA MICRO-RELLENA- PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. JPR 3-5 gr	RESINA COMPUESTA HIBRIDA MICRO-RELLENA-PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. CON RESISTENCIA AL DESGASTE- ALTA RESISTENCIA MECANICA. PARA RESTAURACIONES DIRECTAS POSTERIORES-RECONSTRUCCION DE MUÑONES. JERINGA PRELLENADA DE 3-5 gr
2503777	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA COMPUESTA C2-RESINA HIBRIDA MICRO-RELLENA- PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. JPR 3-5g	RESINA COMPUESTA HIBRIDA MICRO-RELLENA-PRE-FOTOCURADA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES POSTERIORES. CON RESISTENCIA AL DESGASTE- ALTA RESISTENCIA MECANICA. PARA RESTAURACIONES DIRECTAS POSTERIORES-RECONSTRUCCION DE MUÑONES. JERINGA PRELLENADA DE 3-5 gr
2503037	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA TRANSLUCIDA A2 JERINGA X 4 gr-COMBINACION DE RELLENO DE SILICE NO AGLOMERADO	CONTIENE BIS-6MA- UDMA-TEGDMA Y BIS-EMA-PEGDMA. COMBINACION DE RELLENO DE SILICE NO AGLOMERADO (NO AGREGADO DE 20 nm DE RELLENO DE ZIRCONIO NO AGLOMERADO) NO AGREGADO DE 4 A 11 nm Y UN RELLENO CLUSTER AGREGADO DE ZIRCONIO/SILICE Y PARTICULAS DE SILICE DE 20 nm Y ZIRCONIO DE 4 A 11 nm. TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTICULAS DE CLUSTER DE 0-6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE

								RELLENO INORGANICO ES APOX 72-5% POR PESO (55-6% POR VOLUMEN) PRESENTACION JERINGA PRELLENADA POR 4 gr
2503778	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA UNIVERSAL COMPUESTA NANOHIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE-RADIOPACA-PARA RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. COLOR C2. JPR X 3-4	RESINA CONSTITUIDA POR UNA MATRIZ ORGANICA (MONOMEROS- TEGDMA- UDMA Y BIS-GMA)- DE ALTO PESO MOLECULAR- ESTRUCTURA ASIMETRICA QUE AUMENTA LA RIGIDEZ Y LA RESISTENCIA COMPRESIVA Y MENOS CONTRACCION DE POLIMERIZACION- BAJA VISCOSIDAD- FOTOPOLIMERIZABLE. CON RELLENO INORGANICO (MATERIAL DE REFUERZO) COMPUESTO POR CUARZO FUNDIDO- SILICATO-VIDRIO DE ZINC- ZIRCONIO Y OTROS- QUE AUMENTAN LA DUREZA- LA RESISTENCIA AL DESGASTE Y FACIL MANIPULACION. SE UTILIZA EN RESTAURACIONES DIRECTAS ANTERIORES Y POSTERIORES. COMPATIBLE CON ADHESIVO RESINA OFERTADO. DISPONIBLE EN CAPSULAS DE DOSIS UNICA O JERINGAS DE DOSIS MULTIPLES Y EN DIFERENTES TONOS.
2505296	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDOPOSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS - PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4GR.
2505297	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA-PRESENTACION JPR X 4 gr	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDOPOSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS - PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4 gr.
2505298	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA JPR X 4 gr	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDOPOSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS - PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4 gr
2587191	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA JPR X 4 gr	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDOPOSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS - PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4 gr
2505304	42152428	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESINA UNIVERSAL	RESINA UNIVERSAL NANOTECNOLOGIA B1- 4 gr RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA

							NANOTECNOLOGIA B1- JPR X 4 gr	NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDO POSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS. PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4 gr
2505300	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	JPR	A.02.02.01.003.005	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA JPR X 4 gr	RESTAURADOR UNIVERSAL CON EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA EN UN SENCILLO SISTEMA DE 8 TONOS- COMBINANDO LA FUERZA DE UN HIBRIDOPOSTERIORES- RECONSTRUCCION DE CUSPIDES Y CARILLAS - PRESENTACION JERINGA PRELLENADA 4 gr
2503485	42312201	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	RO	A.02.02.01.003.005	SEDA POLIFILAMENTO DE ALTA RESISTENCIA- BAÑADA EN CERA Y PARAFINA- PRESENTACION ROLLO POR 400 METROS	SEDA ELABORADA EN POLIFILAMENTO SINTETICO- ELASTICO Y RESITENTE- CON APLICACION DE CERA A TODO LO LARGO DEL HILO- PARAFINA. USO- PARA RETIRO DE LA PLACA BACTERIANA EN LOS ESPACIOS INTERPROXIMALES. ENVASE EN POLIPROPILENO- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. PRESENTACION POR 400 METROS.
2502102	42152423	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	FCO	A.02.02.01.003.005	SELLANTE DE COLOR BLANCO DE FOTOCURADO FRASCO X 6 ml	SELLANTE DE COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACION- BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACION DE FLUOR Y ALTA ADHESION AL ESMALTE. BAJA SOLUBILIDAD EN EL MEDIO ORAL- RESISTENTE A LA FUERZA MASTICATORIA- UTILIZADO PARA EL SELLADO DE FOSETAS Y FISURAS. PRESENTACION- FRASCO DE 6 ml
2502103	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	PK	A.02.02.01.003.006	SEPARADOR DE LENGUA PAQUETE	ELEMENTO PLASTICO DE BORDES ATRAUMATICOS USO ODONTOLOGICO- PARA RETRAER LA LENGUA Y FACILITAR AREA DE TRABAJO EN CAVIDAD ORAL.
2502107	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	KIT	A.02.02.01.004.001	SISTEMA DE ACABADO Y PULIDO PARA RESINA KIT (LLAMA PEQUEÑA- LLAMA GRANDE- COPA Y DISCO)	PULIDO DE ALTO BRILLO PARA APLICACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES- EN TRES GRADOS DE ABRACION- EN 4 FORMAS DE PRESENTACION- LLAMA PEQUEÑA- LLAMA GRANDE- COPA Y DISCO. KIT POR 12 UNIDADES.
2502110	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	SOB	A.02.02.01.003.006	TIRA DE MYLAR SOBRE X 50 UNIDADES	CINTAS DE POLIESTER TRANSPARENTE DE 4" X 3/8 POR 0.002. PRESENTACION. EN SOBRE DE 50 UNIDADES
2503039	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	TOALLA ABSORBENTE DE 33 cm X 45 cm EN GUATA	TOALLA ABSORBENTE DE PURA GUATA DE CELULOSA 20% Y POLIPROPILENO 20% Y DE ALTA ABSORCION- DE 2 CAPAS Y GROFADA- CON PELICULA DE POLIESTER.

							DE CELULOSA DE ALTA ABSORCION	
2503001	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A.02.02.01.003.006	VASO DAPPEN SILICONADO UNIDAD	VASO SILICONADO TIPO DAPPEN- FLEXIBLE CON VENTOSA INFERIOR QUE PERMITE SU FIJACION EN LA MESA DE TRABAJO- PERMITE MANIPULACION DE RE PEQUEÑO
2502113	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-5	C/U	A-02.02.01.003.007	VASO DAPEN DE VIDRIO UNIDAD	VASO DAPEN DE VIDRIO- RECIPIENTE DE BORDES ROMOS- GROSOR ADECUADO PARA TRABAJAR SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE FRACTURA- RESISTENTE AL CALOR. USO- MEZCLA DE ACRILICOS- RESINAS- AMALGAMAS- SELLANTES- ETC.
ODONTOPEDIATRIA								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502545	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.003.006	ARCO DE YOUNG PLASTICO PEDIATRICO	ARCO DE YOUNG FDE MATERIAL PLASTICO
2503146	42151600	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.003.006	BLOQUE DE MORDIDA EN GOMA O POLIACRILATO	BLOQUE DE MORDIDA EN GOMA O POLIPROPILENO- PARA MANTENER LA APERTURA BUCAL
2502909	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS- CON ANATOMIA OCLUSAL SUPERFICIAL- SUPERFICIE OCLUSAL GRUESA PA DERECHO
2502910	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS- CON ANATOMIA OCLUSAL SUPERFICIAL- SUPERFICIE OCLUSAL GRUESA PARA EVITAR PE IZQUIERDO
2502912	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE- PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS- CON ANATOMIA OCLUSAL SUPERFICIAL- SUPERFICIE OCLUSAL GRUESA PA DERECHO

2502911	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE-PREFABRICADAS-PREAJUSTADAS	REPUESTO DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE-PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS- CON ANATOMIA OCLUSAL SUPERFICIAL- SUPERFICIE OCLUSAL GRUESA PA IZQUIERDO
2501926	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.003.006	CORONA DE RESINA DE POLICARBONATO CAJA X 180 UNIDADES	CORONAS HECHAS DE RESINA DE POLICARBONATO CON MICROFIBRAS DE VIDRIO PARA USO A CORTO Y LARGO PLAZO- EN DIENTES ANTERIORES DEL ADULTO
2584702	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE-PREFABRICADAS-PREAJUSTADAS	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE-PREFABRICADAS- PREAJUSTADAS- CON ANATOMIA OCLUSAL SUPERFICIAL- SUPERFICIE OCLUSAL GRUESA PARA EVITAR PERFORACIONES- PAREDES PARALELAS- PARA DIENTES TEMPORALES POSTERIORES
2502006	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.003.006	FORMAS PLASTICAS PEDIATRICAS UNIDAD	CORONAS PREFORMADAS EN ACETATO TRANSPARENTE PARA USO EN DIENTES ANTERIORES TEMPORALES- EN DIFERENTES TAMAÑOS
2501961	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESA 169L PARA TALLA INTERPROXIMAL	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD-INDICADA PARA LA PREPARACION DENTAL- PARA COLOCACION DE CORONAS DE ACERO-RESISTENTE A LA CORROSION- ANGULO DE CORTE NEGATIVO- MAXIMA EFICIENCIA DEL CORTE- USO EN ODONTOPEDIATRIA- CUMPLA NORMA ISO 6360
2501426	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	C/U	A.02.02.01.004.001	GRAPAS ODONTOPEDIATRICAS Nº 2A-4-8A-14-14A-26	GRAPAS ODONTOPEDIATRICAS Nº 2A-4-8A-14
2502924	2152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	FCO	A.02.02.01.003.005	SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS-PRESENTACION FRASCO DE 7 ml	SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25%- LIQUIDO INCOLORO O LIGERAMENTE AMARILLO PALIDO- VISCOSO- DE OLOR CARACTERISTICO Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS- ASTRINGENTE- HEMOSTATICO PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES- PERMITE REALIZAR UNA RETRACCION GINGIVAL Y CIERTOS ACTOS QUIRURGICOS- NO CONTIENE EPINEFRINA- VIDA UTIL 3 AÑOS- PRESENTACION FRASCO GOTERO DE 7 ml

2501989	42152419	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-6	FCO	A.02.02.01.003.005	HIDROXIDO DE CALCIO AL 0-3%- LIQUIDO LECHOSOS CON SEDIMENTO BLANCO- FRASCO X 500 ml	HIDROXIDO DE CALCIO 0-3%- LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCO- INODORO- LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS- SOLUCION SOBRESATURADA DE HIDROXIDO DE CALCIO CON PH ALCALINO- INHIBIDOR BACTERIANO QUE NEUTRALIZA LA ACCION DE ACIDOS PRESENTES EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO- PRESENTA ACCION HEMOSTATICA- PROTEGERSE DE LA LUZ- PRESENTACION FRASCO/GARRAFA DE 500 ml

ORTODONCIA

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502149	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ABREBOCA SILICONA KIT DE 3 TAMAÑO S M L	INSTRUMENTO DE SILICONA DE FORMA TRAPEZOIDAL DE ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACION POR COMPRESION AGRADABLE CONFORT AL PACIENTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE RESISTENTE A LOS LIQUIDOS DE DESINFECCION. PERMITE MANTENER LA APERTURA BUCAL
2502150	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ABREBOCA POLICARBONATO KIT DE 3 TAMAÑOS S M L	INSTRUMENTO DE PLASTICO/TERMOPLASTICO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACION POR COMPRESION AGRADABLE CONFORT AL PACIENTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE RESISTENTE A LOS LIQUIDOS DE DESINFECCION. PERMITE MANTENER LA APERTURA BUCAL
2584571	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE AUSTRALIANO N°018 ROLLO X 7.6 MT	USO EN ORTODONCIA
2584569	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	FT	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE AUSTRALIANO N°014 ROLLO X 7.6 MT	USO EN ORTODONCIA
2584570	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE AUSTRALIANO N°016 ROLLO X 7.6 MT	USO EN ORTODONCIA
2584572	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE COAXIAL N° 015 ROLLO X 4 MT	USO EN ORTODONCIA

2584573	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE COAXIAL N° 017 ROLLO X 7.6 MT	USO EN ORTODONCIA
2584575	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE COBRE SUAVE N°0.60 MM ROLLO X 50 GR	USO EN ORTODONCIA
2584574	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE DE ACERO RECTANGULAR N°0.16 X 0.22	USO EN ORTODONCIA
2500056	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE DE NITINOL Nº 16	USO EN ORTODONCIA
2500054	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE DE NITINOL Nº 016 INFERIOR	USO EN ORTODONCIA
2500055	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE DE NITINOL Nº 14	USO EN ORTODONCIA
2500053	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE KOBAYASHI- EN ACERO INOXIDABLE PARA LIGAR HOOK. PRESENTACION EN ROLLO	ELEMENTO METALICO EN ACERO INOXIDABLE PARA LIGAR HOOK. TIENEN UNA JUNTA SOLDADA SOLIDA QUE PERMITE FABRICARLAS EN ALAMBRE DE MENOR DIAMETRO. LAS VENTAJAS DE ESTE ALAMBRE DE PEQUEÑO DIAMETRO .010"- SON QUE OCUPA MENOS SITIO EN LA ZONA DE AJUSTE DE LAS LIGADIURAS- APLICA MENOS FUERZA EN EL BRACKET. ACABADO BRILLANTE- RECOCIDO BLANDO A FONDO. DISPONIBLE EN CARRETES DE 454 G
2584576	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE LIGADURA N° 0.009 ROLLO X LIBRA	USO EN ORTODONCIA
2584577	42152717	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE LIGADURA N° 0.012 ROLLO X LIBRA	USO EN ORTODONCIA
2500057	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	ALAMBRE Nº 05	USO EN ORTODONCIA
2503427	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DEALAMBRE NIQUEL-TITANIO N° .018 INFERIOR DE CURVA INVERSA- EN ALAMBRE REDONDO	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO ENDURECIDO N° 018 INFERIOR DE CURVA INVERSA (RETRANOL- O ABRIDOR DE MORDIDA)- EN ALAMBRE REDONDO CON 42-45%- COBALTO 3%. CARACTERISTICAS: ALAMBRE DE FUERZA MEDIA (MAS RESILIENTE)- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- CON MAYOR RANGO RETRACCION

							COMPACTO-FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 2 UNIDADES	
2503428	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO N° .018 SUPERIOR DE CURVA INVERSA- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO-FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 2 UNIDADES	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO ENDURECIDO N° .018 SUPERIOR DE CURVA INVERSA (RETRANOL-O ABRIDOR DE MORDIDA)- EN ALAMBRE REDONDO CON 42-45%- COBALTO 3%. CARACTERISTICAS: ALAMBRE DE FUERZA MEDIA (MAS RESILIENTE)- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- CON MAYOR RANGO RETRACCION
2505222	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI 012 OVOIDE INFERIOR	ARCO DE ALEACION DE NIQUEL Y TITANIO REDONDO OVOIDE TRUEFORM INFERIOR REF. L0502. VERIFICADA CON EL MAS ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD. DUREZA Y ELASTICIDAD IDONEAS. SUPERFICIE CON DOBLE PULIDO MECANICO-ELECTROQUIMICO.
2505223	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI 012 OVOIDE SUPERIOR	ARCO DE ALEACION DE NIQUEL Y TITANIO REDONDO OVOIDE TRUEFORM SUPERIRO-VERIFICADO CON EL MAS ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD - DUREZA Y ELASTICIDAD IDONEAS. SUPERFICIE CON DOBLE PULIDO MECANICO-ELECTROQUIMICO.
2505224	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI RECTANGULAR 016 X 0.16 INF	ARCO DE ALAMB. NIQUEL -TITANIO RECTANGULAR 016 X 0.16 INFERIOR. L0512 - SU FORMA UNIVERSAL PUEDE USARSE INDISTINTAMENTE EN LA ARCADA. EXCELENTE RESISTENCIA- PERFECTA SECUENCIA DE ARCO PARA BRACKETS DE AUTOLIGADO.
2505225	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI RECTANGULAR 016X 0.16 SUP	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO RECTANGULAR 016 X 0.16 SUPERIOR. L0511 - SU FORMA UNIVERSAL PUEDE USARSE INDISTINTAMENTE EN LA ARCADA. EXCELENTE RESISTENCIA- PERFECTA SECUENCIA DE ARCO PARA BRACKETS DE AUTOLIGADO.
2505226	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI RECTANTANGULAR 016 X .22 INF	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO RECTANGULAR 016 X 22 INFERIOR. L0514. SU FORMA UNIVERSAL PUEDE USARSE INDISTINTAMENTE EN LA ARCADA. EXCELENTE RESISTENCIA- PERFECTA SECUENCIA DE ARCO PARA BRACKETS DE AUTOLIGADO.

2505227	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO ALAMBRE NI-TI RECTANGULAR 016 X .22 SUP	ARCO DE ALAMBRE NIQUEL-TITANIO RECTANGULAR 016 X 22 SUPERIOR. SU FORMA UNIVERSAL PUEDE USARSE INDISTINTAMENTE EN LA ARACAD. EXCELENTE RESISTENCIA- PERFECTA SECUENCIA DE ARCO PARA BRACKETS DE AUTOLIGADO.
2584687	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO TAMAÑO 0.16 X 0.16 INFERIOR	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.16 X 0.16 INFERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO-FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO- FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS- MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE. USOS- EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS. PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION- PAQUETE POR 10 UNIDADES
2584684	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO 0.16 X 0.16 SUPERIOR	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.16 X 0.16 SUPERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO-FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO: FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS- MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE. USOS- EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS- PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION: PAQUETE POR 10 UNIDADES.

2584685	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO 0.16 X 0.22 INFERIOR	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.16 X 0.22 INFERIOR- EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACISA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO- FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS- MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE. USOS- EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS- PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION- PAQUETE POR 10 UNIDADES
2584686	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO 0.16 X 0.22 SUPERIOR	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.16 X 0.22 SUPERIOR- EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACISA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO: FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS- MODULO DE EL ASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE. USOS- EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS- PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION- PAQUETE POR 10 UNIDADES
2505228	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO- RECTANGULAR .016 X .16 INFERIOR	ARCO DE ALAMBRE ACERO RECTANGULAR 016 X 0.16 INFERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE. CARACTERISTICAS: MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD.
2505229	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO- RECTANGULAR .016x.16 SUPERIOR	ARCO DE ALAMBRE ACERO RECTANGULAR 016 X 0.16 SUPERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE. CARACTERISTICAS-MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD.

2505230	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO-RECTANGULAR .016 X .22 INFERIOR	ARCO DE ALAMBRE ACERO RECTANGULAR 016 X 0.22 INFERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS.
2505231	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO-RECTANGU .016 X .22 SUPERIOR	ARCO DE ALAMBRE ACERO RECTANGULAR 016 X 0.22 SUPERIOR. EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS.
2503422	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N°0.017 X0.025 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.017 X 0.025 INFERIOR- EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACISA DE CORTE TRANSVERSAL- COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO: FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS: MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS - BIOCOMPATIBLE. USOS- EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS- PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION- PAQUETE POR 10 UNIDADES.
2503429	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .016 X.022 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .016 X .022 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C- ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO

2503431	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .017 X .025 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .017 X .022 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C - ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO.
2503433	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .019 X .025 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .019 X .022 INFERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C - ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO
2503430	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .016 X .022 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .016 X .025 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C- ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO
2503432	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .017 X .025 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO-	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .017 X .025 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C- ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO.

							FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	
2503434	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .019 X .025 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO TERMICO N° .019 X .025 SUPERIOR- EN ALAMBRE RECTANGULAR COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL. PROPIEDADES DE SUPER-ELASTICIDAD Y MEMORIA DE FORMA- SE ACTIVA A T° DE 16°C- ALTA FLEXIBILIDAD Y RESILENCIA- AMPLIO RANGO DE TRABAJO.
2503423	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .014 INFERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .014 INFERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENT RESILIENTE- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE.
2503424	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .014 SUPERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .014 SUPERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENT RESILIENTE- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE.
2503425	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .016 INFERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMA ESTANDAR.	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .016 INFERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENT RESILIENTE- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE.

							PAQUETE POR 10 UNIDADES	
2503426	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .016 SUPERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMA ESTANDAR. PAQUETE POR 10 UNIDADES	ARCO DE NIQUEL-TITANIO N° .016 SUPERIOR- EN ALAMBRE REDONDO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENT RESILIENTE- MEMORIA DE FORMA- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS- BIOCOMPATIBLE.
2503362	42152718	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	ARCOS DE ACERO- TI Y ZR BAJO NI- PARA LIGADURA EN LAS PRIMERAS FASES EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. CALIBRE 0-015 - 0-021 X 0-025	ARCO DE ACERO INOXIDABLE N° 0.017 X 0.025 SUPERIOR- EN ALAMBRE CUADRADO COMPACTO- FORMADO POR UNA FIBRA MACIZA DE CORTE TRANSVERSAL COMPLETAMENTE CUADRADA. FORMA ESTANDAR. COMPOSICION DEL ACERO- FE 73.8-74.8%- CR 15-18%- NI 8-10% Y C 0.2%. CARACTERISTICAS: MODULO DE ELASTICIDAD GRANDE- RIGIDO- RESISTENTE A LA DEFORMACION- ALTA MALEABILIDAD- PRODUCE FUERZAS ALTAS QUE SE DISIPAN EN PERIODOS CORTOS - BIOCOMPATIBLE. USOS: EN LA RETRACCION INDIVIDUAL DE CANINOS MAXILARES Y MANDIBULARES- CUANDO YA HAY UNA ALINEACION Y NIVELACION COMPLETA DE LOS ARCOS- PARA CERRAR ESPACIOS DE LAS EXTRACCIONES CON CADENAS ELASTICAS SOBRE ESTE- ETC. PRESENTACION: PAQUETE POR 10 UNIDADES
2503361	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.004.001	BANDA DE CAUCHO TERMOPLASTICO ELASTOMERICO DE POLIURETANO- PLATA- ZINC Y ALUMINIO PARA TRATAMIENTO ORTODONCIA. FORMA CIRCULAR E INDIVIDUAL.	BANDA DE CAUCHO TERMOPLASTICO ELASTOMERICO DE POLIURETANO- PLATA- ZINC Y ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. FORMA CIRCULAR. LOS ALAMBRES A LAS RANURAS DE LOS BRACKETS. ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, AUNQUE PUEDE CAUSAR IRRITACION MECANICA A LA PIEL.

							COLORES SURTIDOS	
2503359	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	BANDA DE CAUCHO ELASTOMERICO DE POLIURETANO PARA TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. FORMADA POR OJALES CIRCULARES UNIDOS EN CADENA- COLORES SURTIDOS	BANDA DE CAUCHO ELASTOMERICO DE POLIURETANO (ETILENO-COPOLIMERO DE ACETATO DE VINILO) PARA EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. FORMADA POR EFICIENTE DE LIGADURA Y CIERRE DE ESPACIOS INTERDENTALES. ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, AUNQUE PUEDE CAUSAR IRRITACION MECANICA A LA PIEL
2584236	42152712	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR DERECHA LR PRIMER MOLAR N° 46 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE-INFERIOR DERECHA LR- ESPESOR VARIABLE-PRIMER MOLAR- N° 46 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD.
2584240	42152712	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR DERECHA LR SEGUNDO MOLAR N° 47 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE-INFERIOR DERECHA LR- ESPESOR VARIABLE-SEGUNDO MOLAR- N° 47 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD.
2584235	42152712	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR IZQUIERDA LL PRIMER MOLAR N° 36 + TUBO	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE-INFERIOR IZQUIERDA LL- ESPESOR VARIABLE-PRIMER MOLAR- N° 36 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD.

							PRESOLDADO. UNIDAD	
2584239	42152712	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR IZQUIERDA LL SEGUNDO MOLAR N° 37 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE- INFERIOR IZQUIERDA LL- ESPESOR VARIABLE- SEGUNDO MOLAR- N° 27 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD
2584694	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA CON TUBO NO. 36- 37 Y 38.	ELEMENTOS METALICOS EN FORMA DE ARO QUE VAN CEMENTADAS EN LOS MOLARES CON CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO- DE ACERO LAMINADO
2501187	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA INTERNA N° 1 A 33 LL KIT X 100 BANDAS	BANDAS PARA ORTODONCIA CON MARCACION DE LASER BAJO RELIEVE- SUPERFICIES INTERNAS RUGOSAS NUMERACION 1 A 33 LL
2501188	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA INTERNA N° 1 A 33 LR KIT X 100 BANDAS	BANDAS PARA ORTODONCIA CON MARCACION DE LASER BAJO RELIEVE- SUPERFICIES INTERNAS RUGOSAS NUMERACION 1 A 33 LR
2501251	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA INTERNA N° 1 A 33 UL KIT X 100 BANDAS	BANDAS PARA ORTODONCIA MARCACION LASER BAJO RELIEVE- SUPERFICIE INTERNA RUGOSA NUMERACION 1 A 33 UL
2501146	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA INTERNA N° 1 A 33 UR KIT X 100 BANDAS	BANDAS PARA ORTODONCIA CON MARCACION DE LASER BAJO RELIEVE- SUPERFICIES INTERNAS RIGUROSAS NUMERACION DE 1 A 33 UR
2584695	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ORTODONCIA SIN TUBO NO. 36-37 Y 38	ELEMENTOS METALICOS EN FORMA DE ARO QUE VAN CEMENTADAS EN LOS MOLARES CON CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO- DE ACERO LAMINADO N° 36 A 38
2584233	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR DERECHA UR PRIMER MOLAR	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE- SUPERIOR DERECHA UR- ESPESOR VARIABLE- PRIMER MOLAR- N° 16 (REFERENCIA: E1 420-00)- CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" (REFERENCIA: G8025-02) - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD

							N° 16 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	
2584237	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR DERECHA UR SEGUNDO MOLAR N° 17 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE- SUPERIOR DERECHA UR- ESPESOR VARIABLE- SEGUNDO MOLAR- N° 17 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD
2584234	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR IZQUIERDA UL PRIMER MOLAR N° 26 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE- SUPERIOR IZQUIERDA UL- ESPESOR VARIABLE- PRIMER MOLAR- N° 26 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD
2584238	42152715	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR IZQUIERDA UL SEGUNDO MOLAR N° 27 + TUBO PRESOLDADO. UNIDAD	BANDA ANATOMICA EN ACERO INOXIDABLE- SUPERIOR IZQUIERDA UL- ESPESOR VARIABLE- SEGUNDO MOLAR- N° 27 - CON TUBO PRESOLDADO .022" X .028 REDONDO .051" - SUPERFICIE INTERNA ASPERA. USO ORTODONTICO. AUTOCLAVABLE. UNIDAD
2503435	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BOTON LINGUAL DE CEMENTACION DIRECTA- EN ACERO INOXIDABLE- PLANO- CONCAVO O CONVEXO. BOLSA POR 10 UNIDADES	BOTON LINGUAL DE CEMENTACION DIRECTA- EN ACERO INOXIDABLE- PLANO- CONCAVO O CONVEXO. UTILIZADO EN MOVIMIENTOS DENTALES COMO GIROVERSIONES DIENTE. PRESENTACION: BOLSA POR 10 UNIDADES

2505232	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BOTON LINGUAL QUIRURGICO	BOTON LINGUAL QUIRURGICO. EL TAMAÑO REDUCIDO PERMITE CEMENTAR INCLUSO EN ZONAS DONDE EXISTE SOLO UNA SUPERFICIE DE CEMENTADO MINIMO INTRUIDOS PARCIALMENTE. SE PUEDE UTILIZAR LOS BOTONES PARCIALMENTE DEBAJO DE LA GINGIVA SIN SACRIFICAR LA COMODIDAD DEL PACIENTE.
2503437	42152706	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BRACKET METALICO ESTANDAR EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	BRACKET METALICO ESTANDAR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO- DE BORDES REDONDEADOS- CON ALAS PARA UN DOBLE LIGADO- PARA ELASTICAS
2584696	42152706	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	BRACKETS SLOT 22 MBT	QUE SE CEMENTA AL DIENTE PARA REALIZAR SOBRE ESTE FUERZAS ORTODONTICAS. CON UNA BASE PREPARADA PARA CEMENTAR ENCIMA DEL DIENTE Y UNA PARTE CON UNA RANURA- POR DONDE PASARA EL ARCO Y UNAS ALETAS QUE SERVIRAN PARA COLOCAR EL SISTEMA QUE LIGA EL ARCO METALICO. SE CEMENTAN AL DIENTE MEDIANTE RESINAS. CON BASE REDONDEADA O CUADRADA
2584697	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CADENETA CONTINUA	CADENETA CONTINUA-ELASTICO FABRICADO CON POLIMEROS DE USO MEDICOS-LIBRE DE LATEX-RESISTENTE, BUENA MEMORIA-BAJA DEFORMACION DURANTE SU USO-NO TOXICO-USO-EN EL TRATAMIENTO CON BRACKETS-USO-COMO SON CADENETAS ELASTICAS QUE SE UNEN ENTRE ELLAS A MODO DE CADENA PARA UNIR DIENTES-REALIZAR MOVIEMIENTOS DENTALES--CERRAR ESPACIOS INTERDENTALES-TRACCIONAR DIENTES-ENTRE OTRAS
2584595	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.005	CERA BLANCA PARA USO ORTODONTICO EN BARRA. PRESENTACION : CAJA POR 75 BARRAS	CERA BLANCA PARA USO ORTODONTICO EN BARRA- DE FORMA ACANALADA- CON ESTABILIDAD DIMENSIONAL- CONSISTENTE- SIN DISTORSION- FACIL DE SEPARAR- SUAVE. USO: PARA IMPRESIONES- BLOQUEO DE AREAS RETENTIVAS- PARA BRACKETS. DE COLOR BLANCO. PRESENTACION: CAJA POR 75 BARRAS
2503360	42151663	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	CUÑA DE ROTACION DE CAUCHO TERMOPLASTICO ELASTOMERICO DE POLIURETANO- AG- ZN Y AL.	CUÑA DE ROTACION DE CAUCHO TERMOPLASTICO ELASTOMERICO DE POLIURETANO- PLATA- ZINC Y ALUMINIO EN FORMA DE MODULO DE GOMA PARA USAR EN DE ROTACION Y REUBICACION DE PIEZAS DENTALES Y FIJACION A LAS ALETAS DE LOS BRACKETS. ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, AUNQUE PUEDE CAUSARI PIEL.

							FORMA MODULO DE GOMA PARA ORTOD. COLORES SURTIDOS	
2584698	42152435	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	ELASTICO 1/8 PESADO- USO EN ORTODONCIA	USO EN ORTODONCIA
2505233	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 1/4" FUERZA LIGERA ORTODONCIA	ELASTICOS 1/4" FUERZA LIGERA ORTODONCIA – FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO E ELASTICOS
2505234	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 1/4" FUERZA MEDIA ORTODONCIA	ELASTICOS 1/4" FUERZA MEDIA ORTODONCIA – FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS
2505235	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 1/4" FUERZA PESADA ORTODONCIA	ELASTICOS 1/4" FUERZA PESADA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS
2505236	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 1/8" FUERZA LIGERA ORTODONCIA	ELASTICOS 1/8" FUERZA LIGERA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS
2505237	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 1/8" FUERZA MEDIA ORTODONCIA	ELASTICOS 1/8" FUERZA MEDIA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO ELELASTICOS
2505238	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 3/16 FUERZA LIGERA ORTODONCIA	ELASTICOS 3/16 FUERZA LIGERA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS
2505239	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 3/16 FUERZA MEDIA ORTODONCIA	ELASTICOS 3/16 FUERZA MEDIA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO ELELASTICOS
2505240	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 3/16 FUERZA PESADA ORTODONCIA	ELASTICOS 3/16 FUERZA PESADA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS.
2505241	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 5/16 FUERZA LIGERA ORTODONCIA	ELASTICOS 5/16 FUERZA LIGERA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS

2505242	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 5/16 FUERZA MEDIA ORTODONCIA	ELASTICOS 5/16 FUERZA MEDIA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO ELELASTICOS
2505243	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	BOL	A.02.02.01.003.006	ELASTICOS 5/16 FUERZA PESADA ORTODONCIA	ELASTICOS 5/16 FUERZA PESADA ORTODONCIA– FABRICADO EN TUBO DE LATEX COLOR AMBAR – LA FUERZA INDICADA ES LA FUERZA EJERCIDA CUANDO EL ELASTICOS
2584758	42152709	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	LIGAS EN COLORES PARA BRACKETS PAQUETE	LIGAS EN COLORES PARA BRACKETS PAQUETE
2584243	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE- DE COLOR AZUL. MEDIDA: 4 - 4.5 mm. AUTOCLAVABLES-COLORAZUL	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 4 - 4.5 mm. AUTOCLAVABLES. USO- SLO T .018 Y .022.
2584242	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. DE COLOR ROJO. MEDIDA: 3 - 3.5 mm. AUTOCLAVABLES	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 3 - 3.5 mm. AUTOCLAVABLES. USO: SLO T .018 Y .022. COLOR ROJO
2584241	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. DE COLOR VERDE. MEDIDA: 2 -	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 2 - 2.25MM. AUTOCLAVABLES. USO: SL OT .018 Y .022. COLOR VERDE

							2.25MM. AUTOCLAVABLES	
2584244	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. DE COLOR VIOLETA. MEDIDA: 5 - 5.5MM. AUTOCLAVABLES	POSICIONADOR UNIVERSAL PARA BRACKETS: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 5 - 5.5MM. AUTOCLAVABLES. USO: SLO T .018 Y .022. COLOR VIOLETA
2502598	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.005	RESINA PARA ORTODONCIA DE UN PASO.KIT :4 JERINGAS DE 3.5 GR DE RESINA- 16GR ADHESIVO- 9GR ACIDO	RESINA PARA ORTODONCIA DE AUTOCURADO DE UN PASO.KIT :4 JERINGAS DE 3.5 GR DE RESINA- 16GR ADHESIVO- 9GR ACIDO
2503363	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	RESORTE ABIERTO DE ACERO- CROMO- MOLIBDENO- SILICIO Y MAGNECIO BAJO EN NIQUEL- PARA USAR PRIMERAS FASES EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. CALIBRE 0-015 - 0-021X 0-025	RESORTE ABIERTO DE ACERO PUEDE CONTENER CROMO- MOLIBDENO- SILICIO Y MAGNESIO CON BAJO CONTENIDO DE NIQUEL PARA USAR EN LAS PRIMERAS FASES DEL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. FLEXIBLES- ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE, AUNQUE PUEDE CAUSAR IRRITACION MECANICA A LA PIEL. RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION.
2502098	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	RESORTE ABIERTO NITINOL ROLLO	RESORTE ABIERTO PARA DISTALIZAR FUERZA MEDIA- UTILIZADO EN ORTODONCIA. PRESENTACION EN ROLLO

2503364	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	RO	A.02.02.01.004.001	RESORTE CERRADO DE ACERO-CROMO-MOLIBDENO-SILICIO Y MAGNECIO BAJO EN NIQUEL- PARA USAR PRIMERAS FASES EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. CALIBRE 0-015 - 0-021X 0-025	RESORTE CERRADO DE ACERO: PUEDE CONTENER CROMO- MOLIBDENO- SILICIO Y MAGNESIO CON BAJO CONTENIDO DE NIQUEL. PARA USAR EN LAS PRIMERAS FASES DEL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y FLEXIBLES. ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE- AUNQUE PUEDE CAUSAR IRRITACION MECANICA A LA PIEL. RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION.
2502099	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.003.006	RETRACTOR DE LABIOS Y LENGUA UNIDAD	ELEMENTO PLASTICO DE BORDES ATRAUMATRICOS PARA USO ODONTOLOGICO- PARA FACILITAR LA VISIBILIDAD EN CAVIDAD ORAL Y AREA DE TRABAJO.
2505260	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR IZQUIERDO MOLAR No 36 RANUARA .018 TORQUE -25° ANGULACION +5° UNIDAD	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE- BORDE REDONDEADO- PERFIL BAJO- FUERZA INCREMENTADA- MAS UNA REJILLA EN LA BASE- CONTORNEADA ANATOMICAMENTE- INFERIOR IZQUIERDO- MOLAR No36. RANUARA .018- TORQUE -25°- ANGULACION +5° DE USO ORTODONTICO. UNIDAD.
2505261	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE INFERIOR IZQUIERDO MOLAR No 36 RANUARA .018 TORQUE -25° ANGULACION +5° UNIDAD	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE- BORDE REDONDEADO- PERFIL BAJO- FUERZA INCREMENTADA- MAS UNA REJILLA EN LA BASE- CONTORNEADA ANATOMICAMENTE- INFERIORDERECHO- MOLAR No46. RANUARA .018- TORQUE -25°- ANGULACION +5° DE USO ORTODONTICO. UNIDAD.

2505258	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR DERECHO MOLAR No 16 RANUARA .018 TORQUE -10° ANGULACION +8° UNIDAD	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE- BORDE REDONDEADO- PERFIL BAJO- FUERZA INCREMENTADA- MAS UNA REJILLA EN LA BASE.
2505259	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE SUPERIOR IZQUIERDO MOLAR No 26 RANUARA .018 TORQUE -10° ANGULACION +8° UNIDAD	TUBO BUCAL DE CEMENTACION DIRECTA EN ACERO INOXIDABLE- BORDE REDONDEADO- PERFIL BAJO- FUERZA INCREMENTADA- MAS UNA REJILLA EN LA BASE UNIDAD.
2505257	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- INFERIOR DERECHO. RANURA 0.22"- ROTACION 0°. USO ORTODONTICO	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- INFERIOR DERECHO. RANURA 0.22"- ROTACION 0°. DE USO ORTODONTICO. UNIDAD
2505256	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- INFERIOR IZQUIERDO. RANURA 0.22"- ROTACION 0°. USO ORTODONTICO	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- INFERIOR IZQUIERDO. RANURA 0.22"- ROTACION 0°. DE USO ORTODONTICO. UNIDAD

2505254	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- SUPERIOR DERECHO. RANURA 18"- ROTACION 0°. USO ORTODONTICO	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- SUPERIOR DERECHO. RANURA 18"- ROTACION 0°- DE USO ORTODONTICO. UNIDAD
2505255	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- SUPERIOR IZQUIERDO. RANURA 18"- ROTACION 0°. USO ORTODONTICO	TUBO BUCAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR BANDAS- SUPERIOR IZQUIERDO. RANURA 18"- ROTACION 0°. DE USO ORTODONTICO. UNIDAD.
2503436	42152700	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-7	C/U	A.02.02.01.004.001	TUBO PARA CEMENTACION DIRECTA ESTANDAR FABRICADO EN METAL BIOCOMPATIBLE- EXCENTO DE NIQUEL- DE UNA SOLA PIEZA	TUBO PARA CEMENTACION DIRECTA ESTANDAR- FABRICADO EN METAL BIOCOMPATIBLE- EXCENTO DE NIQUEL- DE UNA SOLA PIEZA- FORMA ANATOMICA QUE 0.22"

PERIODONCIA

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2584699	60103923	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.008	BLOQUE DE HUESO 100% HUMANO- ALOINJERTO MINERALIZADO	ALOINJERTO MINERALIZADO-CAPA CORTICAL Y CAPA CANCELAR-POTENCIAL OSEOCONDUCTIVO- USO EN CIRUGIA ORAL Y PERIODONTAL-PARA REGENERACION OSEA EN DEFECTOS-COLAPSO DE REBORDE ALVEOLAR-ESTERIL-NO REQUIERE CONGELACION

2502925	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.003.005	CEMENTO QUIRURGICO KIT X 180 gr/BASE 90 gr - CATALIZADOR 90 gr	BASE Y CATALIZADOR-PASTA PROTECCION POSTQUIRURGICO-FACIL DE MOLDEAR-ESTABLE-SUAVE-COHESIVO-DE UNA DUREZA ELASTICA-SIN EUGENOL NI ASBESTO. BASE 90 gr-CATALIZADOR 90 gr
2505748	51102707	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.003.005	CLORHEXIDINA GLU 0.12% ENJUAGUE BUCAL 2 L-ANTIBACTERIANO COMPROBADAMENTE SEGURO Y EFECTIVO EN EL TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS Y PREVENCION DE DOLENCIAS PERIODONTALES	CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% ENJUAGUE BUCAL 2 L-ENJUAGUE ANTIBACTERIANO-CON ACCION A BACTERIAS GRAM + Y GRAM - INCLUSO HONGOS Y LEVADURAS- COMPROBADAMENTE SEGURO-CON ACTIVIDAD ANTIPLACA, ANTIGINGIBIVITIS-EFECTIVO EN EL TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS Y PREVENCION DE DOLENCIAS PERIODONTALES
2501941	51102707	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	FCO	A.02.02.01.003.005	ENJUAGUE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2%-FRASCO DE 150/200 ml	CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.2% ENJUAGUE BUCAL150/200 ml-ENJUAGUE ANTIBACTERIANO-CON ACCION A BACTERIAS GRAM + Y GRAM - INCLUSO HONGOS Y LEVADURAS-COMPROBADAMENTE SEGURO-CON ACTIVIDAD ANTIPLACA, ANTIGINGIBIVITIS-EFECTIVO EN EL TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS Y PREVENCION DE DOLENCIAS PERIODONTALES. CON VALVULA DOSIFICADORA
2503946	42151614	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	FRESAS DIAMANTADAS PARA PERIODONCIA-ODONTOPLASTIA Y PULIDO RADICULAR MECANICOS. KIT	PERIOSET-INSTRUMENTOS DIAMANTADOS PARA ODONTOPLASTIA Y PULIDO RADICULAR
2503108	42152702	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	FCO	A.02.02.01.003.005	GEL HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 25% PARA EL	SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. JERINGA PRELLENADA DE 30ml ES UN GEL TIXOTROPICO A BASE DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25%-QUE AYUDA AL

							CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS-JPR 30ml	CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. PRESENTACION JERINGA DE 30ml
2503442	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	IMPLANTE DENTAL PLATAFORMA AMPLIA DIAMETRO 5mm-L6-16mm	IMPLANTE DENTAL-PLATAFORMA AMPLIA-DIAMETRO 5MM-LONGITUD 6-16MM. COMPUESTO DE ALEACION DE TITANIO GRADO MEDICO
2503443	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	IMPLANTE DENTAL PLATAFORMA AMPLIA DIAMETRO Ø 5MM-L6-16mm	IMPLANTE DENTAL-PLATAFORMA AMPLIA-DIAMETRO 5 mm-LONGITUD 6-16 mm. COMPUESTO DE ALEACION DE TITANIO GRADO MEDICO
2503440	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	IMPLANTE DENTAL PLATAFORMA ESTANDAR DIAMETRO 3.75 mm-L8-16 mm	IMPLANTE DENTAL-PLATAFORMA ESTANDAR-DIAMETRO 3.75 mm-LONGITUD 18-16 mm. COMPUESTO DE ALEACION DE TITANIO GRADO MEDICO
2503441	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	IMPLANTE DENTAL PLATAFORMA ESTANDAR DIAMETRO Ø4.2MM-L6-16MM	IMPLANTE DENTAL-PLATAFORMA ESTANDAR-DIAMETRO 4.2 mm-LONGITUD 6-16 mm. COMPUESTO DE ALEACION DE TITANIO GRADO MEDICO
2503439	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	IMPLANTE DENTAL PLATAFORMA EXTRECHA DIAMETRO Ø3.30MM-L10-16MM	IMPLANTE DENTAL-PLATAFORMA ESTRECHA-DIAMETRO 3.30 mm-LONGITUD 10-16 mm. COMPUESTO DE ALEACION DE TITANIO GRADO MEDICO
2505583	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS/PUNTA PARA ULTRASONID TIPO ED10	INSERTOS/CODIGO PARA ULTRASONID TIPO ED10 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2505584	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS/PUNTA PARA ULTRASONID TIPO ED11	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONID TIPO ED11 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2505283	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA PARA PIEZA ULTRASONICA-SISTEMA	CODIGO PARA PIEZA ULTRASONICA-SISTEMA SCALER PARA LIMPIEZA GENERAL

							SCALER PARA LIMPIEZA GENERAL. REFERENCIA USS1S	
2505284	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS/PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO 4S	CODIGO PARA PIEZA ULTRASONICA-SISTEMA SCALER PARA LIMPIEZA GENERAL
2505582	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS/PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO ED9	INSERTOS/CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO ED9 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2505585	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS/PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO GD1	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO GD1 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2504689	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO DIAMANTADO/PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H1: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B CON IRRIGACION	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H1. INSERTO DIAMANTADO-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H1: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. INDICACIONES DE USO-EN PERIODONCIA PARA DEBRIDAMIENTO PERIODONTAL Y PULIDO RADICULAR. DISPOSITIVO MEDICO ES DE CLASE IIA SEGUN LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. EQUIPO GAMA P5
2504690	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO DIAMANTADO-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H2L-FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B CON IRRIGACION	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H2L. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. INSERTO DIAMANTADO PARA EL PULIDO DEL SECTOR PREMOLAR Y MOLAR-ORIENTADO A LA IZQUIERDA-COMPLEMENTO DEL INSERTO H2R-PARA EL TRATAMIENTO DE FURCACIONES-ESPACIOS ESTRECHOS Y ABSCESOS

2504691	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO DIAMANTADO-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H2R FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B CON IRRIGACION	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H2R. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. INSERTO DIAMANTADO PARA EL PULIDO DEL SECTOR PREMOLAR Y MOLAR-ORIENTADO A LA DERECHA-COMPLEMENTO DEL INSERTO H2L-PARAEL TRATAMIENTO DE FURCACIONES-ESPACIOS ESTRECHOS Y ABSCESOS
2504692	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO DIAMANTADO-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H2R FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B CON IRRIGACION	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H3. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. PERIODONCIA INICIAL-SECTOR ANTERIOR-PARA TRATAR LOS BLOQUES INCISIVOS-CANINOS
2504693	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO LISO-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H4L-FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B CON IRRIGACION	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H4L. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. INSERTO DIAMANTADO PARA EL PULIDO DE LOS DIENTES ANTERIORES EN CASOS SIMPLES-EN LA ZONA CERVICAL-Y PARA LA RETIRADA DE LOS TEJIDOS DE GRANULACION
2504694	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTO LISO-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO H4R-FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO SEGUN NORMA ASTM F899-12B	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO H4R. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO (NIQUEL-CROMO) SEGUN NORMA ASTM F899 - 12b. CON IRRIGACION. PERIODONCIA DEL SECTOR PREMOLAR Y MOLAR-ORIENTADO A LA IZQUIERDA-COMPLEMENTO DEL INSERTO H4R-PARA EL TRATAMIENTO DE TODAS LAS CARAS Y FURCACIONES

							CON IRRIGACION	
2505586	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO PD1	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO PD1 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2505587	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	INSERTOS-PUNTA PARA ULTRASONIDO TIPO PD3	INSERTOS-CODIGO PARA ULTRASONIDO TIPO PD3 CODIGO PARA SCALER ULTRASONICO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE-COMPATIBLE CON EQUIPO DTE/ FROGENT/NSK
2584700	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	KIT DE IMPLANTES/EN TITANIO	KIT DE IMPLANTE QUE CONTENGA-1. IMPLANTE DE TITANIO. 2. TAPA CICRATIZANTE. 3. PILAR ABUTMET TITANIO. 4. COPING DE IMPRESION. FORMAS CILINDRICA Y CONICA-DIFERENTES DIAMETROS-DIFERENTES LONGITUDES. QUE SE ADAPTEN AL SISTEMA QUE POSEA LA INSTITUCION
2503142	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA DISTAL SDCM/D7 DE PRESICION	LIMA DISTAL SDCM/D7-INSTRUMENTO DE PRECISION CON INALTERABILIDAD DE LA FORMA-ESTERILIZABLE-ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE-DECOLORACION Y CORROSION-CODIGO DE TRABAJO EN ACERO INMUNIZADO INMUNITY STEEL-ALTO CONTENIDO DE CROMO Y CARBONO-CODIGO ACTIVA DELGADA PARA TRABAJO DE LA PARTE DISTAL DE LOS DIENTES-INCORPORAN UN RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE TOTAL DE 360°. SU TAMAÑO Y FORMA RESULTA IDEAL PARA MEJORAR EL RASPADO EN FURCAS Y DEPRESIONES RADICULARES
2503087	42151620	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	LIMA MESIAL-DISTAL CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE TOTAL 360°	LIMA CON RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE TOTAL DE 360°. SU TAMAÑO Y FORMA. FACILITA EL RASPADO EN FURCAS Y DEPRESIONES RADICULARES. USO- PARA ANGULOS Y SURCOS DEL ESMALTE-EN SUPERFICIES MESIALES Y DISTALES
2502152	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.003.006	MEMBRANA DE COLAGENO-PARA PROCEDIMIENTOS DE REGENARACION TISULAR TAMAÑO A NECESIDAD DEL PACIENTE	LA MEMBRANA DE COLAGENO INDICADA POR USAR EN PROCEDIMIENTOS DE REGENERACION TISULAR GUIADA-REGENERACION OSEA GUIADA Y CIRUGIAS PERIODONTALES CON EL FIN DE MEJORAR LA CICATRIZACION DEL COMPLEJO PERIODONTAL-REABSORBIBLE

2584718	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.003.005	PIEDRA DE ARKANZAS	PIEDRA RECTANGULAR PARA EL AFILADO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE CORTE. LAS PIEDRAS DE ARKANSAS BLANCA Y GRIS CLARO SON ROCAS DE ARENISCAS RICAS EN ALUMINA-LAS HAY DE DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS-SE RECOMIENDA DE INGUAL GRANO DEL GRUESO AL FINO PARA REALIAR EL AFILADO CORRECTO
2503454	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION ANATOMICO SP DIAMETRO 5.5mm-ALTURA 3-6mm	PILAR DE CICATRIZACION ANATOMICO SP DIAMETRO 5.5mm-ALTURA 3-6mm.
2503452	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION ANATOMICO DIAMETRO 4.3mm-ALTURA 2-8mm	PILAR DE CICATRIZACION ANATOMICO DIAMETRO 4.3mm-ALTURA 2-8mm.
2503453	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION SP DIAMETRO 4mm-ALTURA 3-6mm	PILAR DE CICATRIZACION SP DIAMETRO 4mm-ALTURA 3-6mm
2503456	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION WP DIAMETRO 6.5mm-ALTURA 3-5mm	PILAR DE CICATRIZACION WP DIAMETRO 6.5mm-ALTURA 3-5mm.
2503455	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION WP DIAMETRO 5mm-ALTURA 3-5mm	PILAR DE CICATRIZACION WP DIAMETRO 5mm-ALTURA 3-5mm
2503451	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR DE CICATRIZACION DIAMETRO 4mm-ALTURA 2-8mm	PILAR DE CICATRIZACION DIAMETRO 4mm-ALTURA 2-8mm
2503457	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PILAR-ABUTMENT TEMPORAL PLASTICO DIAMETRO 4-5.5 mm ALTURA 11mm	PILAR-ABUTMENT TEMPORAL PLASTICO (PILAR PROVISIONAL PEEK) DIAMETRO 4-5.5mm ALTURA 11mm-PARA TODAS LAS PLATAFORMAS
2504363	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO	CODIGO CAVITRON TIPO DE INSERTO N° 1

							DE INSERTO N° 1	
2504365	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO DE INSERTO N° 10P	CODIGO CAVITRON TIPO DE INSERTO N° 10P
2504364	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO DE INSERTO N° 2	CODIGO CAVITRON TIPO DE INSERTO N° 2
2504367	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO DE INSERTO N° G4	CODIGO CAVITRON TIPO DE INSERTO N° G4
2504368	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO DE INSERTO N° G5	CODIGO CAVITRON TIPO DE INSERTO N° G5
2502081	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA CAVITRON TIPO INSERTO DE 25 KHZ UNIDAD	CODIGO METALICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACION: MANGO PLASTICO-ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO A CAVITRON-FSI-100. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACION INTERNA-COMPATIBLE CON EL SISTEMA QUE SE ESTE USANDO
2503247	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	C/U	A.02.02.01.004.001	PUNTA ELECTROBISTURI PARA CORTE EN ODONTOLOGIA	ELECTRODO PLASTICO CON CODIGO ACTIVA DE CORTE-PARA EQUIPO COMPATIBLE CON LA INSITUCION-QUE PERMITA CORTAR-COAGULAR Y CAUTERIZAR TEJIDOS A LA VEZ. DESECHABLE O RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION SEGUN SE REQUIERA.
2504436	42152400	ZMQX	ZMQX-003	ZMQX-003-8	SOB	A-02-02-01- 003-005	TRIOXIDO MINERAL AGREGADO-MTA KIT POLVO 1 gr- LIQUIDO 3 ml	TRIOXIDO MINERAL AGREGADO-MTA COMPOSICION-SILICATO TRICALCICO-SILICATO DICALCICO-ALUMINATO FERRICO TETRACALCICO-SULFATO DE CALCIO DIHIDRATO-OXIDO TRICALCICO Y OXIDO DE SILICATO. MATERIAL DE OBTURACION RETROGRADA-DE USO ENDODONTICO-COMPUESTO DE ALUMINIO-BIOCOMPATIBLE. CARACTERISTICAS: LIBERACIONES DE CALCIO-INDUCTOR DE NEOFORMACION DE CEMENTO PERIRADICULAR-HIDROFILICO-BAJASO LUBILIDAD-ALTA RADIOPACIDAD.

MATERIAL DE CIRUGÍA
INSUMOS PARA ESTERILIZACION

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2505753	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 57 mm X 130 mm	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 57X130mm-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2500198	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR O GAS. MEDIDAS: 3 1/2" X 9" (9 X23),	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR O GAS, MEDIDAS-9 cm X 23 cm (90mm X 230 mm)-COMPUESTO POR 2 LAMINAS UNA DE PAPEL PERMEABLE Y LA OTRA UNA PELICULA DE PLASTICO TRANSPARENTE SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION-CUENTA CON DOS INDICADORES QUIMICOS QUE VERIFICAN PRESION Y TEMPERATURA PARA UN CORRECTO PROCESO DE ESTERILIZACION
2505568	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PLANA DE ESTERILIZACION 300X350mm	BOLSAS DE ESTERILIZACION-MEDIDAS 300mm X 350 mm-EN PAPEL GRADO MEDICO Y PELICULA DE PLASTICO DE POLIESTER Y POLIPROPILENO (PET/PP).DE FACIL APERTURA-ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE Y A LA HUMEDAD-ALTO NIVEL DE PROTECCION CONTRA BACTERIAS-INCLUYE INDICADORES QUIMICOS PARA VAPOR-OXIDO DE ETILENO Y FORMALDEHIDO-DISEÑADA PARA SER TERMOSELLADA
2503126	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 3.5 cm x 28 cm (30.5 mm X 280 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 3.5 cm x 28 cm (30.5 mm-280 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE

								ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2503102	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 9.0 cm x 22-28 cm (90 mm X 220-230 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 9.0 cm x 22-23 cm (90 mm x220-230 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2504524	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 6.0 cm x 10 cm (60 mm X 100 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 6.0 cm x 10 cm (60 mm x100 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2587185	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 9.0 cm x 26 cm (90 mm X 260 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 9.0 cm x 26 cm (90 mm x 260 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO

2503069	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 13cm x 25 cm (130 mm X 250 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 13 cm x 25 cm (130 mm x 250 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2503125	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 19 cm x 33 cm (190 mm X 330 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 19 cm x 33 cm (190 mm x 330 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2503127	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLABLE CON ADHESIVO 25 cm x 37 cm (250 mm X 370 mm)	LAS BOLSAS PARA ESTERILIZAR DE 25 cm 37 cm-(250 mm x 370 mm)-DISPOSITIVO MEDICO ELABORADO CON PAPEL GRADO MEDICO (POLIPROPILENO)-LISO-DE POROSIDAD CONTROLADA-CON CIERRE HERMETICO AUTOSELLANTE-SISTEMA DE BANDA SIN FUELLE-UTILIZADA PARA ACTUAR COMO BARRERA BACTERIANA MANTENIENDO EL INSTRUMENTAL ESTERIL EN SU INTERIOR POSTERIORMENTE AL PROCESO DE ESTERILIZACION-LIBRE DE PLOMO Y LATEX- CON DOS INDICADORES DE ESTERILIZACION-VAPOR Y GAS DE OXIDO DE ETILENO
2500005	42281904	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PLASTICO GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR O GAS-GRANDE MEDIDAS 5 1/4"	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR O GAS-MEDIDAS 13 cm x 25 cm (130 mm X 250 mm)-COMPUESTO POR 2 LAMINAS UNA DE PAPEL PERMEABLE Y LA OTRA UNA PELICULA DE PLASTICO TRANSPARENTE SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION-CUENTA CON DOS INDICADORES QUIMICOS QUE VERIFICAN PRESION Y

							X 10" (13 cm X25 cm), SIN FUELLE	TEMPERATURA PARA UN CORRECTO PROCESO DE ESTERILIZACION
2503764	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	PLG	A.02.02.01.003.006	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO, 100% CELULOSA DE COLOR VERDE-TAMAÑO DE 60 cm X 100 m	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO DE SEGUNDA GENERACION 100% CELULOSA REFORZADA-MEDIDAS 60 cm X 100 m-ELASTICO-PERMEABILIDAD CONTROLADA-LIBRE DE FIBRA SUELTA-PARA ESTERILIZACION A VAPOR
2503817	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO- 100% CELULOSA DE COLOR VERDE-TAMAÑO DE 54 cm X 100 m	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO DE SEGUNDA GENERACION 100% CELULOSA REFORZADA-MEDIDAS 54 cm X 100 m-ELASTICO-PERMEABILIDAD CONTROLADA-LIBRE DE FIBRA SUELTA-PARA ESTERILIZACION A VAPOR
2583913	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO-100% CELULOSA DE COLOR VERDE-TAMAÑO DE 54 cm X 200 m	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO DE SEGUNDA GENERACION 100% CELULOSA REFORZADA-MEDIDAS 54 cm X 200 m-ELASTICO-PERMEABILIDAD CONTROLADA-LIBRE DE FIBRA SUELTA-PARA ESTERILIZACION A VAPOR-OXIDO DE ETILENO-FORMALDEHIDO-PRESENTACION EN ROLLO
2504884	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA-MEDIDAS 70 cm X 100 m	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO DE SEGUNDA GENERACION 100% CELULOSA REFORZADA-MEDIDAS 70 cm X 100 m-ELASTICO-PERMEABILIDAD CONTROLADA-LIBRE DE FIBRA SUELTA-PARA ESTERILIZACION A VAPOR
2500495	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA-MEDIDAS 70 cm X 100 m	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO-MEDIDAS 70 cm (700 mm) X 100 m. PELICULA DE MATERIAL NO TEJIDO DE POLIETILENO POLIESTER - CON BARRERA BIOLOGICA EFECTIVA-CON INDICADORES QUIMICOS QUE VIRAN DE COLOR DE ACUERDO CON EL PROCESO DE ESTERILIZACION
2500497	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA MEDIDAS 70X200 m	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO-MEDIDAS 70 cm (700 mm) X 100 m. PELICULA DE MATERIAL NO TEJIDO DE POLIETILENO POLIESTER - CON BARRERA BIOLOGICA EFECTIVA-CON INDICADORES QUIMICOS QUE VIRAN DE COLOR DE ACUERDO CON EL PROCESO DE ESTERILIZACION

2500498	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA-MEDIDAS 70 cm X 250 m	PAPEL PARA ESTERILIZAR A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO-MEDIDAS 70 cm (700 mm) X 100 m. PELICULA DE MATERIAL NO TEJIDO DE POLIETILENO POLIESTER - CON BARRERA BIOLOGICA EFECTIVA-CON INDICADORES QUIMICOS QUE VIRAN DE COLOR DE ACUERDO CON EL PROCESO DE ESTERILIZACION
2503898	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	PAPEL KRAFT FABRICADO A PARTIR DE CELULOSA (GRADO MEDICO), COMPATIBLE CON PROCESOS DE ESTERILIZACIO N	FABRICADO A PARTIR DE CELULOSA (GRADO MEDICO), COMPATIBLE CON ESTERILIZACION A VAPOR. POROSIDAD CONTROLADA DE 0.1 A 0.3 MICRAS-QUE NO POSEA BLANQUEADORES-EVITE O REDUCE LAS ROTURAS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION
2501236	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACIO N PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILEN O, CON FUELLE DE 15 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACIO N A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2505780	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACIO N PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILEN O, CON FUELLE DE 20 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACIO N A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2501237	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 25 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501238	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 30 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501239	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 35 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2584377	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 40 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501235	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 10 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2583790	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 32 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2583791	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 50 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501242	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 10 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501243	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 12 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2501244	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 15 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501245	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 20 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501246	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 25 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2501247	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 30 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2503103	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL PLAST ESTER S/ FUELLE 40 cmX200mS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501240	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 5 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5

2501241	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, SIN FUELLE DE 7.5 cm X200 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2501234	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	EMPAQUE ESTERILIZACION PAPEL GRADO MEDICO /POLIPROPILENO, CON FUELLE DE 7.5 cm X 100 mS PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y/O GAS DE OXIDO DE ETILENO. COMPUESTO POR 2 LAMINAS SELLADAS POR CALOR Y ADHESIVO RESISTENTE A PROCESOS DE ESTERILIZACION; CON UNA LAMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO MULTIPLE CO-EXTRUIDO 40 MICRONES (PERMEABLE) Y/O POLIESTER 12 A 40 MICRONES, GRAMAJEDE 53 G/m2 +/- 10%, RESISTENCIA AL CALOR Y OTRA CON CARA EN PAPEL GRADO MEDICO (GRAMAJE DE 70 G/M" +/- 5%-CON INDICADORES QUIMICOS. RESISTENCIA BIOLOGICA, QUIMICA Y MECANICA. CIERRE Y DESPEGUE FACIL. NORMAS ISO: 13485:2003/9001:2000. CE EN868-5
2504400	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	PLG	A.02.02.01.003.006	PLIEGO DE TELA NO TEJIDA 150cm X 150cm. PARA ENVOLVER INSTRUMENTAL, EQUIPO, OTROS PARA ESTERILIZAR	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2504399	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	PLG	A.02.02.01.003.006	PLIEGO DE TELA NO TEJIDA EN POLIPROPILENO DE 92cm X 100cm. PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATUA	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS

								SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2504539	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 30cmX100M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2503637	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 30cmX200M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2504329	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 30mm X 70M. PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2504328	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 40mm X 70M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO

2500496	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 70mm X 150M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2500499	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 70cmX350M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2500494	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	C/U	A.02.02.01.003.006	PAPEL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 70cmX75M PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. PRESENTACION EN ROLLO	PLIEGOS DE TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE POLIPROPILENO 100% SmmS-GRAMAJE 60 gr/m2 (+ - 5) ELONGACION 125% (+ - 5%)-EFECTIVA BARRERA BACTERIANA-DE POROSIDAD CONTROLADA-REPELENTE AL AGUA-DE ALTO RELIEVE AL TACTO-RESISTENTE AL RASGADO POR TRACCION-ALTA RESISTENCIA EN SECO Y HUMEDO A LA TENSION Y MANIPULACION PARA ENVOLVER EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOMETIDOS A ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA-PRESENTACION EN ROLLO
2505447	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 10 cm X 70 m PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 10 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.

2505314	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 10 cm X 100 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 10 cm X 100 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505448	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 15 cm X 70 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 15 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505313	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 15 cm X 100 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 15 cm X 100 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505449	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 20 cm X 70 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 20 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.

2505315	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 20 cm X 100 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 20 cm X 100 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505450	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 25 cm X 70 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 25 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505316	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 25 cm X100 M PARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 25 cm X 100 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.
2505569	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 30 cm X 70 M ARA ESTERILIZACION	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 30 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.

2505451	42281915	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-1	RO	A.02.02.01.003.006	ROLLO PLASTICO PLANO 38 cm X 70 M ARA ESTERILIZACIO N	ROLLO PLANO ELABORADO CON FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MAS UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER Y POLIETILENO GRADO MEDICO-DE 38 cm X 70 m SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MEDICOS REPROCESADOS QUE REQUIEREN SER UTILIZADOS ESTERILES-CON INDICADORES QUIMICOS IMPRESOS QUE VIRAN DE COLOR DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO.

COTONOIDES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2583911	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	C/U	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, 1.27X1.27 CM 4 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500313	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 10x2 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500314	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 10x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500315	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 10x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

2500316	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 10x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500317	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 10x6 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500081	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 1X2 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500082	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 1x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500083	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 1x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500270	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 1x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500271	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

							2x2 CM 5 UNIDADES	
2500272	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 2x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500273	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 2x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500274	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 2x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500318	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x2 CM 10 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500275	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x2 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500319	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x3 CM 10 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500276	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA,	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE.

							MAS REPARO 3x3 CM 5 UNIDADES	ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500320	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x4 CM 10 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500277	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500321	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x5 CM 10 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500278	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 3x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500279	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 4x2 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500280	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 4x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

2500281	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 4x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500282	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 4x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500283	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x2 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500284	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500285	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500286	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500287	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

							5x6 CM 5 UNIDADES	
2500288	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x7 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500290	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x8 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500301	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 5x9 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500302	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 7x3 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500303	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 7x4 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500304	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 7x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500305	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA,	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE.

							MAS REPARO 7x6 CM 5 UNIDADES	ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500306	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 7x7 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500307	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 7x8 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500308	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 8x5 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500309	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 8x6 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500310	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 8x7 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE
2500311	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 8x8 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

2500312	42141500	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-2	SOB	A.02.02.01.000.001.09	COTONOIDE EN ALGODON CON CINTA RADIOPACA, MAS REPARO 8x9 CM 5 UNIDADES	COTONOIDE ELABORADO EN ALGODON LAMINADO. CON LINEA RADIOPACA. CON HILO SEDA DE REPARO. QUE NO SE DESHILACHE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL-PRESENTACION EN SOBRE

HEMOSTATICOS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500535	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDASA REGENERADA 10-11 cm X 10-11 cm	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA.TIPO ALGODON EN CAPAS.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.DE FACIL MANIPULACION.DE RAPIDA ABSORCION.
2500533	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDASA REGENERADA 14-17 cm X 20-21 cm	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA.REGENERADA ALTA DENSIDAD.EMPAQUEINDIVIDUAL ESTERIL.DE FACIL MANIPULACION.DE RAPIDA ABSORCION
2500534	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDASA REGENERADA 5-6 cm X 10-11 cm	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA.TIPO ALGODON EN CAPAS.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.DE FACIL MANIPULACION.DE RAPIDA ABSORCION
2500531	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDASA REGENERADA 5-6 cm X 7-8 cm	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ALTA DENSIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.DE FACIL MANIPULACION.DE RAPIDA ABSORCION
2500536	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA ALTA DENSIDAD. TAMAÑO: 7-7.5 cm X 10-15 cm	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA ALTA DENSIDAD. TAMAÑO: 7-7.5x10- 15cm. ELABORADA MEDIANTE LA OXIDACION DE CELULOSA DE ALGODO-FACIL MANIPULACION
2500539	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ESPONJA GELATINA 70-80 mm X 50-60 mm	HEMOSTATICOS, DE ESPONJA DE GELATINA, TAMAÑO 70-80 mm X50-60 mm X1-5 mm ELABORADO EN GELATINA ABSORBIBLE.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

2500538	42311601	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-3	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOSTATICO ESPONJA GELATINA GRADO FARMACEUTICO (HIDROLIZADO DE COLAGENO) 7-8 cm X 5-6 cm X 1-2 cm	ESPONJA HEMOSTATICA QUIRURGICA ELABORADA A PARTIR DE GELATINA GRADO FARMACEUTICO (HIDROLIZADO DE COLAGENO), BIOCOMPATIBLE, NO TOXICO
ADMINISTRAR OXIGENO EN CIRUGÍA								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2584053	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA EM SILICONA, CAPACIDAD 0.5 LITROS	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA, ELABORADO EN SILICONA, CAPACIDAD 0.5 LITROS, CONECTOR REFORZADO DE 22 mm, LBRE DE LATEX, AUTOCLAVABLE
2584054	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA EM SILICONA, CAPACIDAD 1 LITRO	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA, ELABORADO EN SILICONA, CAPACIDAD 1 LITRO, CONECTOR REFORZADO DE 22 mm, LBRE DE LATEX, AUTOCLAVABLE
2584055	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA EM SILICONA, CAPACIDAD 2 LITROS	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA, ELABORADO EN SILICONA, CAPACIDAD 2 LITRO, CONECTOR REFORZADO DE 22 mm, LBRE DE LATEX, AUTOCLAVABLE
2584056	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA EM SILICONA, CAPACIDAD 3 LITROS	BALON REUSABLE PARA ANESTESIA, ELABORADO EN SILICONA, CAPACIDAD 3 LITRO, CONECTOR REFORZADO DE 22 mm, LBRE DE LATEX, AUTOCLAVABLE
2501042	2503707	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BLOQUEADORES PULMONARES ADULTO 6 FR, ESTERIL,	BLOQUEADORES PULMONARES ADULTO 6 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.LONGITUDDEL BLONQUEADOR 60-70CMS.ADAPTADOR MULTICUERPO DE 4 VIAS.PUER

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504011	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 3.5 mm/12Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 3.5-MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE-CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2583763	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 3.0 mm/8Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 3.0 mm/8Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2583764	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 4.0 mm/14Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 4.0 mm/14Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584070	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 5.0 mm/20Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL-	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 5.0 mm/20Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2584059	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 5.5 mm/22Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 5.5 mm/22Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584071	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 6.0 mm/24Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 6.0 mm/24Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584060	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 6.5 mm/26Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 6.5 mm/26Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584072	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 7.0 mm/28Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL-	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 7.0 mm/28Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2584073	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 7.5 mm/30Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 7.5 mm/30Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584074	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 8.0 mm/32Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 8.0 mm/32Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584075	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 8.5 mm/34Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 8.5 mm/34Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.
2584076	42271709	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 9.0 mm/36Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE- ESTERIL-	CANULA NASOFARINGEA NUMERO 9.0 mm/36Fr - MATERIAL PVC SILICONADO – DISEÑO ANATOMICO Y FLEXIBLE - CON PAREDES DELGADAS Y SUAVES - CON TOPE NASAL - CODIGO ATRAUMATICA - EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESECHABLE.

							EMPAQUE INDIVIDUAL	
2504880	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO PEQUEÑO No 3 /30-60 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO PEQUEÑO No 3 /30-60 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504881	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO No 4 /50-90 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO No 4 /50-90 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504882	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO No 5 /+ 90 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA ADULTO No 5 /+ 90 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504883	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA NEONATO No 1 /2-5 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA NEONATO No 1 /2-5 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504878	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 1.5 /5-12 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 1.5 /5-12 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504879	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 2.5 /25-35 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 2.5 /25-35 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL

2504877	42271909	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 2 /10-25 KG EN MATERIAL SUAVE TIPO GEL	CANULA SUPRAGLOTICA PEDIATRICA No 2 /10-25 Kg DISPOSITIVO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX Y PVC-CON ALMOHADILLA NO INFLABLE DE MATERIAL SUAVE TIPO GEL-CONEXIÓN ESTANDAR PARA SISTEMA ANESTESICO-ESTERIL-USO-ESTABILIZACION DE LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501272	42271505	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 14FR, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 14FR. CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCTORA-AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER GUIA CON 2 MARCAS DE POSICION SITUADAS A 20 cm DE CADA EXTREMO-CATETER RADIOPACO-UNA JERINGA PARA CODIGO Y UN CATETER 16-18G-INDICADO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE UN TUBO ENDOTRAQUEAL DURANTE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA A DIFICILES ACCESOS A LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL
2501273	42271505	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 16FR, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 16FR. CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCTORA-AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER GUIA CON 2 MARCAS DE POSICION SITUADAS A 20 cm DE CADA EXTREMO-CATETER RADIOPACO-UNA JERINGA PARA CODIGO Y UN CATETER 16-18G-INDICADO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE UN TUBO ENDOTRAQUEAL DURANTE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA A DIFICILES ACCESOS A LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL
2501274	42271505	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 10FR, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 10FR. CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCTORA-AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER GUIA CON 2 MARCAS DE POSICION SITUADAS A 20 cm DE CADA EXTREMO-CATETER RADIOPACO-UNA JERINGA PARA CODIGO Y UN CATETER 16-18G-INDICADO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE UN TUBO ENDOTRAQUEAL DURANTE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA A DIFICILES ACCESOS A LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL
2501275	42271505	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	KIT	A.02.02.01.003.006	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 2.5FR, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO 2.5FR. CONSTA DE UNA AGUJA INTRODUCTORA-AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER GUIA CON 2 MARCAS DE POSICION SITUADAS A 20 cm DE CADA EXTREMO-CATETER RADIOPACO-UNA JERINGA PARA CODIGO Y UN CATETER 20-18G-INDICADO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE UN TUBO ENDOTRAQUEAL DURANTE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA A DIFICILES ACCESOS A LA VIA AEREA-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

2584062	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA No 1 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION-TRANSPARENTE- CON VALVULA DE INSUFLACION-ARO SUJETADOR DE ARNES	MASCARA No1 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION TRANSPARENTE-SIN LATEX- CON VALVULA DE INSUFLACION (COLCHON INFLABLE), ARO SUJETADOR DE ARNES-CONECTOR DE 22 mm-NO ESTERIL
2584063	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA No 2 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION-TRANSPARENTE- CON VALVULA DE INSUFLACION-ARO SUJETADOR DE ARNES	MASCARA No2 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION TRANSPARENTE-SIN LATEX- CON VALVULA DE INSUFLACION (COLCHON INFLABLE), ARO SUJETADOR DE ARNES-CONECTOR DE 22 mm-NO ESTERIL
2584064	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA No 3 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION-TRANSPARENTE- CON VALVULA DE INSUFLACION-ARO SUJETADOR DE ARNES	MASCARA No3 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION TRANSPARENTE-SIN LATEX- CON VALVULA DE INSUFLACION (COLCHON INFLABLE), ARO SUJETADOR DE ARNES-CONECTOR DE 22 mm-NO ESTERIL
2584065	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA No 4 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION-TRANSPARENTE- CON VALVULA DE INSUFLACION-ARO SUJETADOR DE ARNES	MASCARA No4 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION TRANSPARENTE-SIN LATEX- CON VALVULA DE INSUFLACION (COLCHON INFLABLE), ARO SUJETADOR DE ARNES-CONECTOR DE 22 mm-NO ESTERIL

2584066	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA No 5 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION-TRANSPARENTE- CON VALVULA DE INSUFLACION-ARO SUJETADOR DE ARNES	MASCARA No5 DESCARTABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION TRANSPARENTE-SIN LATEX- CON VALVULA DE INSUFLACION (COLCHON INFLABLE), ARO SUJETADOR DE ARNES-CONECTOR DE 22 mm-NO ESTERIL
2500481	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No.3	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No.3-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500482	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No 4-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No.4-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500483	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No 5-EMPAQUE INDIVIDUAL.	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO No 5-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500478	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 0-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 0-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500479	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 1-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 1-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL

2500480	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 2-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA No 2-DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANATOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION-ADAPTADOR DE 15 mm-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500487	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA ADULTO No. 4-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA ADULTO No. 4 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500488	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA ADULTO No. 3-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA ADULTO No. 3 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500489	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA ADULTO No. 5-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA ADULTO No. 5 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500484	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA PEDIATRICA No. 0-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA PEDIATRICA No. 0 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500485	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA PEDIATRICA No. 1-EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA PEDIATRICA No. 1 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500486	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCO SCOPIA PEDIATRICA No.	MASCARA FACIAL PARA FIBROBRONCOSCOPIA PEDIATRICA No. 2 ESTERIL-TRANSPARENTE-LIBRE DE LATEX-PUERTO DE ENTRADA PARA INSERCION DE FIBROBRONCOSPIO-REFORZAMIENTO DE LA MASCARA ENTRE LA PIEZA DE CONEXION DE

							2-EMPAQUE INDIVIDUAL	OXIGENO Y EL NEUMO DE INSUFLACION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500471	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No.1-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No.1- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583765	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No.1.0-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 1.0 DESECHABLE–MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2500472	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No.1.5-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No.1.5- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583766	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No.1.5-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 1.5 DESECHABLE–MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2500473	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 2.0-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No. 2.0- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL

2583767	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 2.0-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 2.0 DESECHABLE–MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2500474	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 2.5-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No. 2.5- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583768	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 2.5-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 2.5 DESECHABLE–MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2500475	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 3.0-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No. 3.0- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583769	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 3.0-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE	MASCARA LARINGEA No. 3.0 DESECHABLE–MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL

							INDIVIDUAL-ESTERIL	
2500476	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 4.0-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No. 4.0- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583770	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 4.0-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 4.0 DESECHABLE– MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2500477	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 5.0-ELABORADA EN SILICONA-LIBRE DE LATEX-AUTOCLAVABLE	MASCARA LARINGEA No. 5.0- ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX-TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA-CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON)-CON CONECTOR DE 15 mm-QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL
2583771	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA No. 5.0-DESECHABLE-ELABORADA EN PVC Y SILICONA-LIBRE DE LATEX-EMPAQUE INDIVIDUAL-ESTERIL	MASCARA LARINGEA No. 5.0 DESECHABLE– MATERIAL PVC Y SILICONA – TUBO TRANSPARENTE CON GUIA DE INSERCION – MANGUITO INFLABLE – VALVULA DE INSUFLACION UNIDIRECCIONAL – ANATOMICA Y CONFORTABLE PARA LA INSERCION – CONECTOR DE 15mm-ESTERIL
2503220	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA, DESCARTABLE NO.3, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDIDCO,	MASCARA LARINGEA N°3.0, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, DESCARTABLE, PARA UN SOLO USO. DE CUERPO FLEXIBLE O RI

							LIBRE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	
2503218	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA, DESCARTABLE N°4, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDIDCO, LIBRE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA LARINGEA N°4.0, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, DESCARTABLE, PARA UN SOLO USO. DE CUERPO FLEXIBLE O RI
2503219	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA LARINGEA, DESCARTABLE NO.5, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDIDCO, LIBRE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	MASCARA LARINGEA N°5.0, ELABORADA EN SILICONA GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, DESCARTABLE, PARA UN SOLO USO. DE CUERPO FLEXIBLE O RI
2584061	42271708	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	MASCARA REUSABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION, TRANSPARENTE, EN SILICONA. ADULTO/GRANDE, N° 6	MASCARA REUSABLE PARA ANESTESIA Y VENTILACION, TRANSPARENTE, EN SILICONA. ADULTO/GRANDE, N° 6
2584067	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	RESERVORIO DESCARTABLE PARA OXIGENO, PARA USAR CON RESUCITADOR, CAPACIDAD 2500 CC,	RESERVORIO DESCARTABLE PARA OXIGENO, PARA USAR CON RESUCITADOR, CAPACIDAD 2500 CC, CONECTOR 22 mm, USO ADULTO

							CONECTOR 22 mm, USO ADULTO	
2584068	42270000	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	RESERVORIO DESCARTABLE PARA OXIGENO, PARA USAR CON RESUCITADOR, CAPACIDAD 2500 CC, CONECTOR 22 mm, USO PEDIATRIXCO	RESERVORIO DESCARTABLE PARA OXIGENO, PARA USAR CON RESUCITADOR, CAPACIDAD 2500 CC, CONECTOR 22 mm, USO PEDIATRICO
2501023	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO LARINGEO ADULTO No.3, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO LARINGEO ADULTO No. 3 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-TUBO CON DOBLE LUMEN-ELABORADO EN SILICONA-BALON OROFARINGEO-BALON ESOFAGICO.CANAL DE DRENAJE NASOGASTRICO
2501024	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO LARINGEO ADULTO No.4, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO LARINGEO ADULTO No. 4 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-TUBO CON DOBLE LUMEN-ELABORADO EN SILICONA-BALON OROFARINGEO-BALON ESOFAGICO.CANAL DE DRENAJE NASOGASTRICO
2501025	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO LARINGEO ADULTO No.5, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO LARINGEO ADULTO No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-TUBO CON DOBLE LUMEN-ELABORADO EN SILICONA-BALON OROFARINGEO-BALON ESOFAGICO.CANAL DE DRENAJE NASOGASTRICO
2501026	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO LARINGEOPEDIATRICO No.1, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO LARINGEO PEDIATRICO No. 1 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-TUBO CON DOBLE LUMEN-ELABORADO EN SILICONA-BALON OROFARINGEO-BALON ESOFAGICO.CANAL DE DRENAJE NASOGASTRICO
2501027	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO LARINGEOPEDIATRICO No.2 ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO LARINGEO PEDIATRICO No. 2 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-TUBO CON DOBLE LUMEN-ELABORADO EN SILICONA-BALON OROFARINGEO-BALON ESOFAGICO.CANAL DE DRENAJE NASOGASTRICO

2503707	42271903	ZMQX	ZMQX-005	ZMQX-005-4	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO TRAQUEAL EN T: EN PLASTICO GRADO MEDICO, PERMITE MANTENER UN ADECUADO CALIBRE DE LA VIA AEREA	TUBO TRAQUEAL EN T- EN PLASTICO LATEX GRADO MEDICO- 5"x12-, PERMITE MANTENER UN ADECUADO CALIBRE DE LA VIA AEREA- PUEDE ACTUAR COMO SOPORTE DE LA PARED TRAQUEAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS- INDICADO EN LA ESTENOSIS TRAQUEAL- TRAUMATISMOS-RECONSTRUCCION TRAQUEA- ETC.-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
BORDERLINE								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2584047	42311601	9120	ZMQX	ZMQX-005	C/U	A.02.02.01.003.005	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE 7cm x 5cm x 1cm	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA PORCINA- ABSORBIBLE 7cm x 5cm x 1cm-HEMOSTATICO-DE FACIL MANIPULACION-DE FACIL ABSORCION- BARRERA DE FLUJO SANGUINEO- MATRIZ PARA LA FORMACION DE COAGULO- ESTERIL- EMPAQUE INDIVIDUAL
ROPA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA BATAS - VESTIDO QUIRURGICO								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2500149	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-ESTERIL-TALLA XL	BATA CIRUJANO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-CON UNA CARA TRANSPARTENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO-DEBIDAMENTE SELLADO PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD

2500150	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-ESTERIL-TALLA L	BATA CIRUJANO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO-CON UNA CARA TRANSPARTENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO-DEBIDAMENTE SELLADO PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2500153	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-ESTERIL-TALLA S	BATA CIRUJANO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO-CON UNA CARA TRANSPARTENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO-DEBIDAMENTE SELLADO PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2500154	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-ESTERIL-TALLA M	BATA CIRUJANO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO-CON UNA CARA TRANSPARTENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO-DEBIDAMENTE SELLADO PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2500162	42131504	ZMQX	ZMQX-006	. ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-NO ESTERIL-TALLA XL	BATA QUIRUGICA DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2500163	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS GRADO MEDICO-DESECHABLE-NO ESTERIL-TALLA S	BATA QUIRUGICA DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500164	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO SIN MANGA EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS-NO ESTERIL	BATA DESECHABLE PACIENTE SIN MANGA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501447	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA LABORATORIO DESECHABLE-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA XL	BATA PARA LABORATORIO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CUELLO REDONDO-CREMALLERA DELANTERA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-PERMEABILIDAD AL AIRE-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501723	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA XL	BATA DESECHABLE PACIENTE SIN MANGA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501724	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA M	BATA DESECHABLE PACIENTE SIN MANGA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2501725	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA X	BATA DESECHABLE PACIENTE SIN MANGA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501726	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA S	BATA DESECHABLE PACIENTE SIN MANGA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502547	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-TELA-SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA S	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-MANGA LARGA SIN PUÑO-CUELLO REDONDO EN ALGODON-EN TELA SMS DE 30 A 45 gr-CON ABERTURA Y BROCHES PLASTICOS FRONTALES- 2 BOLSILLOS ANTERIORES-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS- NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502548	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA L	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-MANGA LARGA SIN PUÑO-CUELLO REDONDO EN ALGODON-EN TELA SMS DE 30 A 45 gr-CON ABERTURA Y BROCHES PLASTICOS FRONTALES- 2 BOLSILLOS ANTERIORES-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS- NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503968	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO EN TELA SMS GRADO MEDICO-SMS-NO ESTERIL-TALLA M	BATA DESECHABLE PACIENTE CON MANGA LARGA CON PUÑO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2504279	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA PACIENTE CON MANGA CORTA-EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-TALLA XL	BATA PACIENTE CON MANGA CORTA-EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-QUE NO PRESENTE MOTAS-RESISTENTE A RUPTURAS Y MULTIPLES LAVADAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504887	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA PACIENTE CON MANGA CORTA-EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-TALLA L	BATA PACIENTE CON MANGA CORTA-EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-QUE NO PRESENTE MOTAS-RESISTENTE A RUPTURAS Y MULTIPLES LAVADAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504934	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA M	BATA DESECHABLE TIPO CONSULTORIO-MANGA LARGA SIN PUÑO-CUELLO REDONDO EN ALGODON-EN TELA SMS DE 30 A 45 gr-CON ABERTURA Y BROCHES PLASTICOS FRONTALES- 2 BOLSILLOS ANTERIORES-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS- NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2583783	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA LABORATORIO DESECHABLE-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA S	BATA PARA LABORATORIO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CUELLO REDONDO-CREMALLERA DELANTERA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-PERMEABILIDAD AL AIRE-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2583785	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE PEDIATRICO-EN TELA NO TEJIDA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL	BATA DESECHABLE PACIENTE PEDIATRICO CON MANGA CORTA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 60 A 70 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2583786	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO MANGA CORTA EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS-TALLA L	BATA DESECHABLE PACIENTE MANGA CORTA-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-NO TRANSPARENTE-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR A 2 NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-NO ESTERIL-TALLA L-EMPAQUE INDIVIDUAL

2583787	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA LABORATORIO DESECHABLE-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA L	BATA PARA LABORATORIO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CUELLO REDONDO-CREMALLERA DELANTERA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-PERMEABILIDAD AL AIRE-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2583923	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA PARA LABORATORIO DESECHABLE-EN TELA SMS GRADO MEDICO-NO ESTERIL-TALLA M	BATA PARA LABORATORIO-DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 45 gr-CUELLO REDONDO-CREMALLERA DELANTERA-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-PERMEABILIDAD AL AIRE-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2584041	42131504	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	BATA CIRUJANO EN TELA SMS-DESECHABLE-NO ESTERIL-TALLA M	BATA QUIRUGICA DESECHABLE-MANGA LARGA CON PUÑO RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA-GRADO MEDICO-SMS DE 30 A 35 gr-CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 4 A NIVEL DE CINTURA (2 CON SUJETADORES DE SEGUIRIDAD Y DOS INTERNOS)-LARGO DE 120 A 150 cm-TELA REPELENTE A FLUIDOS-NO ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503942	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	TRAJE DE PROTECCION AGENTES QUIMICOS TALLA M	TRAJE DE PROTECCION CONTRA AGENTES-EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO EN AMBAS CARAS DE LA PRENDA-LIGERO-DURADERO-TRANSPIRABLE-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-REPELE LIQUIDOS DE BASE ACUOSA Y AEROSOLES-ABRASION-PROTECCION DE BARRERA-RESISTENTE A LA TRACCION-DESCRIPCION-MONO COLOR BLANCO CON CUELLO- COSTURAS INTERNAS - CREMALLERA-SOLAPA- ELASTICOS EN LOS PUÑOS- TOBILLOS Y CINTURA. CATEGORIA III/TIPO 5/6-USO-PROTEGER AL UTILIZADOR CONTRA PRODUCTOS PELIGROSOS-EMPAQUE INDIVIDUAL-CON LA ETIQUETA DE LA TALLA EN CADA BOLSA
2500515	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE-EN TELA SMS-EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA XL	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA DE MAYO Y PANTALON EN TELA SMS 35 gr- CON BOLSILLO TIPO APLIQUE- PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA- BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- TELA RESISTENTE A FLUIDOS-TALLA XL- ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL

2500516	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE-EN TELA SMS-EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA S	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO- MANGA CORTA EN SMS 35 gr- CON BOLSILLO TIPO APLIQUE-PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- TELA RESISTENTE A FLUIDOS- TALLA S-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500517	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (GORRO-BLUSA-PANTALON-POLAINAS-TAPABOCAS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-TALLA M	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO-MANGA CORTA-CON BOLSILLO TIPO APLIQUE-PANTALON RESORTADO EN LACINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR-TELA EN SMS 35 gr-RESISTENTE A FLUIDOS-GORRO REDONDO ENCAUCHADO-TAPABOCAS DE AMARRADERA-DOBLE FILTRO-POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE-BARRERA DE BIOSEGURIDAD--TALLA M-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500518	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (GORRO-BLUSA-PANTALON-POLAINAS-TAPABOCAS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-TALLA L	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO-MANGA CORTA-CON BOLSILLO TIPO APLIQUE-PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR-TELA EN SMS 35 gr-RESISTENTE A FLUIDOS-GORRO REDONDO ENCAUCHADO-TAPABOCAS DE AMARRADERA-DOBLE FILTRO-POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE-BARRERA DE BIOSEGURIDAD-TALLA L-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500519	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE (GORRO-BLUSA-PANTALON-POLAINAS-TAPABOCAS)-EMPAQUE INDIVIDUAL-TALLA XL	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO- MANGA CORTA-CON BOLSILLO TIPO APLIQUE- PANTALON RESORTADO EN LACINTURA- BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- TELA EN SMS 35 gr-RESISTENTE A FLUIDOS- GORRO REDONDO EN BONLAM 15 gr ENCAUCHADO- TAPABOCAS DE AMARRADERA- DOBLE FILTRO- POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE.BARRERA DE BIOSEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA XL
2500520	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE-EN TELA SMS-EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA XL	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA DE MAYO Y PANTALON EN TELA SMS 35 gr-CON BOLSILLO TIPO APLIQUE-PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR-TELA RESISTENTE A FLUIDOS-TALLA M-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2501794	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE-EN TELA SMS-EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA M	VESTIDO QUIRURGICO DESECHABLE COMPUESTO POR BLUSA DE MAYO Y PANTALON EN TELA SMS 35 gr-CON BOLSILLO TIPO APLIQUE-PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- TELA RESISTENTE A FLUIDOS-TALLA M-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502340	42131608	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO EN GENERO-COLOR AZUL-TALLA L	VESTIDO QUIRURGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V MANGA CORTA- EN TELA GENERO-CON 3 BOLSILLOS-PANTALON EN TIRAS O RESORTADO ENLA CINTURA-BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR-RESISTENTE AL HIPOCLORITO-COLOR AZUL-CON MARCA EN BOLSILLO DE BLUSA Y PANTALON-TALLA L HOMBRE
2565533	42131608	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO EN GENERO DE COLOR AZUL-TALLA XL	VESTIDO QUIRURGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V MANGA CORTA- EN TELA GENERO-CON 3 BOLSILLOS- PANTALON EN TIRAS O RESORTADO ENLA CINTURA -BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- RESISTENTE AL HIPOCLORITO-COLOR AZUL-CON MARCA EN BOLSILLO DE BLUSA Y PANTALON-TALLA XL HOMBRE
2582830	42131608	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-1	C/U	A.02-02.01.002.007	VESTIDO QUIRURGICO EN GENERO DE COLOR AZUL-TALLA M	VESTIDO QUIRURGICO COMPUESTO POR BLUSA CUELLO EN V MANGA CORTA- EN TELA GENERO-CON 3 BOLSILLOS- PANTALON EN TIRAS O RESORTADO ENLA CINTURA - BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR- RESISTENTE AL HIPOCLORITO-COLOR AZUL-CON MARCA EN BOLSILLO DE BLUSA Y PANTALON-TALLA M-HOMBRE

CAMPOS - COMPRESAS - ENVOLVEDERAS

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502331	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO OJO FENESTRADO DE 80X80 cm-EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO DE OJO FENESTRADO DE 80 X 80 cm-DESECHABLE-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO SMS 35-45 gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA REDONDA DE 10 cm-DE DIAMETRO CENTRAL-CON REFUERZO-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO- EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL

								GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2500160	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO PARA OTORRINO FENESTRADO DE 220 cm X 120 A 150 cm EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO PARA OTORRINO-FENESTRADO DE 220 cm X 120 A 150 cm-DESECHABLE-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA DE 15 cm X 15 cm EN LA PARTE SUPERIOR-CON REFUERZO-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2503508	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 240 X 160 A 180 cm-EN TELA 100% ALGODON-REUTILIZABLE	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 240 X 160 A 180 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (POLIESTER) ANTICLORO-CON FENESTRA CENTRAL DE 15 X 15 cm-CON REFUERZO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2503711	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO DE 50 cm X 70 A 100 cm EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO DE 50 cm X 70 A 100 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-DESECHABLE-SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2504041	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO OJO EN TELA GENERO 72 cm X 70 A 100 cm-CON FENESTRA 6 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO DE OJO FENESTRADO DE 72 cm X 70 A 100 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (GENERO) ANTICLORO-CON FENESTRA REDONDA DE 6 cm DE DIAMETRO CENTRAL-CON REFUERZO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2504042	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO EN TELA GENERO 72 cm X 72 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO QUIRURGICO DE 72 cm X 72 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (GENERO) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE

2504043	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO EN TELA GENERO 230 cm X 150-180 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO QUIRURGICO DE 230 cm X 70 A 100 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (GENERO) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2504044	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO EN TELA GENERO 230cm X 150-180 cm-CON FENESTRA-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 230 cm X 150 A 180 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (GENERO) ANTICLORO-CON FENESTRA DE 2 cm DE DIAMETRO-CON REFUERZO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2504281	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO DE OJO FENESTRADO DE 100 cm (1.0 m) X 70 A 100 cm-CON FENESTRA-EN TELA DE ALGODON-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO DE OJO FENESTRADO DE 100 cm (1.0 m) X 70 A 100 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (DRILL) ANTICLORO-CON FENESTRA CENTRAL-REDONDA DE 6 cm DE DIAMETRO -CON REFUERZO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2504888	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO PARA PIEL DE 100 cm (1.0 m) X 70 A 100 cm-EN TELA 100% ALGODON (DRILL) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO PARA PIEL DE 100 cm (1.0 m) X 70 A 100 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (DRILL) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2505157	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO DE OJO FENESTRADO DE 90 X 90 A 100 cm-EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO DE OJO-FENESTRADO DE 90 X 90 A 120 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA REDONDA DE 10 cm DE DIAMETRO-CON REFUERZO-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD

2504270	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO PARA PIEL DE 90 cm X 90 A 120 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (DRILL) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	CAMPO PARA PIEL DE 90 cm X 90 A 120 cm-ELABORADO EN TELA 100% ALGODON (DRILL) ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2502274	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION EN U DE 120 cm X 130-150 cm-EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION EN U 120 cm X 130 A 150 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2584025	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION EN U DE 75 cm X 90-120 cm-EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION EN U 75 cm X 90 A 120 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2502635	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLGIA FENESTRADO DE 35 cm X 40 A 80 cm EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE IDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA-FENESTRADO DE 35 X 40 A 80 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA DE 6 cm DE DIAMETRO-CON REFUERZO-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD

2500002	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA FENESTRADO 45 cm X 60 cm EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA FENESTRADO DE 45 cm X 60 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DESECHABLE GRADO MEDICO SMS 35-45 gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA CENTRAL DE 15 cm DE DIAMETRO CON REFUERZO-SIN ESTERILIZAR-USO-DELIMITAR EL AREA QUIRURGICA-
2587053	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE 220 cm X 130-160 cm-CON FENESTRA-EN TELA SMS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	CAMPO QUIRURGICO-FENESTRADO DE 220 cm X 130 A 150 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-CON FENESTRA SUPERIOR CENTRAL DE 15 cm X 15 cm DE DIAMETRO-CON REFUERZO-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2584043	42131501	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL CON ABERTURA EN U DE 120 cm (1.20 m) X 180 cm (1.80m)	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION EN U 120 X 180 A 120 cm-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA-DESECHABLE-GRADO MEDICO SMS 35-45gr-MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-RESISTENTE A LA TENSION-ESTERIL-CON INDICADOR QUIMICO-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2501105	42311505	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X 45 cm-UNIDAD	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X 45 cm-GASA NATURAL-ALTAMENTE ABSORBENTE-HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODON-DE ESTRUCTURA UNIFORME-RESISTENTE-PARA MULTIPLES USOS-SIN TESTIGO RADIOPACO-PRELAVADA-LIBRE DE IMPUREZAS-MINIMO DE 4-6 VUELTAS-RESISTENCIA DE TENSION ADECUADA PARA APOSITOS-CON MANIJA DE SUJECION CON HILO DE COLOR AZUL

2503024	42311505	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X45 cm-CON TESTIGO RADIOPACO	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X 45 cm-GASA NATURAL-ALTAMENTE ABSORBENTE-HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODON-DE ESTRUCTURA UNIFORME-RESISTENTE-PARA MULTIPLES USOS-CON HILO (TESTIGO) RADIOPACO-PRELAVADA-LIBRE DE IMPUREZAS-MINIMO DE 4-6 VUELTAS-RESISTENCIA DE TENSION ADECUADA PARA APOSITOS-CON MANIJA DE SUJECION CON HILO DE COLOR AZUL
2503299	42311505	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL 45cm X 45 cm-CON TESTIGO RADIOPACO	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X 45 cm-GASA NATURAL-ALTAMENTE ABSORBENTE-HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODON-DE ESTRUCTURA UNIFORME-RESISTENTE-PARA MULTIPLES USOS-CON HILO (TESTIGO) RADIOPACO-PRELAVADA-LIBRE DE IMPUREZAS-MINIMO DE 4-6 VUELTAS-RESISTENCIA DE TENSION ADECUADA PARA APOSITOS-CON MANIJA DE SUJECION CON HILO DE COLOR AZUL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2583782	42311505	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	COMPRESAS QUIRURGICA ESTERIL 45 cm X 45 cm-SIN TESTIGO RADIOPACO	COMPRESA QUIRURGICA NO ESTERIL 45 cm X 45 cm-GASA NATURAL-ALTAMENTE ABSORBENTE-HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODON-DE ESTRUCTURA UNIFORME-RESISTENTE-PARA MULTIPLES USOS-PRELAVADA-LIBRE DE IMPUREZAS-MINIMO DE 4-6 VUELTAS-RESISTENCIA DE TENSION ADECUADA PARA APOSITOS-CON MANIJA DE SUJECION CON HILO DE COLOR AZUL-EMPAQUE INDIVIDUAL PRIMARIO EN PLASTICO Y UNO SECUNDARIO BILAMINADO CON PESTAÑA MINIMA DE 5 mm-UNA CARA TRANSPARENTE Y LA OTRA DE PAPEL GRADO MEDICO DEBIDAMENTE SELLADO-PARA ASEGURAR ESTERILIDAD E INVIOLABILIDAD
2584044	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	COMPRESERO DESECHABLE GRANDE PARA RECOLECCION DE ROPA	COMPRESERO BOLSA DESECHABLE GRANDE PARA LA RECOLECCION DE ROPA-EN TELA SMS DE 45 A 25-35 gr DE 120 cm DE PROFUNDIDAD X 120 cm DE ANCHO-RESORTADO CON REFUERZO EN RESORTE Y TIRAS PARA CERRAR

2500178	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 120 X 120 +/- 2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 120 X 120 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2500179	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 45 X 45 +/- 2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 75 X 75 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2500181	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 75 X 75 +/- 2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 75 X 75 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS

2500182	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 135 X 150 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 135 X 150 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2501208	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 90 X 100 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 90 X 100 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2502333	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 60 X 60 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 60 X 60 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS

42130000	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON-100 X 100-140 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON- DE LARGO 100 X ANCHO 100 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-DEBE FACILITAR LA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE PARA OBTENER RESULTADOS CORRECTOS-PERMITIR LA LIBERACION DE LA SUSTANCIA ESTERILIZANTE AL FINAL DEL TIEMPO DE EXPOSICION-NO DESGARRARSE NI PERMITIR PERFORACIONES DURANTE LA MANIPULACION-NO PRODUCIR PELUSA-ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
42130000	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON-200 X 150-180 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON- DE LARGO 200 X 150-180 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-DEBE FACILITAR LA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE PARA OBTENER RESULTADOS CORRECTOS-PERMITIR LA LIBERACION DE LA SUSTANCIA ESTERILIZANTE AL FINAL DEL TIEMPO DE EXPOSICION-NO DESGARRARSE NI PERMITIR PERFORACIONES DURANTE LA MANIPULACION-NO PRODUCIR PELUSA-ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
42130000	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON-160 X 180-200 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON- DE LARGO 160 X 180-200 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-DEBE FACILITAR LA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE PARA OBTENER RESULTADOS CORRECTOS-PERMITIR LA LIBERACION DE LA SUSTANCIA ESTERILIZANTE AL FINAL DEL TIEMPO DE EXPOSICION-NO DESGARRARSE NI PERMITIR PERFORACIONES DURANTE LA MANIPULACION-NO PRODUCIR PELUSA-ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
42130000	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON-125 X 125-150 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-NO ESTERIL-REUTILIZABLE	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON- DE LARGO 125 X 125-150 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-DEBE FACILITAR LA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE PARA OBTENER RESULTADOS CORRECTOS-PERMITIR LA LIBERACION DE LA SUSTANCIA ESTERILIZANTE AL FINAL DEL TIEMPO DE EXPOSICION-NO DESGARRARSE NI PERMITIR PERFORACIONES DURANTE LA MANIPULACION-NO PRODUCIR PELUSA-ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
42130000	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 1.45x1.45m EN TELA DE ALGODON TIPO DRIL	ENVOLVEDERA EN TELA DRILL 100% ALGODON- DE LARGO 145 X 145-180 cm-CON DOBLADILLO DE 1 cm-DEBE FACILITAR LA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE PARA OBTENER RESULTADOS CORRECTOS-PERMITIR LA LIBERACION DE LA SUSTANCIA ESTERILIZANTE AL FINAL DEL TIEMPO DE EXPOSICION-NO DESGARRARSE NI PERMITIR PERFORACIONES

								DURANTE LA MANIPULACION-NO PRODUCIR PELUSA-ANTICLORO-NO ESTERIL-REUTILIZABLE
2584026	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 70 X 70 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 70 X 70 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2584046	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 90 X 90 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 90 X 90 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS
2587173	42281902	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-2	C/U	A.02.02.01.002.007	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 50 X 50 +/-2cm-EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA-SMS-GRAMAJE 35-60g	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 50 X 50 +/-2 cm-ELABORADA EN POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS- GRAMAJE DE 35 A 60 gr-REPELENTE A FLUIDOS-BAJO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS-ALTA PERMEABILIDAD QUE PERMITA EL PASO DE AGENTES ESTERILIZANTES-CON BARRERA MICROBIANA QUE PREVIENE EL PASO DE MICROORGANISMOS Y ASI MANTENER LA ESTERILIDAD DEL CONTENIDO-CON RESISTENCIA MULTIDIRECIONAL A LA TENSION-ABRASION Y RASGADO- RESISTA EL PESO DEL INSTRUMENTAL-CONTROL DE FLUIDOS Y LIQUIDOS-MALEABLE Y FACIL DE MANEJAR-RESISTENTE AL CALOR-DOBLADA EN CUADROS

GORROS - POLAINAS - TAPABOCAS								
Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502974	42131604	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO-EN TELA SMS DE 15-35 gr-CON CINTAS PARA ATAR	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO-EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS 15-35 g-ALTA RESPIRABILIDAD-DIAMETRO 52 c- COBERTURA COMPLETA DE LA CABEZA-CON CINTAS PARA ATAR-AJUSTE SUAVE-BUENA PERMEABILIDAD DEL AIRE-RESISTENTE AL DESGARRO-QUE NO DESPRENDA PELUSAS-NO ESTERIL
2500448	42131604	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO EN TELA SMS 15-35 gr NO ESTERIL	GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO BOLAN-RESORTADO-EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS DE 15- 35 gr-ALTA RESPIRABILIDAD-ELASTICO RESISTENTE-COBERTURA COMPLETA DE LA CABEZA-DE AJUSTE SUAVE Y FIRME-BUENA PERMEABILIDAD DEL AIRE-RESISTENTE AL DESGARRO-QUE NO DESPRENDA PELUSA-TAMAÑO ESTANDAR-NO ESTERIL
2500502	42131609	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	POLAINA DE COLOR AZUL-ANTIDESLIZANTE-EN TELA SMS-25-50 gr-DESECHABLE	POLAINA ANTIDESLIZANTE-DESECHABLE-EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS-25-50 gr-ELASTICO DE LATEX NATURAL A NIVEL DE TOBILLO- CON BARRERA DE PROTECCION AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES (ANTIFLUIDOS)-RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA Y PARTICULAS VOLATILES-SIN OLOR-RESISTENTE CON ADECUADA VENTILACION-QUE NO ACALORE-QUE EVITELA SALIDA DEL CALZADO Y CONTAMINACION-QUE GARANTICE HIGIENE Y SEGURIDAD-- USO: QUE SIRVA DE BARRERA PROTECTORA ENTRE EL CALZADO Y EL MEDIO EXTERNO-COLOR AZUL-UNIDAD DE MEDIDA PAR-EMPAQUE EN PLASTICO
2504280	42131609	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	POLAINA GINECOLOGICA 2m x 1.50m EN TELA DE ALGODON TIPO DRIL. PAR	POLAINA GINECOLOGICA EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-MEDIDAS 130-140 cm-QUE NO PRESENTE MOTAS-RESISTENTE A RUPTURAS Y MULTIPLES LAVADAS-TIPO TALEGO-QUE CUBRA TOTALMENTE LA PIERNA-NO ESTERIL-UNIDAD DE MEDIDA PAR-EMPAQUE EN PLASTICO
2582182	42131609	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	POLAINA GINECOLOGICA EN TELA SMS 25-50 gr-UNIDAD DE MEDIDA-PAR	POLAINA GINECOLOGICA-DESECHABLE-EN TELA NO TEJIDADA GRADO MEDICO SMS 25-50 gr-MEDIDAS 120-140 X 50 cm-CON BARRERA DE PROTECCION AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES (ANTIFLUIDOS) RESISTENTE A RUPTURAS-LIBRE DE PELUSA Y PARTICULAS VOLATILES-TIPO TALEGO QUE CUBRA

								TOTALMENTE LA PIERNA-UNIDAD DE MEDIDA-PAR-EMPAQUE EN PLASTICO
2500505	42131606	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	TAPABOCA CON VISOR PROTECTOR-DESECHABLE-ELABORADO EN TELA SMS-DESECHABLE	TAPABOCA CON VISOR PROTECTOR-DESECHABLE-ELABORADO EN TELA NO TEJIDA SMS-ANTIFLUIDOS-CAPA INTERNA DE 25g-CAPA INTERMEDIA Y EXTERNA DE 20g (CON DOBLE FILTRO PARA EFICIENCIA DE FILTRACION BACETRIANA SUPERIOR AL 98%-ALTA RESPIRABILIDAD-ADAPTADOR NASAL ANATOMICO-CON 2 SUJETADORES DE CAUCHO EN LATEX TEJIDO PARA SOPORTE EN OREJAS-LIBRE DE COSTURAS-FACIL MANIPULACION-SU USO EVITA QUE LOS MICROORGANISMOS EXPULSADOS AL HABLAR O AL TOSER O RESPIRAR LLEGUEN AL PACIENTE O PRODUCTO MANIPULAD-QUE SE ADPATE A CUALQUIER TAMAÑO O FORMA DE CARA-EMPAQUE PLASTICO
2500506	42131606	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	TAPABOCA DESECHABLE-EN TELA NO TEJIDA SMS-CON TIRAS DE CAUCHO-SOPORTE A LAS OREJAS	TAPABOCA DESECHABLE-EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS-TRES PLIEGUES INTERIORES Y EXTERIORES-CAPA INTERNA DE 25 gr-CAPA INTERMEDIA Y EXTERNA DE 20 gr-CON DOBLE FILTRO PARA UNA EFICIENCIA DE FILTRACION BACETRIANA SUPERIOR AL 98%-ALTA RESPIRABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS FLUIDOS-ADAPTADOR NASAL ANATOMICO-TIRAS DE CAUCHO EN HILO LATEX-SOPORTE EN OREJAS-LIBRE DE COSTURAS-HIPOALERGENICO-FACIL MANIPULACION-USO-EVITAR CONTACTO CON FLUIDOS Y/O SANGRE-BARRERA FRENTE A EMISION DE FLUIDOS BUCALES-EMPAQUE PLASTICO
2503026	42131606	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	TAPABOCA DESECHABLE EN TELA NO TEJDA SMS DE 25 gr-CON SISTEMA DE AMARRE (4 TIRAS)	TAPABOCA DESECHABLE-EN TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO-SMS-TRES PLIEGUES INTERIORES Y EXTERIORES-CAPA INTERNA DE 25 gr-CAPA INTERMEDIA Y EXTERNA DE 20 gr-CON DOBLE FILTRO PARA UNA EFICIENCIA DE FILTRACION BACETRIANA SUPERIOR AL 98%-ALTA RESPIRABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS FLUIDOS-ADAPTADOR NASAL ANATOMICO-CON SISTEMA DE AMARRE RESISTENTE (4TIRAS EN TELA NO TEJIDA)-LIBRE DE COSTURAS-HIPOALERGENICO-FACIL MANIPULACION-USO-EVITAR CONTACTO CON FLUIDOS Y/O SANGRE-BARRERA FRENTE A EMISION DE FLUIDOS BUCALES

2505579	42131606	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-3	C/U	A.02.02.01.002.007	MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA KN95	MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA KN95-DISEÑO ULTRALIVIANO Y ERONOMICO-TELA NO TEJIDA EN POLIURETANO-POLIESTER-HEBILLAS TERMOSELLADAS-EFICIENCIA DE FILTRACION DEL 95%-ABSORBE LA HUMEDAD Y FILTRA EL POLVO-SE RECOMIENDA QUE SEA AJUSTADA COMPLETAMENTE A LA CARA PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD-CAPA DE CONTACTO DE TELA AMIGALE CON LA PIEL-LIBRE DE COSTURAS COMPLETAMENTE SELLADA

KITS - PAQUETES DE ROPA

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500161	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	KIT	A.02.02.01.002.007	KIT PACIENTE PEDIATRICO-EN TELA SMS GRADO MEDICO 30-35 gr-DESECHABLE-NO ESTERIL	KIT PACIENTE PEDIATRICO COMPUESTO DE BATA PACIENTE-MANGA CISA-AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA-GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA ENCAUCHADO-PAR DE POLAINAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE-EN TELA SMS 30-35 gr GRADO MEDICO-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-NO ESTERIL-DESECHABLE
2500165	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	KIT	A.02.02.01.002.007	KIT PACIENTE ADULTO ROPA EN TELA SMS 30-35 gr BATA CRUCE DELANTERO	COMPUESTO DE BATA PACIENTE-MANGA CISA-TELAS SMS 30/35 gr- ADEALNTE CRUZADA LA TAPA DERECHA 20 CM SOBRE LA IZQUIERDA-CON CUATRO TIRAS SUJETADORAS DE 40 CM CADA UNA-DOS TIRAS A NIVEL DE CUELLO UNA SOBRE EL BORDE DERECHO Y LA OTRA A NIVEL DEL CENTRO DEL HOMBRO IZQUIERDO-DOS TIRAS A LA ALTURA DE LA CINTURA-UNA SOBRE EL BORDE DERECHO Y OTRA SOBRE EL BORDE IZQUIERDO-GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA EN TELA SMS 20gr-ENCAUCHADO-PAR DE POLAINAS EN TELA SMS 30gr-DESECHABLE-CON SUELA ANTIDESLIZANTE

2500166	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	PK	A.02.02.01.002.007	PAQUETE DE ROPA ESTERIL DE LAPAROTOMIA EN TELA SMS GRADO MEDICO DE 35-50 gr-DESECHABLE	PAQUETE DE ROPA ESTERIL PARA LAPARATOMIA-COMPUESTO POR-DE ABAJO HACIA ARRIBA-2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 145 cm-5 COMPRESAS DE 45 X45 cm CON CINTA RADIOPACA-1 CAMPO FENESTRADO DE 250 X 150 cm-CON ORIFICIO CENTRAL DE 30 X 30 cm CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 cm DE ANCHO MAS 1 SABANA DE 1.45 X 180 cm-5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 cm CON ADHESIVO-1 FUNDA DE MAYO GRANDE-2 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL-CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON-CON 2 TOALLAS DE MANOS-1 BATA CIRUJANO TALLA M CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON CON 1 TOALLA-EN TELA DESECHABLE SMS DE 35-50 gr GRADO MEDICO-CON INDICADOR QUIMICO DEL DENTRO DEL PAQUETE
2502334	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	C/U	A.02.02.01.002.007	KIT PACIENTE ADULTO-EN TELA SMS GRADO MEDICO 30-35 gr-DESECHABLE-TALLA XL	KIT PACIENTE ADULTO COMPUESTO POR BATA PACIENTE MANGA CISA CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR-2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA-GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA ENCAUCHADO-PAR DE POLAINAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE-EN TELA SMS 30-35 gr GRADO MEDICO-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-NO ESTERIL-DESECHABLE-TALLA XL
2502337	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	C/U	A.02.02.01.002.007	PAQUETE DE ROPA ESTERIL PARA PEQUEÑA CIRUGIA EN TELA SMS GRADO MEDICO DE 35-50 gr-ESTERIL-DESECHABLE	PAQUETE DE ROPA ESTERIL PARA PEQUEÑA CIRUGIA-COMPUESTO DE ABAJO HACIA ARRIBA POR-2 ENVOLVEDERAS DE 180X150 cm-5 COMPRESAS DE 45X45 cm CON CINTA RADIOPACA-1 CAMPO FENESTRADO DE 220X120 cm-CON ORIFICIO SUPERIOR DE 15 X 15 cm CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 cm DE ANCHO-1 SABANA DE 1.45 X 180 cm-5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 cm CON ADHESIVO DE 1.5 cm DE ANCHO-1 CAMPO DE 80 X 80 cm-SIN ADHESIVO-1 FUNDA DE MAYO GRANDE CON REFUERZO SUPERIOR-2 BATAS DE CIRUJANO CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON-1 TOALLA DE MANOS-EN TELA SMS 30-35 gr GRADO MEDICO-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-DESECHABLE-CON INDICADOR QUIMICO DENTRO DEL PAQUETE-TALLA XL
2503278	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	C/U	A.02.02.01.002.007	PAQUETE PEQUEÑA CIRUGIA TELA DRIL-NO ESTERIL	PAQUETE NO ESTERIL PARA PEQUEÑA CIRUGIA EN DRIL-COMPUESTO POR-DE ABAJO HACIA ARRIBA- 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 150 cm-5 COMPRESAS DE45 X 45 cm CON CINTA RADIOPACA-1 CAMPO FENESTRADO DE 220 cm X 120 cm CON ORIFICIO SUPERIOR DE 15 cm X 15 cm CON REFUERZO DE 1.5 cm DE ANCHO-1 SABANA

								DE 1.45 X 180 cm-5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90cm-1 CAMPO 80 X 80 cm SIN ADHESIVOcm-1 FUNDA DE MAYO GRANDE CON REFUERZO SUPERIOR-2 BATAS DE CIRUJANO CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON-EN TELLA DRILL-TALLA XL-CON TOALLA DE MANOS
2583781	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-4	C/U	A.02.02.01.002.007	PAQUETE ESTERIL PARA LAPAROTOMIA (3 BATAS) EN TELA SMS GRADO MEDICO DE 35-50 gr-DESECHABLE	PAQUETE DE ROPA ESTERIL PARA LAPARATOMIA-COMPUESTO POR-DE ABAJO HACIA ARRIBA 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 145 cm-6 COMPRESAS DE 45X45 cm CON CINTA RADIOPACA-1 CAMPO FENESTRADO DE 250 X 150 cm CON ORIFICIO DE 30 X 30 cm CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 cm DE ANCHO-1 SABANA DE 145 X 180 cm-5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 cm CON ADHESIVO-1 FUNDA DE MAYO GRANDE-3 BATAS DE CIRUJANO 2 TALLA XL Y 1 TALLA M CON PUÑO RESORTADO DE ALGODON-CON 3 TOALLAS DE MANOS-1 BATA DE CIRUJANO TALLA M CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON-1 TOALLA EN TELA DESECHABLE SMS DE 35-50 gr GRADO MEDICO-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-QUE NO DESPRENDA PELUSA-CON EL INDICADOR QUIMICO DENTRO DEL PAQUETE-DESECHABLE

SABANAS - FUNDAS - MANTAS - ROLLOS DE TELA

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500503	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE 1.50 m X 2.0 m-PLANA EN TELA SMS 35-45 gr-GRADO MEDICO-NO ESTERIL	SABANA DESECHABLE 1.50 m X 2.0 m PLANA-ELABORADA EN TELA SMS DE 35-45 gr GRADO MEDICO-LIBRE DE LATEX-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-BARRERA ANTIBACTERIANA-QUE NO DESPRENDA PELUSA-HIPOALERGENICA-NO ESTERIL
2500858	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS DE 2.10 m X 1.10 m-EN TELAS SMS 35-45 gr-GRADO MEDICO-NO ESTERIL	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA)-MEDIDAS- 2.10 m X 1.10 m EN TELA SMS DE 35 A 45 gr GRADO MEDICO-LIBRE DE LATEX-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A RUPTURAS-BARRERA ANTIBACTERIANA-QUE NO DESPRENDA PELUSA-NO ESTERIL

2501209	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TELA SMS ROLLO X 200 METROS-RESISTENTE A LA RUPTURA	ROLLO DE TELA SMS DE 35 A 45 gr-RESISTENTE A LA RUPTURA- PERMEABLE A LOS GASES-REPELENTE A LIQUIDOS-NO GUARDA MEMORIA-HIPOALERGENICA-BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE-DESCARTABLE-QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION
2501278	42142106	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	MANTA TERMICA PEDIATRICA-EMPAQUE INDIVIDUAL	MANTA TERMICA PEDIATRICA EN EMPAQUE INDIVIDUAL-NO ESTERIL-CON CANALES PARA RECIRCULACION DE AIRE-BOQUILLA CON REFORZAMIENTO PARA ANCLAJE A LA MAQUINA DE CALENTAMIENTO-COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE LA INSTITUCION
2501279	42142106	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	MANTA TERMICA NEONATAL-EMPAQUE INDIVIDUAL	MANTA TERMICA NEONATAL EN EMPAQUE INDIVIDUAL-NO ESTERIL-CON CANALES PARA RECIRCULACION DE AIRE-BOQUILLA CON REFORZAMIENTO PARA ANCLAJE A LA MAQUINA DE CALENTAMIENTO-COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE LA INSTITUCION
2502571	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	FUNDA DE MAYO 90 cm X 60 cm-EN TELA SMS-35 gr	FUNDA DE MAYO EN TELA SMS 35 gr-TELA MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A LA RUPTURA-DE MEDIDAS 90 cm LARGO 60 cm DE ANCHO-NO ESTERIL
2502803	11162117	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DE CAUCHO GRIS O DE COLOR BLANCO-AZUL-1 m X 90 cm	SABANA PLANA DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO-DE COLOR GRIS-BLANCO-AZUL-DE 1 m X 90 cm-GROSOR 0.5 mm-RESISTENTE A LA FILTRACION DE LIQUIDOS-A LA TRACCION Y DESGARROS-A PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y TEMPERATURA ALTA ENTRE 15 A 35°C-ANTIALERGICA-SUPERFICIE LISA O TEXTURIZADA-QUE PUEDA ESTERILIZARSE EN VAPOR
2503034	11162117	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DE CAUCHO COLOR GRIS O DE COLOR 1.50 m X 1.0 m-PLANA	SABANA PLANA DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO-DE COLOR GRIS-BLANCO-AZUL-DE 1.50 m X 1.0 m-GROSOR 0.5 mm-RESISTENTE A LA FILTRACION DE LIQUIDOS-A LA TRACCION Y DESGARROS-A PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y TEMPERATURA ALTA ENTRE 15 A 35°C-ANTIALERGICA-SUPERFICIE LISA O TEXTURIZADA-QUE PUEDA ESTERILIZARSE EN VAPOR

2503192	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE RESORTADA-PARA CAMILLA DE 1.90 X 1.0 m EN TELA SMS	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA)-EN TELA SMS 35 gr- RESISTENTE A LA RUPTURA-PERMEABLE A LOS GASES- REPELENTE A LIQUIDOS- NO GUARDA MEMORIA-HIPOALERGENICA- BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE- DESCARTABLE- QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION- MEDIDAS- 1.90 m x 1.0 m
2503492	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA ESTANDAR EN TELA DACRON-PLANA-DE 1.90 m X 0.90 m-COLOR CRUDO	SABANA ESTANDAR-EN TELA DACRON (65% POLIESTER – 35% ALGODON)- EN COLOR CRUDO-TEJIDO PLANO CON DOBLADILLO DE 4 cm-ORIENTADO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y LOS TRES RESTANTES DE 1 cm-CON ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA-EN MEDIDAS DE 1.90 m X 0.90 m
2503493	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA EN TELA BLANCA RESORTADA PARA CAMILLA LARGO 1.82 m X ANCHO 0.52 m	SABANA PARA CAMILLA EN TELA DACRON (65% POLIESTER – 35% ALGODON)- EN COLOR BLANCO-TEJIDO PLANO CON DOBLADILLO DE 4 cm-ORIENTADO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y LOS TRES RESTANTES DE 1 cm-RESORTADA EN LAS PUNTAS-ESCUDO DE LA DISAN RESPECTIVA ESTAMPADO EN EL CENTRO Y ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA-EN MEDIDAS DE LARGO 1.82 m X ANCHO 0.52 m
2503494	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA EN TELA RESORTADA LARGO 1.90 m X ANCHO 0.90 m	SABANA PARA CAMILLA EN TELA DACRON (65% POLIESTER – 35% ALGODON)- EN COLOR BLANCO-TEJIDO PLANO CON DOBLADILLO DE 4 cm-ORIENTADO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y LOS TRES RESTANTES DE 1 cm-RESORTADA EN LAS PUNTAS-ESCUDO DE LA DISAN RESPECTIVA ESTAMPADO EN EL CENTRO Y ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA-EN MEDIDAS DE LARGO 1.82 m X ANCHO 0.52 m
2503495	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA EN TELA RESORTADA LARGO 2.50 m X ANCHO 1:50 m	SABANA RESORTADA EN TELA DE DACRON (65% POLIESTER – 35% ALGODON)- EN COLOR BLANCO-TEJIDO PLANO CON DOBLADILLO DE 4 cm-ORIENTADO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y LOS TRES RESTANTES DE 1 cm-RESORTADA EN LAS PUNTAS-ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA-EN MEDIDAS DE LARGO 2.50 m X ANCHO 1-50 m
2503497	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE PLANA PARA CAMILLA	SABANA DESECHABLE PLANA-MEDIDAS- 1.40 m X 1.0 m-EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO (SMS) 35-60 gr-EXCELENTE RESISTENCIA TENSIL A LA RUPTURA Y ELONGACION-PERMEABLE A LOS

							LARGO 1.40 m x ANCHO 1 m-EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO-EMPAQUE INDIVIDUAL	GASES-REPELENTE A LIQUIDOS-BARRERA MICROBIANA-NO GUARDA MEMORIA-HIPOALERGENICA-BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE-ANTIESTATICA-MINIMO DESPRENDIMIENTO DE PELUSA-NO SE DESILACHA AL CORTARLA-CON TIRILLAS DE AMARRE-DESECHABLE-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503501	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SOBRESABANA EN TELA GENERO LARGO 2.50 m X ANCHO 1.80 m	SOBRESABANA EN TELA GENERO 100% ALGODON-DESENGOMADA O PRELAVADA-COLOR BLANCO-DOBLADILLO DE 1 cm Y EN EL BORDE SUPERIOR UNA CENEFA DE 5 cm-ESCUDO DE LA DISAN ESTAMPADO EN EL CENTRO EN TITNTA TEXTIL-ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA
2503502	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	FUNDA PARA ALMOHADA EN TELA-LARGO 70 cm X ANCHO 50 cm	FUNDA PARA ALMOHADA EN TELA GENERO 100%/ ALGODON DESENGOMADO O PRELAVADO COLOR BLANCO CON UNA CENEFA DE 5 cm-ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA-LARGO 70 cm x ANCHO 50 cm
2503503	42141705	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	ALMOHADA HOSPITALARIA MODULO EN ESPUMA/FIBRA DE VELLON SILICONADO-DOBLE FORRO	ALMOHADA HOSPITALARIA MODULO EN ESPUMA DE ALTA CALIDAD Y/O FIBRAS DE VELLON SILICONADO-CON FUNDA DE POLIESTER-TEJIDO PLANO EN COLOR BLANCO- NCOGIMIENTO MAXIMO DEL 3%-FUNDA EXTERIOR EN PVC ATOXICO- IMPERMEABLE- CIERRE CON DOBLE SOLAPA (CREMALLERA)-REPELENTE A FACTORES AMBIENTALES-INDEFORMABLE-HIPOALERGENICA- POLITERMICA- VIDA UTIL HASTA CINCO AÑOS
2503505	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TELA ANTIFLUIDOS PARA BIOMBO DE LARGO 1.15 m X ANCHO 0.65 m-PLASTIFICABLE-DESMONTABLE Y LAVABLE	TELA ANTIFLUIDOS (POLIESTER) PARA BIOMBO 1.15 m x 0.65 m-IMPERMEABLE A SUSTANCIAS TOXICAS-CORROSIVAS-HIPOCLORITO-SANGRE Y FACTORES AMBIENTALES-REPELE LIQUIDOS-MANCHAS-FACILITANDO SU LIMPIEZA-RESISTENTE A LA TENSION Y AL RASGADO- DE GRAN DURABILIDAD

2503506	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TELA ANTIFLUIDOS PARA BIOMBO DE LARGO 140 X m ANCHO 0.70 m- PLASTIFICABLE-DESMONTABLE Y LAVABLE	TELA ANTIFLUIDOS (POLIESTER) PARA BIOMBO 1.40 m x 0.70 m-IMPERMEABLE A SUSTANCIAS TOXICAS-CORROSIVAS-HIPOCLORITO-SANGRE Y FACTORES AMBIENTALES-REPELE LIQUIDOS-MANCHAS-FACILITANDO SU LIMPIEZA-RESISTENTE A LA TENSION Y AL RASGADO- DE GRAN DURABILIDAD
2503507	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN TELA SMS 35 gr- PARA CAMILLA PEDIATRICA LARGO 1.40 m X ANCHO 0.55 m	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA) DE 1.40 m X 0.55 m-EN TELA SMS 35 gr- RESISTENTE A LA RUPTURA-PERMEABLE ALOS GASES-REPELENTE A LIQUIDOS- NO GUARDA MEMORIA-HIPOALERGENICA-BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE-DESCARTABLE-QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION-PARA PACIENTE PEDIATRICO
2503537	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SOBRESABANA EN TELA GENERO-DESENGOMADA - 2.50 m X 1.50 m	SOBRESABANA EN TELA GENERO ALGODON 100%-DESENGOMADA O PRELAVADA-COLOR BLANCO-DOBLADILLO DE 1 cm Y EN EL BORDE SUPERIOR UNA CENEFA DE 5cm-ESCUDO DE LA DISAN ESTAMPADO EN EL CENTRO EN TITNTA TEXTIL-ACABADOS PARA PROCESOS POSTERIORES DE LAVANDERIA
2503540	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TOLDILLO EN VELO TRASPARENTE PARA CAMA SENCILLA EN POLIESTER	TOLDILLO EN VELO TRASPARENTE CAMA SENCILLA-EN POLIESTER O SIMILAR CON ALTA RESISTENCIA-DIMENSIONES-ANCHO 1.0 m A 1.150 m-LARGO 1.60 m A 1.90 m-ALTO 1.50 m CON POSIBILIDAD DE AJUSTE PARA ADPATARSE A LA ALTURA DE LA CAMA-DE COLOR BLANCO-DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA PRODUCTOS HOSPITALARIOS
2504016	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	RO	A.02.02.01.002.007	TELA NO TEJIDA PARA CAMILLA ROLLO 50cm X 100 m-DE 30gr-NO GENERA PELUSA-ANTIALERGICA-BIODEGRADABLE	TELA SS 30gr-EN FIBRAS DE POLIPROPILENO (PP)-TEREPHTHALATE DE POLIETILENO (PET)-POLIAMIDA (PA)-POLIETILENO (PE)-ACIDO POLILACTICO (PLA)-BIODEGRADABLES-PUEDE SER DE UNA FIBRA O DE COMBINACION DE ESTAS DOS FIBRAS-CARACTERISTICAS- GRAMAJE 30 gr-ALTA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA-ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y DE COLOR-RESITENTE A LA ABRASION-NO GENERA PELUSA-RESISTENTE AL CALOR-BAJA FLAMABILIDAD-NO TOXICA-ANTIALERGICA-RESISTENTE A AGRESIONES BIOLOGICAS- HIDROFILICA E

								HIDROFOBICA-PRESENTACION-ROLLO DE 50 cm X 100 m
2504017	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	RO	A.02.02.01.002.007	TELA NO TEJIDA PARA CAMILLA ROLLO 60 cm X 100 m DE 30 gr-NO GENERA PELUSA-ANTIALERGICA-BIODEGRADABLE	TELA SS (SPUNDBOND)30gr- EN FIBRAS DE POLIPROPILENO (PP)- TEREPHTHALATE DE POLIETILENO (PET)- POLIAMIDA (PA)- POLIETILENO (PE)- ACIDO POLILACTICO (PLA)-BIODEGRADABLES- PUEDE SER DE UNAFIBRA O DE COMBINACION DE ESTAS DOS FIBRAS-CARACTERISTICAS- GRAMAJE 30gr- ALTA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA- ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y DE COLOR-RESITENTE A LA ABRASION-NO GENERA PELUSA-RESISTENTE AL CALOR-B AJA FLAMABILIDADA-NO TOXICA-ANTIALERGICA-RESISTENTE A AGRESIONES BIOLOGICAS-HIDROFILICA E HIDROFOBICA-PRESENTACION- ROLLO DE 60 cm X 100m-
2504018	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	RO	A.02.02.01.002.007	TELA NO TEJIDA PARA CAMILLA ROLLO DE 70 cm X 100 m	TELA SS (SPUNDBOND)30gr-EN FIBRAS DE POLIPROPILENO (PP)-TEREPHTHALATE DE POLIETILENO (PET)-POLIAMIDA (PA)-POLIETILENO (PE)-ACIDO POLILACTICO (PLA)-BIODEGRADABLES- PUEDE SER DE UNA FIBRA O DE COMBINACION DE ESTAS DOS FIBRAS-CARACTERISTICAS- GRAMAJE 30 gr- ALTA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA- ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y DE COLOR-RESITENTE A LA ABRASION-NO GENERA PELUSA-RESISTENTE AL CALOR-BAJA FLAMABILIDADA-NO TOXICA-ANTIALERGICA-RESISTENTE A AGRESIONES BIOLOGICAS- HIDROFILICA E HIDROFOBICA-PRESENTACION- ROLLO DE 70 cm X 100 m
2504034	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TELA ANTIFLUIDOS PARA BIOMBO 126 cm X 130 cm	TELA ANTIFLUIDOS (POLIESTER) PARA BIOMBO 126 cm X 130 cm-IMPERMEABLE A SUSTANCIAS TOXICAS-CORROSIVAS-HIPOCLORITO-SANGRE Y FACTORES AMBIENTALES-REPELE LIQUIDOS-MANCHAS-FACILITANDO SU LIMPIEZA-RESISTENTE A LA TENSION Y AL RASGADO- DE GRAN DURABILIDAD
2504103	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA PARA EMBALAJE/AMORTAJAR DE CADAVER- EN TELA BOMLAM/POLIPROPILENO- CON TIRAS EN LAS PUNTAS Y EN EL	SABANA PARA EMBALAJE/AMORTAJAR DE CADAVER- EN TELA BOMLAMP/POLIPROPILENO-CON TIRAS EN LAS PUNTAS Y EN EL CENTRO PARA AMARRE-RESISTENTE-USO- HOSPITALARIO PARA EMBALAJE DE CADAVERES- NO REQUIERE REGISTRO INVIMA

							CENTRO PARA AMARRE	
2504271	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA QUIRURGICA 2 m LARGO X 1.60 m ANCHO EN TELA DE ALGODON TIPO DRIL	SABANA QUIRURGICA DE 2 m X 1.60 m-EN MATERIAL NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD EN ALGODON TIPO DRIL- NO REFLEJA LA LUZ- PERMEABLE AL VAPOR- NO PRODUCE PELUSA- NI MOTAS- DURABLE SIN REMIENDOS- NI HILOS SUELTOS QUE PUEDAN ENTRAR EN LA HERIDA Y QUEDARSE EN ELLA- PERMITE LA PENETRACION UNIFORME DEL VAPOR
2504273	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	FUNDA DE MAYO 1.10 m LARGO X 70 cm DE ANCHO EN TELA DE ALGODON TIPO DRIL	FUNDA DE MAYO DE 1.10 m X 70 cm EN MATERIAL NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD EN ALGODON-NO REFLEJA LA LUZ- PERMEABLE AL VAPOR- NO PRODUCE PELUSA- NI MOTAS- DURABLE- SIN REMIENDOS- NI HILOS SUELTOS QUE PUEDAN ENTRAR EN LA HERIDA Y QUEDARSE EN ELLA-PERMITE LA PENETRACION UNIFORME DEL VAPOR
2504277	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA PARA PACIENTE 1.50 m X 2 m EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL	SABANA PARA PACIENTE DE 1.50 m X 2 m EN TELA DE ALGODON TIPO DRILL-NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD-NO REFLEJA LA LUZ-PERMEABLE AL VAPOR- NO PRODUCE PELUSA- NI MOTAS- DURABLE SIN REMIENDOS- NI HILOS SUELTOS QUE PUEDAN ENTRAR EN LA HERIDA Y QUEDARSE EN ELLA- PERMITE LA PENETRACION UNIFORME DEL VAPOR
2504285	42131700	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA AJUSTABLE 2.70 m DE LARGO X 1.10 m DE ANCHO EN TELA GENERO (50% ALGODON+50% POLIESTER) PARA CAMILLA	SABANA AJUSTABLE DE 2.70 m X 1.10 M-CON ELASTICO EN TODO SU ALREDEDOR-EN TELA GENERO-DE MATERIAL NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD EN ALGODON-PERDURABLE A MULTIPLES LAVADAS- LINEAS DE COSTURA REFORZADAS SIN AÑADIDOS- REMIENDOS- NI HILOS SUELTOS QUE PUEDAN ENTRAR EN LA HERIDA
2504290	52120000	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	TOALLA PACIENTE USO HOSPITALARIO	TOALLA 100% TEJIDO HOTELERO CON O SIN LOGO DE 400 A 1000g- TEJIDO A DOBLE NUDO-TAMAÑO TIPO PLAYERA-COLOR SEGUN INDICACION DE LA INSTITUCION

2504936	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS-MEDIDAS 0.90 m X 2.10 m-PARA ACOMODACION EN CAMILLA	SABANA DESECHABLE RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA)-MEDIDAS- 0.90 m X 2.10 m-EN TELA - RESISTENTE A LA RUPTURA- PERMEABLE AL SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505274	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE PARA CAMILLA 220 cm X 87cm EN TELA SMS 30-35 gr	SABANA DESECHABLE PARA CAMILLA-ANTIFLUIDOS-FABRICADA EN SMS 30-35 grs-IMPERMEABLE -ANTIMICROBIANA- GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE- EXCELENTE ELONGACION- HIPOALERGENICA- MEDIDAS DE 220 cm- X 87 cm-ESQUINAS AJUSTABLES CON ELASTICO – PRESENTACION UNIDAD
2505961	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	RO	A.02.02.01.002.007	TELA NO TEJIDA PARA CAMILLA ROLLO DE 1 m x 100 m	TELA NO TEJIDA PARA CAMILLA ROLLO 1 m x 100 m TELA AZUL EN POLIPROPILENO TELA NO TEJIDA 35 gr-RESPIRABLE-REPELENTE A FLUIDOS-RESISTENTE A LA RUPTURA-HIPOALERGENICA-NO ESTERIL
2582832	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA PLANA 2.40-2.50 m X 2.0-2.20 m-EN TELA SMS- 35 gr-RESISTENTE-REPELENTE A FLUIDOS- NO ESTERIL	SABANA PLANA DESECHABLE DE 2.40 A 2.50 m X 2.0 A 2.20 m-EN TELA SMS 35 gr-RESISTENTE A LA RUPTURA-PERMEABLE ALOS GASES-REPELENTE A LIQUIDOS-NO GUARDA MEMORIA-HIPOALERGENICA-BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE-DESCARTABLE-QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583761	42142106	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	MANTA TERMICA ADULTO PARTE INFERIOR DEL CUERPO-BOQUILLA CON REFORZAMIENTO	MANTA TERMICA ADULTO-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL-MANTA CON CANALES PARA RECIRCULACION DE AIRE-BOQUILLA CON REFORZAMIENTO PARA ANCLAJEDE MAQUINA DE CALENTAMIENTO-COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE LA INSTITUCION
2583762	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA DESECHABLE EN TELA SMS 35 gr PARA CAMILLA 190 cm X 120 cm	SABANA DESECHABLE PARA CAMILLA-MEDIDAS DE 190 cm X 120 cm-ANTIFLUIDOS-ELABORADA EN SMS 30-35 grs-IMPERMEABLE -ANTIMICROBIANA-GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE- EXCELENTE ELONGACION- HIPOALERGENICA-ESQUINAS AJUSTABLES CON ELASTICO – PRESENTACION UNIDAD

2584001	42142106	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	MANTA TERMICA ADULTO PARTE SUPERIOR DEL CUERPO-BOQUILLA CON REFORZAMIENTO	MANTA TERMICA ADULTO-EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL- MANTA CON CANALES PARA RECIRCULACION DE AIRE- BOQUILLA CON REFORZAMIENTO PARA ANCLAJE DE MAQUINA DE CALENTAMIENTO- COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE LA INSTITUCION
2587042	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA RESORTADA PARA CAMILLA 72 cm x 2.0 m-EN TELA SMS 35 gr	SABANA DESECHABLE PARA PACIENTE-MEDIDAS-78 cm x 2 m-RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA)- EN TELA SMS 35 gr- RESISTENTE A LA RUPTURA- PERMEABLE A LOS GASES- REPELENTE A LIQUIDOS- NO GUARDA MEMORIA- HIPOALERGENICA- BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE- DESCARTABLE- QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION-COLOR AZUL REY
2587043	53103200	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-5	C/U	A.02.02.01.002.007	SABANA RESORTADA PARA CAMILLA 75 cm x 1.40 m-EN TELA SMS 35 gr	SABANA DESECHABLE PARA PACIENTE-MEDIDAS-75 cm x 1.40 m-RESORTADA EN LAS PUNTAS (PARA ACOMODACION EN LA CAMILLA)- EN TELA SMS 35 gr- RESISTENTE A LA RUPTURA- PERMEABLE A LOS GASES- REPELENTE A LIQUIDOS- NO GUARDA MEMORIA- HIPOALERGENICA- BIODEGRADABLE-TERMORRESISTENTE- DESCARTABLE- QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ESTERILIZACION-COLOR ROSADO

PAÑALES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500432	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PARA INCONTINENCIA MODERADA A GRAVE-ADULTO-TALLA L	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL MODERADA A GRAVE-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-CON MATERIAL ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS Y EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION Y REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES Y MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS PARA UN AJUSTE SEGURO-SIN FRAGANCIAS-TRANSPIRABLE PARA REDUCIR IRRITACIONES-DISEÑO ANATOMICO Y BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-TALLA L

2500433	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PARA INCONTINENCIA MODERADA A GRAVE-ADULTO-TALLA M	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL MODERADA A GRAVE-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-CON MATERIAL ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS Y EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION Y REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES Y MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS PARA UN AJUSTE SEGURO-SIN FRAGANCIAS-TRANSPIRABLE PARA REDUCIR IRRITACIONES-DISEÑO ANATOMICO Y BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-TALLA M
2501190	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PARA INCONTINENCIA MODERADA A GRAVE-ADULTO-TALLA S	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL MODERADA A GRAVE-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-CON MATERIAL ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS Y EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION Y REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES Y MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS PARA UN AJUSTE SEGURO-SIN FRAGANCIAS-TRANSPIRABLE PARA REDUCIR IRRITACIONES-DISEÑO ANATOMICO Y BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-TALLA S
2501192	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PACIENTE ADULTO-INCONTINENCIA SEVERA-TALLA L	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA ADULTOS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL SEVERA-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-MATERIAL ALTAMENTE ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS-EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION-REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES-MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS-DISEÑO ANATOMICO-BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-PARA PACIENTES CON PERDIDA TOTAL DEL CONTROL SOBRE LA RETENCION DE ORINA-TALLA L

2501193	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PACIENTE ADULTO-INCONTINENCIA SEVERA-TALLA M	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA ADULTOS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL SEVERA-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-MATERIAL ALTAMENTE ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS-EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION-REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES-MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS-DISEÑO ANATOMICO-BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-PARA PACIENTES CON PERDIDA TOTAL DEL CONTROL SOBRE LA RETENCION DE ORINA-TALLA M
2501194	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA XXG (ETAPA-5)-PESO MAYOR A 14 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA TALLA XXG (E-5) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.
2501197	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA G (ETAPA-3)-PESO DE 8 kg A 12.5 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA TALLA G (E-3) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.

2501210	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA XXXG (ETAPA-6)-PESO MAYOR A 16 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA TALLA XXXG (E-6) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.
2502594	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA P (ETAPA-1)-PESO DE 4 kg A 7 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA TALLA P (E-1) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.
2502595	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA M (ETAPA-2)-PESO DE 6 kg A 9 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA

								TALLA M (E-2) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.
2502596	53102305	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE NIÑO TALLA XG (ETAPA-4)-PESO DE 11 kg A 16 kg	PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑO CON COBERTURA EXTERIOR DE POLIETILENO-TELA NO TEJIDA HIDROFOBICA-TRANSPIRABLE-PARTE INTERNA CON TEJIDO SUAVE HIPOALERGENICO Y ALTAMENTE RESISTENTE FORMADA POR VARIAS CAPAS DE CELULOSA Y/O POLIESTER Y/O POLIACRILATO DE SODIO-DOBLE BARRERA ANTIESCAPES EN LAS PARTES LATERALES-HIPOALERGENICOS-CON ELASTICOS EN LA ZONA DE LAS PIERNAS Y LA CINTURA PARA ASEGURAR UN AJUSTE ADECUADO PARA PREVENIR FUGAS Y RETENER FLUIDOS-FIJACION FRONTAL CON CINTAS ADHESIVAS QUE PERMITA EL AJUSTEAL CUERPO CON UN SISTEMA DE PEGADO Y DESPEGADO-AJUSTE ANATOMICO-SE ACTUALIZA TALLA XG (E-4) SEGUN RESOLUCION 47965 Y NTC 2882.
2502785	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MAYOR TIPO CALZONCILLO-CON INCONTINENCIA SEVERA-TEXTURA SUAVE-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-MATERIAL ALTAMENTE ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS-EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION-REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE QUE PREVIENE FILTRACIONES-CORTE ANATOMICO QUE PERMITEN AJUSTE PERFECTO-BARRERA ANTIESCURRIMIENTO-ELASTICOS EN PIERNAS Y CINTURA
2503118	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PACIENTE ADULTO-INCONTINENCIA SEVERA-TALLA S	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA ADULTOS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL SEVERA-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-MATERIAL ALTAMENTE ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS-EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION-REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES-MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS-DISEÑO ANATOMICO-BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-PARA PACIENTES CON PERDIDA TOTAL DEL CONTROL SOBRE LA RETENCION DE ORINA-TALLA S

2504525	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PACIENTE ADULTO-INCONTINENCIA SEVERA-TALLA XL	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL MODERADA-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-CON MATERIAL ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS Y EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION Y REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES Y MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS PARA UN AJUSTE SEGURO-SIN FRAGANCIAS-TRANSPIRABLE PARA REDUCIR IRRITACIONES-DISEÑO ANATOMICO Y BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-TALLA XL
2504552	53102306	ZMQX	ZMQX-006	ZMQX-006-6	C/U	A.02.02.01.002.007	PAÑAL DESECHABLE PACIENTE ADULTO-INCONTINENCIA SEVERA-TALLA XL	PAÑAL DESECHABLE DISEÑADO PARA ADULTOS MAYORES CON INCONTINENCIA URINARIA O FECAL SEVERA-CAPA SUPERIOR EN TELA TRANSPIRABLE-SUAVE-HIPOALERGENICA-MATERIAL ALTAMENTE ABSORBENTE QUE RETIENE LIQUIDOS-EVITA FUGAS-PERMITE LA VENTILACION-REDUCE IRRITACIONES-CAPA INFERIOR IMPERMEABLE DE MATERIAL LAMINADO QUE PREVIENE FILTRACIONES-MANTIENE LA ROPA SECA-CON CINTAS ADHESIVAS-DISEÑO ANATOMICO-BARRERAS LATERALES ANTIFUGAS-PARA PACIENTES CON PERDIDA TOTAL DEL CONTROL SOBRE LA RETENCION DE ORINA-TALLA XL

MATERIAL DE CURACION - CLINICA DE HERIDAS
APLICADORES - BAJALENGUAS - GASAS

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500118	24122006	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	TUB	APLICADORES CON NITRATO DE PLATA 75%	APLICADORES CON CABEZA EN NITRATO DE PLATA AL 75% Y NITRATO DE POTASIO AL 25%	APLICADORES CON CABEZA EN NITRATO DE PLATA AL 75% Y NITRATO DE POTASIO AL 25%-PUNTA SOLUBLE EN TODAS LAS SECRECIONES
2500148	11122000	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.001	BAJALENGUAS DE MADERA LISO NO ESTERIL	BAJALENGUAS DE MADERA LISO UNIFORME COLOR CRAFT NO ESTERIL ASPECTO LISO-UNIFORME LIBRE DE CUERPOS EXTRAÑOS-PUEDE PRESENTAR VETAS

2500231	9105	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.001	BAJALENGUAS DE MADERA, DE ASPECTO LISO UNIFORME, RESISTENTE	ASPECTO LISO UNIFORME-LIBRE DE CUERPOS EXTRAÑOS-COLOR CRAFF PUEDE PRESENTAR VETAS-INOLORO- RESISTENTE
2502262	42311511	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	RO	A.02.02.01.003.005	GASATIPO HOSPITALARIO 10 cm X 17 X 90 YARDAS-ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 17cmx90 YARDAS- ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON TIPO VII U-S-P- (27 hilos), TEJIDO UNIFORME-EMPAQUEINDIVIDUAL EN ROLLO
2502486	42311511	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	RO	A.02.02.01.003.005	GASATIPO HOSPITALARIO10cmx100 YARDAS-ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 10cmx100 YARDAS- ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U-S-P- (27 hilos), TEJIDO UNIFORME-EMPAQUEINDIVIDUAL EN ROLLO
2502712	42311511	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	RO	A.02.02.01.003.005	GASATIPO HOSPITALARIO 90(36) cmx100 YARDAS-ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 0-90 (36") cmx100 YARDAS- ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN TIPO VII U-S-P- (27 hilos)-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO
2502963	42311511	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	RO	A.02.02.01.003.005	GASATIPO HOSPITALARIO 90x90 YARDAS-ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 0-90cmx90m- ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-TIPO VII U-S-P- (27 hilos)-TEJIDO UNIFORME HOMOGENEO-EMPAQUEINDIVIDUAL EN ROLLO

2503819	42311511	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	RO	A.02.02.01.003.005	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 1 X 100 YARDAS-ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODÓN-EMPAQUE INDIIDUAL EN ROLLO	GASA ABSORBENTE ESTERIL EN ROLLO 1 X 100 YARDAS- ELABORADA CON HILAZA 100% ALGODON TIPO VII U-S-P- (27 hilos), TEJIDO UNIFORME-EMPAQUE INDIVIDUAL EN ROLLO
2505754	11122000	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.006	BAJALENGUA PLASTICO	BAJALENGUA PLASTICO-LIBRE DE BORDES O ARISTAS-LONGITUD 18 CMS-FLEXIBLE Y ACANALADO

APOSITOS - FACTOR DE CRECIMIENTO - MECHA DE ALGINATO

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2503053	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO ANTIMICROBIANO CON HIDROBALANCE +PHMB 9 cm x 9 cm, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ANTIMICROBIANO CON HIDROBALANCE-CON PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA) COMO AGENTE ANTIMICROBIANO- PROPORCIONA HUMEDAD Y/O ABSORBE EL EXCESO DE HUMEDAD-DE FACIL ADAPTACION A LA FORMA Y PROFUNDIDAD DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-EN HERIDAS DE EXUDADO LEVE A MODERADO-EN TODAS LAS ETAPAS DE CURACION DE LA HERIDA-EN HERIDAS INFECTADAS-ULCERAS DE DIRENTES ORIGENES-EMPAQUE INDIVIDUAL
2502688	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO 10 cm X 10 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO FIBRA NATURAL- (PROVENIENTE DE ALGAS MARINAS)-ABSORBENTE PARA HERIDAS EXUDATIVAS DE FORMA MODERADA-MANTIENE LA HUMEDAD-CON ACCION FIBRINOLITICA-REQUIERE APOSITO SECUNDARIO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504107	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO IMPREGNADO DE MIEL ACTIVA LEPTOSPERNUM 10 cm X 13 cm-ESTERIL-	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO IMPREGNADO DE MIEL ACTIVA LEPTOSPERNUM-APOSITO PRIMARIO QUE PROPORCIONA AMBIENTE HUMEDO, pH BAJO PARA MEJORAR LA OXIGENACION DE LOS TEJIDOS-PROMUEVE EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-CONTROL DE OLORES-ESTERIL-USO-HERIDAS MODERADAS A MUY EXUDANTES COMO ULCERAS DIABETICAS-

							EMPAQUE INDIVIDUAL	QUEMADURAS DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504104	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO + PLATA 10cm X 10cm. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO + PLATA EN TEJIDO NO TEJIDO DE FIBRAS DE ALGINATO IMPREGNADO DE PLATA-PROMUEVEN LA CICATRIZACION MANTENIENDO UN AMBIENTE HUMEDO-CONTGROLA EL EXUDADO (DE MODERADO A INTENSO)-AYUDA AL CRECIMIENTO DE TEJIDO NUEVO Y SANO-COMBATE LAS INFECCIONES-ESTERIL-USO-ULCERAS-QUEMADURAS-HERIDAS QUIRURGICAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504108	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO70-90% Y CARBOXIMETIL CELULOSA 10-20% 15 cm X 15 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y CARBOXIMETILCELULOSA ALTAMENTE ABSORBENTE-MANTIENE EL AMBIENTE HUMEDO-SE ADAPTA AL LECHO DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-INDICADO EN LESIONES DE CUALQUIER ETIOLOGIA CON EXUDADO DE MODERADO A ALTO COMO ULCERAS VASCULARES-ULCERAS POR PRESION-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500133	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO BACTERICIDA A BASE DE PLATA Y CARBON ACTIVADO 19X10.5cm	APOSITO PRIMARIO BACTERICIDA LOCAL, COMPUESTO POR UNA MALLA TERMOSELLADA DE CARBON ACTIVADO PURO IMPREGNADO CON PLATA METALICA-REDUCE LA CARGA BACTERIANA-ESTERIL-USO-LIMPIEADE LA HERIDA-PREVENCION Y TRATAMIENTO LOCAL DE LA HERIDA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501191	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO BACTERICIDA A BASE DE PLATA Y CARBON ACTIVADO 10.5X10.5cm	APOSITO PRIMARIO BACTERICIDA LOCAL, COMPUESTO POR UNA MALLA TERMOSELLADA DE CARBON ACTIVADO PURO IMPREGNADO CON PLATA METALICA-REDUCE LA CARGA BACTERIANA-ESTERIL-USO-LIMPIEADE LA HERIDA-PREVENCION Y TRATAMIENTO LOCAL DE LA HERIDA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500145	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA+PLATA 15 X 15 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC) DEL 70% AL 100%+ PLATA AL 1,2%. ALTAMENTE ABSORBENTE-RETENCION DE EXUDADO CON ACCION ANTIBACTERIANA PARA PROTEGER EL LECHO DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-CONTROL BACTERIANO Y MEJORAR EL PROCESO DE CICATRIZACION-EMPAQUE IDIVIDUAL

2503059	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA+PLATA 20 X 30 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC) DEL 70% AL 100%+ PLATA AL 1,2%. ALTAMENTE ABSORBENTE-RETENCION DE EXUDADO CON ACCION ANTIBACTERIANA PARA PROTEGER EL LECHO DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-CONTROL BACTERIANO Y MEJORAR EL PROCESO DE CICATRIZACION-EMPAQUE IDIVIDUAL
2501317	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA+PLATA 10 X 10 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC) DEL 70% AL 100%+ PLATA AL 1,2%. ALTAMENTE ABSORBENTE-RETENCION DE EXUDADO CON ACCION ANTIBACTERIANA PARA PROTEGER EL LECHO DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-CONTROL BACTERIANO Y MEJORAR EL PROCESO DE CICATRIZACION-EMPAQUE IDIVIDUAL
2504140	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA+PLATA 5 X 5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC) DEL 70% AL 100%+ PLATA AL 1,2%. ALTAMENTE ABSORBENTE-RETENCION DE EXUDADO CON ACCION ANTIBACTERIANA PARA PROTEGER EL LECHO DE LA HERIDA-ESTERIL-USO-CONTROL BACTERIANO Y MEJORAR EL PROCESO DE CICATRIZACION-EMPAQUE IDIVIDUAL
2500120	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA 15 X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE ALMOHADILLA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500122	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA 20 X 10 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE ALMOHADILLA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501318	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA 15 X 15 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE ALMOHADILLA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL

2503056	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA EN FORMA DE MECHA 2 X 45 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE MECHA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503057	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA PARA REGION SACRA 20 X 25 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE REGION SACRA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503058	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA 10 X 10 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO NO TEJIDO EN FORMA DE ALMOHADILLA-COMPUESTO DE FIBRAS HIDROCOLOIDES DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA DEL 70 AL 100%, CON DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, HEMOSTATICO-ESTERIL-USO-ULCERAS DE PRESION-DIABETICAS-HERIDAS QUIRURGICAS TRAUMATICAS-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500136	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-GRUESO-10.5 X 10.5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500137	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA DELGADO -9.5 X 9.7 cm-ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-FLEXIBLE-DELGADO-IMPERMEABLE AL AGUA-MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-ESTERIL-USO EN HERIDAS SECAS O LIGERAMENTE EXUDATIVAS-AREAS DE FRICCION Y CONTORNEABLES-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500143	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-GRUESO-20 X 30 cm-ESTERIL-	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL

							EMPAQUE INDIDIVIDUAL	TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500230	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-GRUESO-10 X 10 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501195	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-20 X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503064	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-15 X 15 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503065	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-15 X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503066	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-14 X 14 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL

2503067	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-SACRO-20 X 23 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504139	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-5 X 5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504141	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-4 X 4 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504142	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-12.5 X 12.5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504143	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-17.5 X 17.5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504144	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA +	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-

							GELATINA-19.8 X 14 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504145	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA-20 X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO DE CARBOXIMETIL CELULOSA + GELATINA + PECTINA-CON UN SOPORTE DE ESPUMA A BASE DE POLIURETANO-IMPERMEABLE AL AGUA, MANTIENE LA HUMEDAD EN EL LECHO DE LA HERIDA FAVORECIENDO EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO-NO SE ADHIERE AL TEJIDO-USO-INDICADO PARA ULCERAS Y HERIDSAS CON EXUDADO LEVE A MODERADO-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501314	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA - 12cm X 22cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO POR FIBRAS DE CELULOSA DEL 80% AL 100%-ALTAMENTE ABSORBENTE-DA ENTORNO HUMEDO-FOMENTA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y SE ADAPTA AL LECHO DE LA HERIDA-ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD-USO-PARA HERIDAS CON EXUDADO MODERADO. ABSORBE FLUIDOS-FAVIL DE USAR Y RETIRAR-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501315	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA -19 cm X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO POR FIBRAS DE CELULOSA DEL 80% AL 100%-ALTAMENTE ABSORBENTE-DA ENTORNO HUMEDO-FOMENTA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y SE ADAPTA AL LECHO DE LA HERIDA-ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD-USO-PARA HERIDAS CON EXUDADO MODERADO. ABSORBE FLUIDOS-FAVIL DE USAR Y RETIRAR-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2500135	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO A BASE DE COLAGENO + ALGINATO CALCIO DE 10 X 11.1cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO POR FIBRAS DE COLAGENO 70% A 100% Y ALGINATO DE CALCIO 5 A 15%. - APOSITO NO ADHERENTE-FAVORECE LA GRANULACION-EPITELIZACION DE LAS HERIDAS Y EL CONTROL DEL EXUDADO-CON PROPIEDADES HEMOSTATICAS-ESTERIL-INDICADO EN LESIONES POR PRESION-ULCERAS VENOSAS-QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO-CIERRES POR SEGUNDA INTENCION-ENTRE OTRAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501316	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO A BASE DE COLAGENO + ALGINATO CALCIO DE 10.2 X 22.2cm-ESTERIL-	APOSITO COMPUESTO POR FIBRAS DE COLAGENO 70% A 100% Y ALGINATO DE CALCIO 5 A 15%. - APOSITO NO ADHERENTE-FAVORECE LA GRANULACION-EPITELIZACION DE LAS HERIDAS Y EL CONTROL DEL EXUDADO-CON PROPIEDADES HEMOSTATICAS-ESTERIL-INDICADO EN LESIONES POR PRESION-ULCERAS VENOSAS-QUEMADURAS

							EMPAQUE INDIVIDUAL	DE SEGUNDO GRADO-CIERRES POR SEGUNDA INTENCION-ENTRE OTRAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503055	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO EN FORMA DE MECHA A BASE DE COLAGENO+ALGINATO-1 cm X 1x40 cm, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO EN FORMA DE MECHA-COMPUESTO POR FIBRAS DE COLAGENO 70% A 100% Y ALGINATO DE CALCIO 5 A 15%. -APOSITO NO ADHERENTE-FAVORECE LA GRANULACION-EPITELIZACION DE LAS HERIDAS Y EL CONTROL DEL EXUDADO-CON PROPIEDADES HEMOSTATICAS-ESTERIL-INDICADO EN LESIONES POR PRESION-ULCERAS VENOSAS-QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO-CIERRES POR SEGUNDA INTENCION-ENTRE OTRAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503633	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO CON ACETATO DE CELULOSA + PETROLATO 76 cm X 76 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO PRIMARIO NO ADHERENTE-COMPUESTO POR MALLA DE ACETATO DE CELULOSA IMPREGNADO CON EMULSION DE PETROLATO PARA PROTEGER LA HERIDA-PREVENIR LA ADHESION DEL APOSITO SECUNDARIO-NO SE PEGA A LA HERIDA-MINIZA EL DOLOR AL RETIRARSE-PROTEGE EL TEJIDO DE GRANULACION-ESTERIL-USO-PARA HERIDAS CON EXUDADO BAJO O ELEVADO-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503062	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO HIDROPOLIMERO ABSORBENTE 11 cm X 11 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	LOS APOSITOS HIDROPOLIMEROS (DE CURACION AVANZADA) SON ESPUMAS QUE ABORBEN EL EXCESO DE EXUDADO-IMPERMEABLES A LOS LIQUIDOS-MANTIENEN UN AMBIENTE HUMEDO-OCLUSIVOS-USO-HERIDAS EXUDATIVAS-ESTERIL-HERIDAS TRAUMATICAS Y QUIRURGICAS-QUEMADURAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503063	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO HIDROPOLIMERO ABSORBENTE 15 cm X 20 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	LOS APOSITOS HIDROPOLIMEROS (DE CURACION AVANZADA) SON ESPUMAS QUE ABORBEN EL EXCESO DE EXUDADO-IMPERMEABLES A LOS LIQUIDOS-MANTIENEN UN AMBIENTE HUMEDO-OCLUSIVOS-USO-HERIDAS EXUDATIVAS-ESTERIL-HERIDAS TRAUMATICAS Y QUIRURGICAS-QUEMADURAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503068	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO HIDROPOLIMERO ABSORBENTE 7 cm X 9 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	LOS APOSITOS HIDROPOLIMEROS (DE CURACION AVANZADA) SON ESPUMAS QUE ABORBEN EL EXCESO DE EXUDADO-IMPERMEABLES A LOS LIQUIDOS-MANTIENEN UN AMBIENTE HUMEDO-OCLUSIVOS-USO-HERIDAS EXUDATIVAS-ESTERIL-HERIDAS TRAUMATICAS Y QUIRURGICAS-QUEMADURAS-EMPAQUE INDIVIDUAL

2500139	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO IMPREGNADO ANTIMICROBIANO, TRITICUM VULGARE 15% 10X10 cm-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO ESTERIL IMPREGNADO ANTIMICROBIANO TRITICUM VULGARE 10-17%-QUE MEJORA LOS PROCESOS REPARATIVOS CELULARES-AUMENTO DE LA SINTESIS PROTEICA-ACCION BACTERIOSTATICA QUE REDUCE LA APARICION DE INFECCIONES Y ES COADYUDANTE DE LA TERAPEUTICA ANTIMICROBIANA-ESTERIL-USO-QUEMADURAS-ULCERAS POR PRESION-ETC-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501174	42311524	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO IMPREGNADO DE PETROLATO 10 cm X 10 cm-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO DE MALLA (DE MATERIALES COMO GASA, ACETATO DE CELULOSA O POLESTER) IMPREGNADO DE EMULSION DE PETROLATO O VASELINA-NO ADHERENTE-MANTIENE UN AMBIENTE HUMEDO QUE PROMUEVE LA CICATRIZACION-ESTERIL-USO-PROTEGER LAS HERIDAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501214	42311524	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO IMPREGNADO DE PETROLATO 7.6 cm X 20 cm-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO DE MALLA (DE MATERIALES COMO GASA, ACETATO DE CELULOSA O POLESTER) IMPREGNADO DE EMULSION DE PETROLATO O VASELINA-NO ADHERENTE-MANTIENE UN AMBIENTE HUMEDO QUE PROMUEVE LA CICATRIZACION-ESTERIL-USO-PROTEGER LAS HERIDAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503061	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO DE MATRIZ MODULADORA DE PROTEASA 123 cm2-ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO COMPUESTO POR UNA MATRIZ CON UNA COMBINACION PERFECTAMENTE EQUILIBRADA DE COLAGENO-CELULOSA OXIDASA REGENERADA Y PLATA-PREVIENE LA INFECCION MIENTRAS PROMUEVE EL CRECIMIENTO CELULAR-REDUCE LOS NIVELES DE LAS PROTEASAS INFLAMATORIAS PARA AYUDAR A LA CICATRIZACION-PERMTE RETIRADA ATRAUMATICA-USO-EN HERIDAS POCO EXUDATIVAS-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501113	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN SPRAY (PULVERIZACION) IMPERMEABLE AL AGUA-ESTERIL-FRASCO X 100ML	PELICULA TRANSPARENTE-PULVERIZADA DE POLIURETANO IMPERMEABLE Y TRANSPARENTE-FORMA UNA PELICULA PARA PROTEGER LAS HERIDAS-RESISTENTE AL AGUA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE HUMEDAD-A PRUEBA DE BACTERIAS-ESTERIL-FRASCO X 100 ml
2501159	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 10 X10 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-

							EMPAQUE INDIVIDUAL	SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501173	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 9 cm X 10.5 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501189	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 20 cm X 30 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501196	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 10 cm X 25 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2501215	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 8.5 cm X 10.5 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503054	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 6 cm X 7 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504146	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 10 cm X 12 cm-IMPERMEABLE-	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-

							ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2587229	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO TRANSPARENTE EN LAMINA 15 cm X 20 cm-IMPERMEABLE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO TRANSPARENTE-SEMIOCLUSIVO DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO Y/O POLIACRILATO-EXTENSIBLE Y ADAPTABLE-IMPERMEABLE AL AGUA-A LOS FLUIDOS CORPORALES Y A LA HUMEDAD-ESTERIL-USO-PROTEGER HERIDAS-QUEMADURAS MENORES-SITIOS DE INSERCION DE CATETERES-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503096	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO POLIURETARANO + MEMBRANA HIDROFILICA 17 cm X 19 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO POLIURETANO SEMIPERMEABLE QUE FACILITA INTERCAMBIO DE HUMEDAD Y OXIGENO+MEMBRANA HIDROFILICA + LIMPIADOR + HUMECTANTE + ABSORBENTE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2503097	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO POLIURETARANO + MEMBRANA HIDROFILICA 5 cm X 8 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO POLIURETANO SEMIPERMEABLE QUE FACILITA INTERCAMBIO DE HUMEDAD Y OXIGENO+MEMBRANA HIDROFILICA + LIMPIADOR + HUMECTANTE + ABSORBENTE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504109	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO POLIURETARANO + MEMBRANA HIDROFILICA 15 cm X 15 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL	APOSITO POLIURETANO SEMIPERMEABLE QUE FACILITA INTERCAMBIO DE HUMEDAD Y OXIGENO+MEMBRANA HIDROFILICA + LIMPIADOR + HUMECTANTE + ABSORBENTE-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504105	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO CON POLIMEROS SUPER ABSORBENTE 10 cm X 12,5 cm-ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL.	APOSITO CON POLIMEROS (POLIPROPILENO-CELULOSA-POLIACRILATO DE SOSIO) SUPER ABSORBENTE PARA MANEJO DE ALTO EXUDADOS Y RETENCION DE EXUDADOS DE HERIDAS-ESTERIL-USOS-HERIDAS SUPERFICIALES-ULCERAS DE PIE DIABETICO-ULCERAS VENOSAS-QUEMADURAS-EMPAQUE INDIVIDUAL
2504106	42311522	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-1	C/U	A.02.02.01.003.005	APOSITO CON POLIMEROS SUPER ABSORBENTE 15 cm X 22,5 cm-	APOSITO CON POLIMEROS (POLIPROPILENO-CELULOSA-POLIACRILATO DE SOSIO) SUPER ABSORBENTE PARA MANEJO DE ALTO EXUDADOS Y RETENCION DE EXUDADOS DE HERIDAS-ESTERIL-USOS-HERIDAS SUPERFICIALES-

							ESTERIL-EMPAQUE INDIVIDUAL.	ULCERAS DE PIE DIABETICO-ULCERAS VENOSAS-QUEMADURAS-EMPAQUE INDIVIDUAL

BASES O BARRERAS PROTECTORAS - BOLSAS- OSTOMIAS Y OTROS

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501321	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA LISA PROTECTORA PIEL 20 cm X20 cm	COMPUESTA DE SUSTANCIAS HIDROCOLOIDES, LAMINA PROTECTORA DE PIEL EFECTOASTRINGENTE DURABILIDAD MAYOR DE TRES DIAS FACIL REMOCION PTACION ANATOMICA CON AJUSTE PERFECTO
2501322	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA LISA PROTECTORA PIEL 10 cm X10 cm	COMPUESTA DE SUSTANCIAS HIDROCOLOIDES, LAMINA PROTECTORA DE PIEL EFECTOASTRINGENTE DURABILIDAD MAYOR DE TRES DIAS FACIL REMOCION PTACION ANATOMICA CON AJUSTE PERFECTO
2501323	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL 100% HIDROCOLOIDE N° 57	BASE O BARRERA COMPUESTA POR HIDROCOLOIDE EN EL 100% DE SU DIAMETRO-(GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO) Y ADHESI ADHESIONDE SECO A HUMEDO, ADAPTACION ANATOMICA CON AJUSTE PERFECTO A LOSCONTOR-NOS DE LA PIEL SIN PRODUCIR MOLESTIA O INCOMODIDA CILREMOCION, DURACION SUPERIOR A 7 DIAS, CUBIERTA DE POLIETILENO QUEPROLONGUE SU USO Y -LA HAGA RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALEFE CTOASTRINGENTE. PROTECTOR DE PIEL, REGENERADOR DE TEJIDOS LESIONADOS. QUENO SE DESINTEGRE
2501324	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL 70mm	APOSITO COMPUESTO POR HIDROCOLOIDE 100% GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, CON EFECTO ASTRINGENTE, PROTECTOR DE D EL EGENERADOR DEL TEJIDO LESIONADO. ADHESION DE SECO A HUMEDO. REGENERADORDEL TEJIDO LESIONADO. ADHESION DE SECO A HUMEDO ADAPO N ANATOMICACON AJUSTE PERFECTO. FACIL REMOSION. QUE NO SE DESINTEGRE, DURACIONMAYOR A 7 DIAS. QUE NO PIERDA SU FORMA. CON CUBAD E POLIETILENO QUEROLONGUE SU USO Y LA HAGA RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES

2501325	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL X 45 mm	APOSITO COMPUESTO POR HIDROCOLOIDE 100% GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, CON EFECTO ASTRINGENTE, PROTECTOR DE D EL EGENERADOR DEL TEJIDO LESIONADO. ADHESION DE SECO A HUMEDO. REGENERADORDEL TEJIDO LESIONADO. ADHESION DE SECO A HUMEDO. ADAPO N ANATOMICACON AJUSTE PERFECTO. FACIL REMOSION. QUE NO SE DESINTEGRE, DURACIONMAYOR A 7 DIAS. QUE NO PIERDA SU FORMA. CON CUBAD E POLIETILENO QUEROLONGUE SU USO Y LA HAGA RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES
2501326	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL 32mm	COMPUESTA DE SUSTANCIAS HIDROCOLOIDES PROTECTOR DE PIEL EFECTO ASTRINGENTE REPARACION DE TEJIDO LESIONADO ADAPTACION ANATOMICA C JUSTE PERFECTO DURACION MAYO A 5 DIAS
2504314	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE SPRAY 50ml	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE-PROTECTOR DE PIEL, BARRERA TRANSPIRABLE QUE PROTEGE LA PIEL DEL DAÑO CAUSADO POR LOS ADHESIVOS, DES S DEL CUERPO Y LA FRICCION. COMPOSICION: DISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADA. CARACTERISTICAS: POR EVAPORACION DU NA BARRERA DE LA PIEL DE RESINA DE SILICONA DE ALTO PESO MOLECULAR, BARRERA PROTECTORA IMPERMEABLE, SECADO RAPIDO, NO IRRITANTIP OALERGENICA, NO GRASOSA. USOS: BARRERA CUTANEA, PROTECCION DE PIEL. PRESENTACION: FRASCO SPRAY POR 50ml
2504661	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA DE PIEL CON COLLAR HIDROCOLOIDE FLEXIBLE 70mm	BARRERAS MOLDEABLES PROTECTORAS DE PIEL CON COLLAR HIDROCOLOIDE FLEXIBLE. BARRERAS PLANA CONSTITUIDAS POR UN ANILLO DE SOPORTE O Y DELGADO, EL CUAL ES ADHERIDO A UN DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA STOMAHESIN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA DURAHESIVE® EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLL DISCO ADHESIVO TIENE UNA PELÍCULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARREST ÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. ADICIONALMENTE, CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVOABA

2504662	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA DE PIEL CON COLLAR HIDROCOLOIDE FLEXIBLE 57 mm	BARRERAS MOLDEABLES PROTECTORAS DE PIEL CON COLLAR HIDROCOLOIDE FLEXIBLE. BARRERAS PLANA CONSTITUIDAS POR UN ANILLO DE SOPORTE O Y DELGADO, EL CUAL ES ADHERIDO A UN DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA STOMAHESIN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA DURAHESIVE® EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLL DISCO ADHESIVO TIENE UNA PELÍCULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARREST ÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. ADICIONALMENTE, CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVOABA
2504872	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL X 38 mm	BASE O BARRERA PROTECTORA PIEL X 38 mm APOSITO COMPUESTO POR HIDROCOLOIDE 100% GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODION EFECTO ASTRINGENTE, PROTECTOR DE PIEL
2583792	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL 60mm, HIDROCOLIDE 100&	BASE O BARRERA COMPUESTA POR HIDROCOLOIDE EN EL 100% DE SU DIAMETRO (GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO) Y ADHESI ADHESION DE SECO A HUMEDO, ADAPTACION ANATOMICA CON AJUSTE PERFECTO A LOS CONTORNOS DE LA PIEL SIN PRODUCIR MOLESTIA O INCOMODIDAD FACIL REMOCION, DURACION SUPERIOR A 7 DIAS, CUBIERTA DE POLIETILENO QUE PROLONGUE SU USO Y LA HAGA RESISTENTE A FLUIDOS CORPOR.E F ECTO ASTRINGENTE. PROTECTOR - DE PIEL, REGENERADOR DEL TEJIDO LESIONADO, QUE NO SE DESINTEGRE
2587424	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA CUTANEA PLANA ARFO FLOT 70mm	CÓDIGO 14604, COLOR AZUL, MED ARO 70mm, RECORTABLE HASTA 13 A57mm BARRERA CUTANEA PLANA MARCO ADHESIVO PARA ESTOMAS PLANOS O RETOS ARO FLOTANTE DORSO ELASTAFLEX ENSAMBLE HERMÉTICO CPL RQ 5000116497
2587425	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA PROTECTORA PIEL 45mm	BARRERA PROTECTORA DE PIEL CON ABERTURA PRECORTADA Y COLLAR DE CINTA BLANCA (DIMENSIONES GRLES 4.5 PULG * 4.5 PULG) RQ 500011649

2587548	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.004	BARRERA CUTANEA UROSTOMIA EXTER BAS 45mm	BARRERA CUTANEA UROSTOMIA EXTER BAS 45mm Expediente Sanitario 20210935 Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0024229 INDICACIONES: PASAR EN LA PIEL ALREDEDOR DE LOS ESTOMAS Y LAS HERIDAS. USO PREVISTO: PROTECCIÓN DE LA PIEL FRENTE A LOS DAÑOS ASOCIADOS A LOS DEOS CORPORALES, ENZIMAS Y ADHESIVOS. RQ:5000135175
2501327	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE COLOSTOMIA 57mm	BOLSA PLASTICA RESISTENTE A FUGAS, SISTEMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, ACOPLE PERFECTO, SELLADO HERMETI URACION SUPERIOR A OCHO DIAS, PLASTICO TRANSPARENTE, CORRUGABLE, HIPOALERGENICA, CONARO INCORPORADO PARA AJUSTARLO A LA BARRERA RECTORA DE LA PIEL DE ESTE NUMERO
2501328	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE COLOSTOMIA 70mm	BOLSA PLASTICA RESISTENTE A FUGAS, SISTEMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, ACOPLE PERFECTO, SELLADO HERMETI URACION SUPERIOR A OCHO DIAS, PLASTICO CORRUGABLE HIPOALERGENICA.
2501329	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE COLOSTOMIA 45mm, PARA BARRERA PROTECTORA DE 45 mm	BOLSA PLASTICA RESISTENTE A FUGAS, SISTEMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, ACOPLE PERFECTO, SELLADO HERMETI URACION SUPERIOR A OCHO DIAS, PLASTICO CORRUGABLE HIPOALERGENICA. CON AROINCORPORADOPARA AJUSTAR AL ARO DE LA BARRERA
2501330	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE COLOSTOMIA 32mm	BOLSA PLASTICA RESISTENTE A FUGAS, SISTEMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, ACOPLE PERFECTO, SELLADO HERMETI URACION SUPERIOR A OCHO DIAS, PLASTICO CORRUGABLE HIPOALERGENICA.
2501331	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE OSTOMIA 1 PIEZA ADULTO	BOLSA ELABORADA EN PLASTICO TRANSPARENTE Y BARRERA EN HIDROCOLOIDE, ADAPTACION ANATOMICA, MULTIMEDIDAS, ADHESIVOS DE SECO A HUMEDO, EMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, CORRUGABLE DE ALTA RESISTENCIA, SELLADO HERMETICO.DURACION >5DIAS
2501332	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE OSTOMIA 1 PIEZA PEDIATRICA	BOLSA ELABORADA EN PLASTICO TRANSPARENTE Y BARRERA EN HIDROCOLOIDE, ADAPTACION ANATOMICA, MULTIMEDIDAS, ADHESIVOS DE SECO A HUMEDO, EMA DE DRENAJE, DE FACIL MANIPULACION CON CLIP DE SEGURIDAD, CORRUGABLE DE ALTA RESISTENCIA, SELLADO HERMETICO.DURACION >5DIAS

2502587	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA PARA GASTROSTOMIA	BOLSA PARA GASTROSTOMIA EN PLASTICO GRADO MEDICO-DESECHABLE-CON UN PUERTO DE DOSIFICACION DE DOS PIEZAS-UN CUERPO DE BOLSA-UN CATETER.UN REGULADOR-UN CONECTOR-TAPA PROTECTORA-USO-ALIMENTACION ENTREAL POR SONDA NASOGASTRICA O POR GASTROSTOMIA-EMPAQUE INDIVIDUAL
2583793	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 mm DE PLASTICO RESISTENTE A FUGAS	BOLSA PLASTICA RESISTENTE A FUGAS, SISTEMA DE DRENAJE DE FACIL MANIPULACION, CON CLIP DE SEGURIDAD, ACOPLE PERFECTO, HIPOALERGEN PLASTICO CORRUGABLE, DE ALTA RESISTENCIA, SELLADO HERMETICO, DURACION SUPERIOR A 7 DIAS
2587410	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSA DRENABLE 100mm	BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS ABIERTA EN SU PARTE DISTAL, PROTEGIDA EN SU CARA POSTERIOR POR UN PANEL PLASTICO PROTECTOR. PRESENTN BOLSA: 10mm C/U RQ. 5000110318
2587411	42231504	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-4	C/U	A.02.02.01.003.006	BARRERA PROTECTORA PIEL 100cm	BASE O BARRERA PROTECTORA PIEL X 100CM APOSITO COMPUESTO POR HIDROCOLOIDE: CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PECTINA, GELATINA Y POLBUTIENO.QUE ABSORBE HUMEDAD Y TIENE CAPACIDAD DE REGENERAR PIEL IRRITADA. RQ.5000110318

CINTAS - DISPENSADOR - PELICULAS PROTECTORAS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2504026	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA-COLOR BLANCO-PRESENTACION EN ROLLO DE 1/2" (PULGADA) X 5 YARDAS (4.57 m)	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOSORA-RESPIRABLE-NO OCLUSIVA-COMPUESTO POR UNA PELICULA DE TELA NO TEJIDA RECUBIERTA EN UNA DE SUS CARAS CON ADHESIVO HIPOALERGENICO SENSIBLE A PRESION, EXCENTO DE LATEX. LA TELA NO TEJIDA EN POLIESTER SIRVE DE SOPORTE Y ES DE COLOR BLANCO-USO-SOPORTE DE PEQUEÑAS HERIDAS QUE NO ESTEN ABIERTAS Y SIN DRENAJE-FIJACION DE APOSITOS-VENDAJES-PARA PIELES DELICADAS
2583794	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA-COLOR PIEL-PRESENTACION EN ROLLO DE 1"	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOSORA-RESPIRABLE-NO OCLUSIVA-COMPUESTO POR UNA PELICULA DE TELA NO TEJIDA RECUBIERTA EN UNA DE SUS CARAS CON ADHESIVO HIPOALERGENICO SENSIBLE A PRESION, EXCENTO DE LATEX. LA TELA NO TEJIDA

							(PULGADA) X 10 YARDAS (9.1 m)	EN POLIESTER SIRVE DE SOPORTE Y ES DE COLOR PIEL-USO-SOPORTE DE PEQUEÑAS HERIDAS QUE NO ESTEN ABIERTAS Y SIN DRENAJE-FIJACION DE APOSITOS-VENDAJES-PARA PIELES DELICADAS
2500239	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA-COLOR PIEL-PRESENTACION EN ROLLO DE 2" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9. 1 m)	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOSORA-RESPIRABLE-NO OCLUSIVA-COMPUESTO POR UNA PELICULA DE TELA NO TEJIDA RECUBIERTA EN UNA DE SUS CARAS CON ADHESIVO HIPOALERGENICO SENSIBLE A PRESION, EXCENTO DE LATEX. LA TELA NO TEJIDA EN POLIESTER SIRVE DE SOPORTE Y ES DE COLOR PIEL-USO-SOPORTE DE PEQUEÑAS HERIDAS QUE NO ESTEN ABIERTAS Y SIN DRENAJE-FIJACION DE APOSITOS-VENDAJES-PARA PIELES DELICADAS
2500240	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA-COLOR BLANCO-PRESENTACION EN ROLLO DE 2" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9. 1 m)	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA MICROPOSORA-RESPIRABLE-NO OCLUSIVA-COMPUESTO POR UNA PELICULA DE TELA NO TEJIDA RECUBIERTA EN UNA DE SUS CARAS CON ADHESIVO HIPOALERGENICO SENSIBLE A PRESION, EXCENTO DE LATEX. LA TELA NO TEJIDA EN POLIESTER SIRVE DE SOPORTE Y ES DE COLOR BLANCO-USO-SOPORTE DE PEQUEÑAS HERIDAS QUE NO ESTEN ABIERTAS Y SIN DRENAJE-FIJACION DE APOSITOS-VENDAJES-PARA PIELES DELICADAS
2500619	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 10 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS

2500620	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 5 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS
2500879	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 15 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS
2503203	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER TRANSPARENTE-EXTENSIBLE. NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 15 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER-EXTENSIBLE-TRANSPARENTE NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS
2503204	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER TRANSPARENTE-EXTENSIBLE. NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 10 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER-EXTENSIBLE-TRANSPARENTE NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS

2503205	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER TRANSPARENTE-EXTENSIBLE. NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-PRESENTACION EN ROLLO DE 5 cm X 10 m	CINTA ADHESIVA DE POLIESTER-EXTENSIBLE-TRANSPARENTE NO TEJIDO MAS ADHESIVO HIPOALERGENICO-CON FIBRA POROSA Y PERMEABLE-EN FORMA DE MALLA-ELASTICA CON ALTA TOLERANCIA CUTANEA-PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA-LIBRE DE LATEX-SE ADHIERE A LA PIEL DE FORMA FLEXIBLE Y SE MANTIENE FIRME Y SEGURO-USO-FIJACION DE APOSITOS EN AREAS GRANDES ESPECIALMENTE EN ARTICULACIONES TAMBIEN PARA FIJACION DE TUBOS-CATETERES-SONDAS Y OTROS
2503080	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIETILENO-PRESENTACION EN ROLLO 2" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9.1 m)	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIETILENO PERFORADO-CON UN LADO ADHESIVO HIPOALERGENICO Y TRANSPIRABLE, DE FACIL RASGADO EN DOS DIRECCIONES-CON BUENA ADHESION A LA PIEL-USO-INDICADA PARA FIJACION DE APOSITOS-SUJECION DE TUBOS-SONDAS-EXTENSIONES DE EQUIPOS
2502260	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIETILENO-PRESENTACION EN ROLLO 1" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9.1 m)	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIETILENO PERFORADO-CON UN LADO ADHESIVO HIPOALERGENICO Y TRANSPIRABLE, DE FACIL RASGADO EN DOS DIRECCIONES-CON BUENA ADHESION A LA PIEL-USO-INDICADA PARA FIJACION DE APOSITOS-SUJECION DE TUBOS-SONDAS-EXTENSIONES DE EQUIPOS
2500254	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO PRESENTACION EN ROLLO 2" (PULGADAS) X 5 YARDAS (4.57 m)	CINTA DE TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO-COMPUESTA POR SOPORTE DE TELA DE RAYON CON ADHESIVO HIPOALERGENICO EXENTO DE LATEX POR UNA SOLA CARA TIPO CAUCHO- TRANSPIRABLE RESISTENTE A LA HUMEDAD DE FACIL--RASGADO EN AMBOS SENTIDOS-ALTA ADHERENCIA-TRANSPIRABLE-FLEXIBLE-APLICACIONES- USADO COMO MATERIAL AUXILIAR EN PROCESOS DE CURACION-FIJACION DE CANULAS-SONDAS-CATETERES-PRESENTACION EN ROLLO

2500255	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	RO	A.02.02.01.003.006	CINTA TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO PRESENTACION EN ROLLO 3" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9.1 m)	CINTA DE TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO-COMPUESTA POR SOPORTE DE TELA DE RAYON CON ADHESIVO HIPOALERGENICO EXENTO DE LATEX POR UNA SOLA CARA TIPO CAUCHO- TRANSPIRABLE RESISTENTE A LA HUMEDAD DE FACIL--RASGADO EN AMBOS SENTIDOS-ALTA ADHERENCIA-TRANSPIRABLE-FLEXIBLE-APLICACIONES- USADO COMO MATERIAL AUXILIAR EN PROCESOS DE CURACION-FIJACION DE CANULAS-SONDAS-CATETERES-PRESENTACION EN ROLLO
2502261	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	CINTA TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO PRESENTACION EN ROLLO 2" (PULGADAS) X 10 YARDAS (9.1 m)	CINTA DE TELA QUIRURGICA ADHESIVA DE COLOR BLANCO-COMPUESTA POR SOPORTE DE TELA DE RAYON CON ADHESIVO HIPOALERGENICO EXENTO DE LATEX POR UNA SOLA CARA TIPO CAUCHO- TRANSPIRABLE RESISTENTE A LA HUMEDAD DE FACIL--RASGADO EN AMBOS SENTIDOS-ALTA ADHERENCIA-TRANSPIRABLE-FLEXIBLE-APLICACIONES- USADO COMO MATERIAL AUXILIAR EN PROCESOS DE CURACION-FIJACION DE CANULAS-SONDAS-CATETERES-PRESENTACION EN ROLLO
2503713	31201636	ZMQX	ZMQX-007	ZMQX-007-5	C/U	A.02.02.01.003.006	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA AUTOADHESIVA DE 1, DE MATERIAL PLASTICO	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA AUTOADHESIVA DE 1"-DE MARCO PLASTICO Y CUCHILLA RETRACTIL-FUNCIONA CON UN RODILLO DE CAUCHO NATURAL-COMPACTO Y ERGONOMICO

MATERIAL DE IMAGENOLOGÍA
CASSETES - CHASIS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2503657	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS DIGITALIZAD VITA CR 14 X 17	CASSETTE-CHASIS DIGITALIZADOR DIRECTVIEW VITA CR TAMAÑO 14 X 17". DE ALTO RENDIMIENTO, IMÁGENES DE GRAN LONGITUD CON APLICACIONES ORTOPÉDICAS Y PEDIÁTRICAS ENTRE OTRAS
2503658	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS DIGITALIZAD VITA CR 8 X10	CASSETTE-CHASIS DIGITALIZADOR DIRECTVIEW VITA CR TAMAÑO 8 X 10". DE ALTO RENDIMIENTO, IMÁGENES DE GRAN LONGITUD CON APLICACIONES ORTOPÉDICAS Y PEDIÁTRICAS ENTRE OTRAS

2504333	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS DIGITALIZADOR FIRE CR 14 X 17	CASSETTE-CHASIS DIGITALIZADOR FIRE CR 14 X 17". CARACTERÍSTICAS: RESOLUCIÓN 100UM/200UM. CAPTURA DE DATOS 16-BITS POR PIXEL 65.000 T ONOS DE GRIS. MANUAL EN ESPAÑOL.
2505502	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS PARA IP CR 14" X 14" TIPO CC	CASSETE-CHASIS PARA IP CR14"X14" TIPO CC PARA USO CON LECTORES FUJI FCR LOS CASETES FUJIFILM CR ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS MÁS COMUNES, ASÍ COMO EN LONGITUDES EXTENDIDAS PARA EXÁMENES DE PIERNAS LARGAS Y ESCOLIOSIS. LOS CASETES TIENEN UN DISEÑO LIVIANO Y RESISTENTE PARA ALOJAR Y PROTEGER DE MANERA SEGURA LAS AVANZADAS PLACAS DE IMÁGENES FLEXIBLES DE FUJI. LOS CASETES Y LAS IP SE VENDEN POR SEPARADO. FUJI 14× 14" CASSETTE – TYPE CC, 800019002 – OLD PART # XCASS-14X14CC
2505503	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS PARA IP CR 10" X 12" TIPO CC	CASSETE-CHASIS PARA IP CR10"X12" TIPO CC PARA USO CON LECTORES FUJI FCR LOS CASETES FUJIFILM CR ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS MÁS COMUNES, ASÍ COMO EN LONGITUDES EXTENDIDAS PARA EXÁMENES DE PIERNAS LARGAS Y ESCOLIOSIS. LOS CASETES TIENEN UN DISEÑO LIVIANO Y RESISTENTE PARA ALOJAR Y PROTEGER DE MANERA SEGURA LAS AVANZADAS PLACAS DE IMÁGENES FLEXIBLES DE FUJI. LOS CASETES Y LAS IP SE VENDEN POR SEPARADO. FUJI 10× 12" CASSETTE – TYPE CC, 800019003 – OLD PART # XCASS-10X12CC
2505504	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS PARA IP CR 15 X 30cm TIPO CC	CASSETE-CHASIS PARA IP CR15X30cm TIPO CC PARA USO CON LECTORES FUJI FCR LOS CASETES FUJIFILM CR ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS MÁS COMUNES, ASÍ COMO EN LONGITUDES EXTENDIDAS PARA EXÁMENES DE PIERNAS LARGAS Y ESCOLIOSIS. LOS CASETES TIENEN UN DISEÑO LIVIANO Y RESISTENTE PARA ALOJAR Y PROTEGER DE MANERA SEGURA LAS AVANZADAS PLACAS DE IMÁGENES FLEXIBLES DE FUJI. LOS CASETES Y LAS IP SE VENDEN POR SEPARADO. FUJI 15× 30cm CASSETTE – TYPE CC, 15677420 – OLD PART #XCASS-15X30-CC
2505505	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS PARA IP CR 18 X 24cm TIPO CC	CASSETE-CHASIS PARA IP CR18X24cm TIPO CC PARA USO CON LECTORES FUJI FCR LOS CASETES FUJIFILM CR ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS MAS COMUNES, ASÍ COMO EN LONGITUDES EXTENDIDAS PARA EXÁMENES DE PIERNAS LARGAS Y ESCOLIOSIS. LOS CASETES TIENEN UN DISEÑO LIVIANO Y RESISTENTE PARA

								ALOJAR Y PROTEGER DE MANERA SEGURA LAS AVANZADAS PLACAS DE IMÁGENES FLEXIBLES DE FUJI. LOS CASETES Y LAS IP SE VENDEN POR SEPARADO. FUJI 18× 24cm CASSETTE – TYPE CC, 15779058 – OLD PART # XCASS-18X24-CH
2505506	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-01	C/U	A.02.02.01.004.008	CASSETE-CHASIS PARA IP CR 24 X 30cm TIPO CC	CASSETE-CHASIS PARA IP CR24X30cm TIPO CC PARA USO CON LECTORES FUJI FCR LOS CASETES FUJIFILM CR ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS MAS COMUNES, ASÍ COMO EN LONGITUDES EXTENDIDAS PARA EXÁMENES DE PIERNAS LARGAS Y ESCOLIOSIS. LOS CASETES TIENEN UN DISEÑO LIVIANO Y RESISTENTE PARA ALOJAR Y PROTEGER DE MANERA SEGURA LAS AVANZADAS PLACAS DE IMÁGENES FLEXIBLES DE FUJI. LOS CASETES Y LAS IP SE VENDEN POR SEPARADO. FUJI 24× 30cm CASSETTE – TYPE CC, 800019005 – OLD PART # XCASS-24X30CC

CASSETES - CHALECO - CUELLO - DELANTAL - GUANTES, ANTEOJOS- PLOMADOS

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2584554	42204009	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	ANTEOJOS PLOMADOS OPERARIO RX	ANTEOJOS PLOMADOS: ESTRUCTURA LIGERA. PLÁSTICO DE ESPESOR EQUIVALENTE MÍNIMO 0.2 MM HASTA 0.7 MM DE PLOMO. CAPA ANTIRREFLEJO. PROTECTORES LATERALES SUPERIOR E INFERIOR. ADAPTACIÓN COMPLETA A LA CARA. BANDAS ELÁSTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA
2500261	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	CHALECO PLOMADO PROTECCIÓN RX PEDIATRICO	CHALECO PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RX. REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNÉS CON CIERRE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE, CON PROTECCIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE A 0.3 MM Y 0.5 MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. FÁCIL DE LIMPIAR
2503338	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	CHALECO PLOMADO PROTECCIÓN RX ADULTO	CHALECO PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RX. REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNÉS CON CIERRE CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE, CON PROTECCIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO EN EL FRENTE Y 03 MM DE PLOMO EN LA PARTE DE ATRÁS, TAMAÑO MEDIANO 52 cm DE LARGO X 62 cm DE ANCHO. FÁCIL DE LIMPIAR. ADULTO TALLA M

2500830	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	CUELLO PLOMADO PROTECCIÓN RX ESTÁNDAR	CUELLO DE PLOMO PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIROIDES DURANTE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES. CONSTA DE MATERIAL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, LAVABLE. CON ESPESOR EQUIVALENTE DESDE MÍNIMO 0.3 MM HASTA 0.5 MM DE PLOMO, CON CINTA CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE PARA SUJETARSE. DIFERENTES TALLAS
2584560	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A-02-02-01-003-006	CUELLO PLOMADO PROTECCIÓN RX PEDIÁTRICO	CUELLO DE PLOMO PARA LA PROTECCIÓN DE LA TIROIDES DURANTE LA EXPOSICIÓN A EMANACIONES IONIZANTES. CONSTA DE MATERIAL DE NYLON REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS. CON ESPESOR EQUIVALENTE MÍNIMO 0.3 MM HASTA 0.5 MM DE PLOMO, CON CINTA CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE PARA SUJETARSE. PEDIÁTRICA LONGITUD MÍNIMA DE 48cm, ANCHO ESTÁNDAR.
2504649	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	DELANTAL DE PLOMO CON CUELLO PEDIÁTRICO	SE CREA MATERIAL DE ACUERDO CON RQ: 7000182200 DELANTAL DE PLOMO CON CUELLO PEDIÁTRICO, FABRICADO EN NYLON DIAMOND RIPSTOP/CAUCHO PLOMADO, CONTORNO CON RIBETE DE POLIÉSTER, CINTA ADHESIVA CON BANDA ELÁSTICA SOBRE LA ESPALDA QUE SE ABROCHA EN LA CADERA. SEGÚN LA NORMA DIN 61331-3. TALLAJE PARA NIÑO
2584561	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A-02-02-01-003-006	DELANTAL PLOMADO ESTÁNDAR ADULTO Y PEDIÁTRICO	DELANTAL DE PLOMO ADULTO Y PEDIÁTRICO TIPO ESTÁNDAR, CON EQUIVALENCIA A PLOMO DESDE MÍNIMO 0,3 MM HASTA 0.5 MM, FABRICADO EN MATERIAL ANTIFLUIDO DE ALTA CALIDAD, CINTA ADHESIVA CON BANDA ELÁSTICA SOBRE LA ESPALDA QUE SE ABROCHA EN LA CADERA.
2583784	42204005	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	GUANTES PLOMADOS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	GUANTES PLOMADOS CON PROTECCIÓN COMPLETA (EQUIVALENCIA DE 0.5 DE PB, DE FÁCIL LIMPIEZA, INSTALACIÓN Y RETIRO, FLEXIBLES, ADAPTABLE AL A ANATOMÍA DEL USUARIO, QUE NO SE FISUREN AUN EN TRABAJOS EXIGENTES. EN DIFERENTES COLORES
2500831	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	PROTECTOR PLOMADO GÓNADAS ADULTO RX	PROTECTOR UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GÓNADAS CONTRA LA RADIACIÓN IONIZANTE. ELABORADO CON MATERIAL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, LAVABLE. CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO. CON CINTA CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE PARA SUJETARSE Y/O BROCHE

2500832	42204002	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-02	C/U	A.02.02.01.004.008	PROTECTOR PLOMADO GÓNADAS PEDIÁTRICO RX	PROTECTOR UTILIZADO PARA PROTEGER LOS OVARIOS CONTRA LA RADIACIÓN IONIZANTE. ELABORADO CON MATERIAL REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS, LAVABLE. CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO. CON CINTA CIERRES DE CONTACTO DE GANCHO Y BUCLE PARA SUJETARSE

FIJADORES - REMOVEDORES

Código Genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Subgrupo de Artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2505143		ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	KIT	A.02.02.01.003.005	DESARROLLADOR/FIJADOR PELÍCULAS RAYOS X	CONCENTRADO QUÍMICO LÍQUIDO PARA PROCESOS MANUAL DE TODAS LAS PELÍCULAS INTRAORALES Y EXTRAORALES KIT CONSTA DE: 1 BOTELLA DE DESARROLLADOR Y REPARADOR GBX Y 1 BOTELLA DE REPARADOR Y REPARADOR REVELADOR Y FIJADOR. CADA BOTELLA DE 1L PARA PREPARAR 5L DE REVELADOR O FIJADOR.
2500834	42203708	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	FCO	A.02.02.01.003.005	FIJADOR AUTOMÁTICO CARGA	FIJADOR MANUAL RX LIQUIDO AMARILLO, OLOR A VINAGRE, HIDROSOLUBLE, NO INFLAMABLE
2500256	42203708	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	GLN	A.02.02.01.003.005	FIJADOR RAYOS X GALÓN	SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PROCESO DE REVELADO AUTOMÁTICO DE PELÍCULA DRX
2500110	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	FCO	A.02.02.01.003.005	LIQ. REVELADOR RADIOGRÁFICO FRASCO X 500 ml	SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO Y PROCESADO MANUAL FOTOGRÁFICO DE PELÍCULA PROFESIONAL DE RAYOS-X. LIQUIDO INCOLORO, INODORO, ESTABLE. ETIQUE TADOCON FRASES DE RIESGO
2500147	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	FCO	A.02.02.01.003.005	LIQ. REVELADOR RADIOGRÁFICO FRASCO X 2000 ml	SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO Y PROCESADO MANUAL FOTOGRÁFICO DE PELÍCULA PROFESIONAL DE RAYOS-X. LIQUIDO INCOLORO, INODORO, ESTABLE. ETIQUE TADOCON FRASES DE RIESGO
2500833	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	FCO	A.02.02.01.003.005	REVELADOR AUTOMÁTICO CARGA	REVELADOR MANUAL RX LIQUIDO AMARILLO, INOLORO, SOLUBLE EN AGUA (SUSTANCIA REDUCTORA: HIDROQUINONA O ÁLCALIS: CARBONATO POTÁSICO E HI DIÓXIDO SÓDICO, RETARDADORES: BROMURO POTÁSICO, CONSERVANTE: SULFITO SÓDICO)
2501059	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-03	C/U	A.02.02.01.003.005	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA CARGA	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA CARGAS PARA PREPARAR 10 GALONES

KIT DE LIMPIEZA RODILLOS - LIMPIADOR DE PANTALLA								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2503593		ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-04	C/U	A.02.02.01.003.005	KIT LIMPIEZA RODILLOS DIGITALIZA VITA CR	KIT DE LIMPIEZA PARA RODILLOS DE DIGITALIZADOR VITA CR. REF: 34665
2504310		ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-04	C/U	A.02.02.01.003.005	LIMPIADOR DE PANTALLA TOALLITA TARR 50 U	TOALLITA LIMPIADORA DE PANTALLA HUMEDECIDA: HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA MANTENER LAS PANTALLAS Y CASSETES DE LIBRES DE POLVO Y SUCI EDAD ESTÁN PREHUMEDECIDAS CON LIMPIADOR DE PANTALLA. LIBRES DE PELUSA. PRESENTACIÓN CONTENEDOR O TARRO DE 50 UNIDADES. REF: TL 5280 094. N° OTAN 6525-01-537- 6401
PANTALLA DE FOSFORO - PELICULAS								
Código Genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de Artículos**	**Subgrupo de Artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2504012	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A.02.02.01.003.005	PANTALLA DE FOSFORO FLEXIBLE 10 X 12	PANTALLA DE FOSFOR FLEXIBLE 10 X 12" (24 X 30cm) PARA SISTEMAS GP Y ACR Y EQUIPO DE RX LASER IMAGAGIM FILM DRYVIEW CARESTREAM HTTP:/ /WWW.CARESTREAM.ES/DIRECTVIEW-CR-AND-ACR-CASSETTES.HTML
2504013	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A.02.02.01.003.005	PANTALLA DE FOSFORO FLEXIBLE 11 X 14	PANTALLA DE FOSFOR FLEXIBLE 11 X 14" (28 X 35cm) PARA SISTEMAS GP Y ACR Y EQUIPO DE RX LASER IMAGAGIM FILM DRYVIEW CARESTREAM HTTP:/ /WWW.CARESTREAM.ES/DIRECTVIEW-CR-AND-ACR-SCREENS.HTML HTTP://WWW.CARESTREAM.ES/DIRECTVIEW-CR-AND-ACR-CASSETTES.HTML
2504014	42203700	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A.02.02.01.003.005	PANTALLA DE FOSFORO FLEXIBLE 14 X 17	PANTALLA DE FOSFOR FLEXIBLE 14 X 17" (35 X 43cm) PARA SISTEMAS GP Y ACR Y EQUIPO DE RX LASER IMAGAGIM FILM DRYVIEW CARESTREAM HTTP:/ /WWW.CARESTREAM.ES/DIRECTVIEW-CR-AND-ACR-CASSETTES.HTML
2500252	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PERIAPICAL PEDÍA ESTÁNDAR N° 1	PELÍCULA A BASE ACETATO DE CELULOSA, CUBIERTA POR AMBOS LADOS DE UNA GELATINA IMPREGNADA DE CRISTALES DE HALURO DE PLATA O DE BROMO RO DE PLATA, VELOCIDAD RÁPIDA. PARA UTILIZAR EN NIÑOS

2500258	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PERIAPICAL ADULTO N° 1 (15/16)	PELÍCULA A BASE ACETATO DE CELULOSA, CUBIERTA POR AMBOS LADOS DE UNA GELATINA IMPREGNADA DE CRISTALES DE HALURO DE PLATA O DE BROMURO DE PLATA, VELOCIDAD RÁPIDA. TAMAÑO 1 = 2.4 X 4.0cm
2501061	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX ORTOCROMÁTICA 11 X 14	PELÍCULA SUPER HRU, RX CONVENCIONAL DE USO GENERAL. ORTOCROMÁTICA, CON DOBLE EMULSIÓN (SENSIBLE AL VERDE), DE ALTA RESOLUCIÓN
2501062	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX ORTOCROMÁTICA 14 X 14	PELÍCULA SUPER HRU, RX CONVENCIONAL DE USO GENERAL. ORTOCROMÁTICA, CON DOBLE EMULSIÓN (SENSIBLE AL VERDE), DE ALTA RESOLUCIÓN
2501063	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX ORTOCROMÁTICA 14 X17	PELÍCULA SUPER HRU, RX CONVENCIONAL DE USO GENERAL. ORTOCROMÁTICA, CON DOBLE EMULSIÓN (SENSIBLE AL VERDE), DE ALTA RESOLUCIÓN
2501064	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA ORTOCROMÁTICA 8 X10	PELÍCULA SUPER HRU, RX CONVENCIONAL DE USO GENERAL. ORTOCROMÁTICA, CON DOBLE EMULSIÓN (SENSIBLE AL VERDE), DE ALTA RESOLUCIÓN
2501066	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA SUPER-RX 10 X 12	PELÍCULA SUPER-RX DE USO GENERAL, CON DOBLE EMULSIÓN, SENSIBLE AL AZUL, QUE POSEE UN RANGO TOTAL ADECUADO PARA TODO TIPO DE APLICACIONES
2501070	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA SUPER UMMCA 24 X 30	PELÍCULA SUPER-RX DE USO GENERAL, CON DOBLE EMULSIÓN, SENSIBLE AL AZUL, QUE POSEE UN RANGO TOTAL ADECUADO PARA TODO TIPO DE APLICACIONES
2501087	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA OCLUSAL PARA ODONTOLOGÍA	PELÍCULA OCLUSAL PARA ODONTOLOGÍA
2501088	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PANOREX 15 X 30	PELÍCULA PANOREX 15 X 30
2501089	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DRY STAR DT 2B 14 X 17 PARA IMP	PELÍCULA DRY STAR DT 2B 14 X 17 PARA IMPRESORA LÁSER AGFA
2502372	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA MAMOGRAFÍA HDRC 14 X 17	PELÍCULA MAMOGRAFÍA HDRC 14 X 17 cm. DE ALTA RESOLUCIÓN
2502469	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DE RX DI-HL 8 X 10	PELÍCULA DI-HL, LASER-SECA PARA CR (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA), RM (RESONANCIA MAGNÉTICA) Y TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA). CON BASE DE PELÍCULA DIFERENTE A LA HÚMEDA, TONO MÁS AZULADO, NO DEJA RESIDUOS NI MALOS OLORES

2502470	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DE RX DI-HL 14 X 17	PELÍCULA DI-HL, LASER-SECA PARA CR (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA), RMN (RESONANCIA MAGNÉTICA) Y TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA). CON BASE DE PELÍCULA DIFERENTE A LA HÚMEDA, TONO MÁS AZULADO, NO DEJA RESIDUOS NI MALOS OLORES
2502694	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PANORÁMICA LASER DI-HT 8 X 10	PELÍCULA PANORÁMICA LASER EN SECO DI-HT 8X10" PARA IMPRESORA DRYPIXLATE, 2000
2503366	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5950 8 X 10	PELÍCULA RADIOGRAFICA LASER DRYVIEW, EN BASE DE POLIÉSTER AZUL O TRANSPARENTE, DE CARGA PARA LUZ DIURNA. IMÁGENES IMPRESAS EN PELÍCULA CON UN DMAX ESTÁNDAR, 3.1 DMAX-BASE AZUL Y/O 3.0 DMAX-BASE TRANSPARENTE DE 7 ml. TECNOLOGÍA LÁSER, 508 PIXELES LASER POR PULGADA, ESPACIADO DE CODIGOTO LASER DE 50 MICRAS. ARQUITECTURA DE PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 14 B. APLICACIONES: ONCOLOGÍA, MAMOGRAFÍA, PEDIATRÍA, ETC. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA TODA LA VIDA. TAMAÑO: 20 X 25 cm, 8X10" PULGADAS.
2503367	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5950 10 X 12	PELÍCULA RADIOGRAFICA LASER DRYVIEW, EN BASE DE POLIÉSTER AZUL O TRANSPARENTE, DE CARGA PARA LUZ DIURNA. IMÁGENES IMPRESAS EN PELÍCULA CON UN DMAX ESTÁNDAR, 3.1 DMAX-BASE AZUL Y/O 3.0 DMAX-BASE TRANSPARENTE DE 7 MIL. TECNOLOGÍA LÁSER, 508 PIXELES LASER POR PULGADA, ESPACIADO DE CODIGOTO LASER DE 50 MICRAS. ARQUITECTURA DE PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 14 B. APLICACIONES: ONCOLOGÍA, MAMOGRAFÍA, PEDIATRÍA, ETC. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA TODA LA VIDA. TAMAÑO: 25 X 30cm, 10 X 12" PULGADAS.
2503368	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5950 11 X 14	PELÍCULA RADIOGRAFICA LASER DRYVIEW, EN BASE DE POLIÉSTER AZUL O TRANSPARENTE, DE CARGA PARA LUZ DIURNA. IMÁGENES IMPRESAS EN PELÍCULA CON UN DMAX ESTÁNDAR, 3.1 DMAX-BASE AZUL Y/O 3.0 DMAX-BASE TRANSPARENTE DE 7 MIL. TECNOLOGÍA LÁSER, 508 PIXELES LASER POR PULGADA, ESPACIADO DE CODIGOTO LASER DE 50 MICRAS. ARQUITECTURA DE PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 14 B. APLICACIONES: ONCOLOGÍA, MAMOGRAFÍA, PEDIATRÍA, ETC. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA TODA LA VIDA. TAMAÑO: 28 X 35 cm, 11 X 14" PULGADAS.

2503369	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5950 14 X 17	PELÍCULA RADIOGRÁFICA LASER DRYVIEW, EN BASE DE POLIÉSTER AZUL O TRANSPARENTE, DE CARGA PARA LUZ DIURNA. IMÁGENES IMPRESAS EN PELÍCULA CON UN DMAX ESTÁNDAR, 3.1 DMAX-BASE AZUL Y/O 3.0 DMAX-BASE TRANSPARENTE DE 7 MIL. TECNOLOGÍA LÁSER, 508 PIXELES LASER POR PULGADA, ESPACIADO DE CODIGOTO LASER DE 50 MICRAS. ARQUITECTURA DE PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 14 B. APLICACIONES: ONCOLOGÍA, MAMOGRAFÍA, PEDIATRÍA, ETC. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA TODA LA VIDA. TAMAÑO: 28 X 35cm, 14 X17" PULGADAS.
2503525	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PROCESAMIENTO EN SECO SDQ 10X12	PELÍCULA PARA IMÁGENES MÉDICAS DE PROCESAMIENTO EN SECO, PARA CR/MODALIDAD SD-Q, CON TECNOLOGÍA ANTIHALO PARA IMÁGENES MÁS NÍTIDAS Y CLARAS. PARA IMPRESORA KONICA DRY PRO-MODELO 873. EMPAQUE LUZ/DÍA, CAJA POR 125 HOJAS
2503526	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PROCESAMIENTO EN SECO SDQ 8X10	PELÍCULA PARA IMÁGENES MÉDICAS DE PROCESAMIENTO EN SECO, PARA CR/MODALIDAD SD-Q, CON TECNOLOGÍA ANTIHALO PARA IMÁGENES MÁS NÍTIDAS Y CLARAS. PARA IMPRESORA KONICA DRY PRO-MODELO 873. EMPAQUE LUZ/DÍA, CAJA POR 125 HOJAS
2503527	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PROCESAMIENTO EN SECO SDQ 14X17	PELÍCULA PARA IMÁGENES MÉDICAS DE PROCESAMIENTO EN SECO, PARA CR/MODALIDAD SD-Q, CON TECNOLOGÍA ANTIHALO PARA IMÁGENES MÁS NÍTIDAS Y CLARAS. PARA IMPRESORA KONICA DRY PRO-MODELO 873. EMPAQUE LUZ/DÍA, CAJA POR 125 HOJAS
2503528	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA PROCESAMIENTO EN SECO SDQ 14X14	PELÍCULA PARA IMÁGENES MÉDICAS DE PROCESAMIENTO EN SECO, PARA CR/MODALIDAD SD-Q, CON TECNOLOGÍA ANTIHALO PARA IMÁGENES MÁS NÍTIDAS Y CLARAS. PARA IMPRESORA KONICA DRY PRO-MODELO 873. EMPAQUE LUZ/DÍA, CAJA POR 125 HOJAS
2503653	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DIGITAL DT2 BLANCO/NEGRO 14 X 17	PELÍCULA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO, SEGUNDA GENERACIÓN, CON PROCESADO EN SECO DE ELEVADO RENDIMIENTO, ALTO CONTRASTE, ALTA VELOCIDAD Y DENSIDAD. COMPATIBLE CON IMPRESORAS DRYSTAR 5503, DRYSTAR 5500, DRYSTAR 5300, DRYSTAR 5302 Y DRYSTAR AXYS
2503654	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5850 14 X 17	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS CSH DRY VIEW PARA IMPRESORA DIGITAL DV 5850 14 X 17"

2503655	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX LASER DRYVIEW 5850 8 X 10	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS CSH DRY VIEW PARA IMPRESORA DIGITAL DV 5850 8 X 10"
2505156	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DE RX DI-HL 14 X 17	PELÍCULA DI-HL, LASER-SECA PARA CR (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA), RM (RESONANCIA MAGNÉTICA) Y TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA). CON BASE DE PELÍCULA DIFERENTE A LA HÚMEDA, TONO MÁS AZULADO, NO DEJA RESIDUOS NI MALOS OLORES
2505574	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX DT2B B/N 12" X 14" (28 X 35cm)	PELÍCULA RX DT2B B/N 11"X14" (30 X 35 cm) PELÍCULA DE PROCESAMIENTO EN SECO PARA LA IMPRESIÓN DIGITAL DIRECTA DE IMÁGENES REF. EKL7H
2505575	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX DT2B B/N 8"X10" (20 X 25cm)	PELÍCULA RX DT2B B/N 8"X10" (20 X 25 cm) PELÍCULA DE PROCESAMIENTO EN SECO PARA LA IMPRESIÓN DIGITAL DIRECTA DE IMÁGENES REF. EKL38
2583772	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX ORTOCROMÁTICA 10 X 12	PELÍCULA ORTOCROMÁTICA PARA RADIOLOGÍA DE CONTRASTE. IDEAL PARA RADIOGRAFÍA GENERAL ORTOCROMÁTICA, CON DOBLE EMULSIÓN (SENSIBLE ALV ERDE), DE ALTA RESOLUCIÓN. TAMAÑO 10X12". CAJA X 100 UNIDADES
2583775	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA TÉRMICA AZUL UPT-510BL 8 X 10	PELÍCULA TÉRMICA AZUL PARA REPRODUCTORES DE IMÁGENES DE PELÍCULA SECA UP-DF550 Y UP-DF750. CAJA X 125 UNIDADES
2583776	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA TÉRMICA AZUL UPT-517BL 14 X 17	PELÍCULA TÉRMICA AZUL PARA REPRODUCTORES DE IMÁGENES DE PELÍCULA SECAUP- DF500, UP-DF550 Y UP-DF750. CAJA X 125 UNIDADES
2584002	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA LASER SISTEMA SECO 14 X 14	PELÍCULA LASER DE PROCESAMIENTO EN SECO. DE IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS, CON ALTO VALOR DE DENSIDAD MÁXIMA Y UN CONTRASTE OPTIMO. EMPAQUE LUZ DÍA EN LA CAJA X 125 UNIDADES
2584547	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX PARA REVELADO EN SECO 10 X 12	PELÍCULA LASER DE PROCESAMIENTO EN SECO. DE IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS, CON ALTO VALOR DE DENSIDAD MÁXIMA Y UN CONTRASTE OPTIMO. EMPAQUE LUZ DÍA

2584548	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX PARA REVELADO EN SECO 8 X 10	PELÍCULA LASER DE PROCESAMIENTO EN SECO. DE IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS, CON ALTO VALOR DE DENSIDAD MÁXIMA Y UN CONTRASTE OPTIMO. EMPAQUE LUZ DÍA
2584549	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA RX PARA REVELADO EN SECO 14 X 17	PELÍCULA LASER DE PROCESAMIENTO EN SECO. DE IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS, CON ALTO VALOR DE DENSIDAD MÁXIMA Y UN CONTRASTE OPTIMO. EMPAQUE LUZ DÍA
2584550	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DRY VIEW 8 X 10 IMPRESORA 5800	PELÍCULA DRY VIEW 8 X 10 IMPRESORA 5800
2584551	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DRY VIEW 10 X 12 IMPRESORA 5800	PELÍCULA DRY VIEW 10 X 12 IMPRESORA 5800
2584552	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PELÍCULA DRY VIEW 14 X 17 IMPRESORA 5800	PELÍCULA DRY VIEW 14 X 17 IMPRESORA 5800
2505652	42203803	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-06	C/U	A-02-02-01-003-006	PLACA RADIOGRÁFICA DE FOSFORO TAMAÑO NO0	SE UTILIZAN PARA CAPTURAR IMÁGENES DE DIENTES Y BOCA A TRAVÉS DE UNA RADIACIÓN, COMUNMENTE DE RAYOS X. ESTE TIPO DE RAYOS SON UNA FORMA DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, INVISIBLE Y DE UNA POTENCIA SUFICIENTE COMO PARA ATRAVESAR CUERPOS OPACOS Y DEJAR UNA IMPRESIÓN SOBRE UNA PELÍCULA FOTOGRAFICA. AL REALIZAR UNA RADIOGRAFÍA DENTAL SE PODRÁN APRECIAR DISTINTOS ELEMENTOS; LOS OBJETOS DENSOS, TALES COMO OBTURACIONES, AMALGAMAS O RESTAURACIONES DE METAL BLOQUEAN LOS FOTONES DE LA RADIACIÓN Y APARECERÁN DE COLOR BLANCO EN LA PELÍCULA; LAS ZONAS DONDE NO HAY NADA O SOLAMENTE AIRE SE VERÁN DE COLOR NEGRO, MIENTRAS QUE LAS ESTRUCTURAS OSEAS, COMO LOS DIENTES, Y DEMÁS TEJIDOS O LÍQUIDOS APARECERÁN DE UN COLOR GRIS. DIMENSIONES :2 X 3 cm, 2 UNIDADES

VARIOS - CAJA ACRILICA - OTROS								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2500109	42204003	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-07	C/U	A-02-02-01-003-006	CAJA ACRÍLICA REVELADO DE PLACAS DE RX	CAJA ACRÍLICA CON TAPA: PARA REVELADO MANUAL DE RX INTRAORALES Y PERIAPICALES. QUE NO PERMITA EL PASO DE LA LUZ, PERO QUE FACILITE VISUALIZAR EL PROCESO DE REVELADO EN SU INTERIOR POR PARTE DEL OPERADOR. BANDEJA INTERIOR CON 3 RECIPIENTES (REVELADOR, AGUA Y FIJADOR) INTERNOS SEPARADOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA
2504534	42201841	ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-07	C/U	A.02-02.01.003.002	PAPEL BLANCO BRILLANTE IMPRESIÓN DX 11 X 17	PAPEL BLANCO BRILLANTE IMPRESIÓN DX11X17
2583774		ZMQX	ZMQX-009	ZMQX-009-07	C/U	A.02-02.01.003.002	PAQUETE IMPRESIÓN A COLOR UPC-21S	PAQUETE IMPRESIÓN A COLOR UPC-21S, FORMATO PEQUEÑO, PARA APLICACIONES DE ENDOSCOPIA Y ULTRASONIDO. PARA IMPRESORAS UP-20, UP-21MD, U P-D25MD, UP-D23MD, UP-25MD Y UP-D21. TAMAÑO DEL PAPEL 100X90 MM, 240 HOJAS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN, 3 RODILLOS DE CINTA TINTADA, PAQUETE DE 6 UNIDADES
MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO COAGULACION								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502391	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION PT AUTOMATIZADO	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA EN PLASMA. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501266	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINAR PT LECTURA MANUAL	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) EN PLASMA. LECTURA MANUAL

2502611	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINAR PT. SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) EN PLASMA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2501265	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINAR PTT LECTURA MANUAL	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO PARCIAL DETROMBOPLASTINA (PTT) ACTIVADA EN PLASMA, PARA LECTURA MANUAL
2501441	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINAR PTT SEMIAUTOMATIZAD	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (PTT) ACTIVADA EN PLASMA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA
2502392	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-01	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACION PTT AUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA TIEMPO PARCIAL TROMBOPLASTINA ACTIVADA EN PLASMA. P. AUTOMATIZADA

COLORANTES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501633	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	ACIDO SULFOSALICILICO X 500ml	ÁCIDO SULFOSALICILICO X 500ml
2501836	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	ALCOHOL ACIDO DE ZIELH NEELSEN X 500ml	ALCOHOL ACIDO DE ZIELH NEELSEN X 500ml OFERTAR TODOS LOS COLORANTES DE ZIELH NEELSEN DE LA MISMA MARCA.
2502169	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	BUFFER GIORDANO SOLUCIÓN TAMPÓN PARA COLORACIÓN DE HEMATOLOGÍA	BUFFER GIORDANO FRASCO X 1000 SOLUCION TAMPON PARA COLORACION DE HEMATOLOGIA
2502225	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORACIÓN DE GRAM CRISTAL	COLORACIÓN DE GRAM CRISTAL VIOLETA/VIOLETA GENCIANA AL 0.68%, EN SOLUCIÓN SEGÚN GRAM. UTILIZADA PARA EL

							VIOLETA/VIOLETA GENCIANA AL 0.68%, EN SOLUCIÓN SEGÚN GRAM. FRASCO POR 500ml	DIAGNÓSTICO CELULAR EN LA ME. X 500ml OFERTAR TODOS LOS COLORANTES GRAM DE LA MISMA MARCA.
2501610	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTES PARA TINCIÓN DE GRAM CRISTAL VIOLETA X 200 ml	COLORACIÓN DE GRAM CRISTAL VIOLETA/VIOLETA GENCIANA AL 0.68%, EN SOLUCIÓN SEGÚN GRAM. FRASCO POR 200 ml. OFERTAR TODOS LOS COLORANTES DE GRAM DE LA MISMA MARCA
2503925	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTES DE GIEMSA POR 100ml PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS	LA SOLUCIÓN DE GIEMSA SE UTILIZA EN LA TINCIÓN DE FROTIS DE SANGRE O EXTENDIDOS DE MEDULA ÓSEA, PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. COLORANTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS. PRESENTACIÓN: FRASCO POR 100ml
2502168	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORACIÓN DE FIELD A 200ml COLORANTES PARA GOTA GRUESA (HEMOPARÁSITOS)	COLORACIÓN DE GOTA GRUESA (HEMOPARÁSITOS) QUE CONSTA DE FRASCO DE FIELD A, FRASCO DE AZUL DE METILENO FOSFATADO Y FRASCO DE SALES FOSFATADA
2505978	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE AZUL DE METILENO X 50ml AZUR A R A Y AGUA PARA COLORACIÓN DE GOTAS GRUESAS.	COLORACIÓN FIELD A FRASCO X 50ml SE UTILIZA COMO COLORANTES BÁSICOS, EN LA COLORACIÓN DE GOTA GRUESA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUDISMO, MÉTODO ROMANOWSKY MODIFICADO. FIELD SOLUCIÓN A, OFRECE UNA APROPIADA TINCIÓN QUE PERMITE LA DIFERENCIACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. COMPONENTES: AZUL DE METILENO EXCIPIENTES – PRESENTACIÓN FRASCO EN PEAD POR 50ml
2502451	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORACIÓN DE FIELD B 200ml COLORANTES PARA GOTA GRUESA (HEMOPARÁSITOS)	COLORACIÓN DE GOTA GRUESA (HEMOPARASITOS9 QUE CONSTA DE FRASCO DE FIELD B, FRASCO DE AZUL DE METILENO FOSFATADO Y FRASCO DE SALES FOSFATADA. OFERTAR TODOS LOS COLORANTES DE LA MISMA MARCA.

2505979	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE EOSINA AMARILLENTE R.A, HIDROGENO FOSFATO DISODIO, DIHIDRÓGENO FOSFATO DE POTASIO Y AGUA PARA COLORACIÓN DE GOTAS GRUESAS.	COLORACIÓN FIELD B FRASCO X 50ml FIELD SOLUCIÓN B SE UTILIZA COMO COLORANTES ÁCIDOS, EN LA COLORACIÓN DE GOTA GRUESA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUDISMO, MÉTODO ROMANOWSKY MODIFICADO. FIELD SOLUCIÓN B OFRECE UNA APROPIADA TINCIÓN QUE PERMITE LA DIFERENCIACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS – COMPONENTES: EOSINA EXCIPIENTES
2502191	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO COLORACIÓN GRAM LUGOL X 500ml	COLORACIÓN GRAM LUGOL X 500ml SOLUCIÓN COMPUESTA POR POTASIO YODURO Y POTASIO DE YODO. ES NECESARIO OFERTAR TODOS LOS COLORANTES GRAM DE LA MISMA MARCA.
2501617	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE PARA RETICULOCITOS	AZUL DE CRESILO BRILLANTE FRASCO X 50ml PARA DETERMINACIÓN DE RETICULOCITOS
2505520	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTE DE WRIGHT FRASCO X200ml	COLORANTES DE WRIGHT FRASCO X 200ml LA NATURALEZA ÁCIDA O BÁSICA DE LAS ESTRUCTURAS CELULARES DETERMINA SU AVIDEZ PORLOS COMPONENTES DEL COLORANTE POLICROMÁTICO DE WRIGHT; ES ASÍ COMO LOS ÁCIDOS NUCLEICOS SE TIÑEN CON AZUL B QUE ES EL BÁSICO Y LA HEMOGLOBINA CON LA EOSINA Y QUE ES ÁCIDA. OTRAS ESTRUCTURAS SE TIÑEN POR UNA COMBINACIÓN DE AMBOS Y SE DENOMINAN NEUTRÓFILOS.
2504544	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTE LUGOL PARA TINCIÓN DE GRAM X 200ml	COLORANTE LUGOL DE GRAM, SOLUCIÓN DE YODO YODURADA. CONTIENE: YODO Y YODURO DE POTASIO. ESPECIFICACIONES: APARIENCIA COLOR MARRÓN CLARO. OLORP ENETRANTE. USOS: DIAGNOSTICO IN VITRO, FIJADOR EN LA TINCIÓN DE GRAM. PRESENTACIÓN: FRASCO POR 200ml
2502519	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTES DE GRAM FUCSINA X 500ml PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.	COLORANTES DE GRAM FUCSINA X 500ml PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. COLORACIÓN DE CONTRASTE EN LA TINCIÓN DE GRAM OFERTAR TODOS LOS COLORANTES DE LA MISMA MARCA.

2504543	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTES DE GRAM O ALCOHOL ACETONA/ETANOL CETONA: MEZCLA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ACETONA EN PROPORCIÓN 3:1 FRASCO 200ml	COLORANTES DE GRAM O ALCOHOL ACETONA/ETANOL CETONA: MEZCLA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ACETONA EN PROPORCIÓN 3:1 PARA LA COLORACIÓN DE GRA M. APARIENCIA: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO. OLOR: ALCOHÓLICO CARACTERÍSTICO. GRAVEDAD ESPECIFICA 20/20° C: 0.8 ± 0.07. SOLUBLE EN GUA. USOS: DIAGNOSTICO IN VITRO. DECOLORANTES EN LA TINCIÓN DE GRAM.
2501649	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORACIÓN DE HEMATOLOGÍA	COLORANTES DE WRIGHT (EOSINA-AZUL DE METILENO) fc X 1000ml
2501837	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORANTES DE WRIGHT (EOSINA-AZUL DE METILENO) FRASCO X 500ml	COLORANTES PARA DIFERENCIAR LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS. COMPUESTO POR EOSINA-AZUL DE METILENO, SOLUCIÓN SEGÚN WRIGHT. UTILIZADA EN HISTOL
2503518	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACION FRASCO POR 200ML	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACION FRASCO POR 200m
2503519	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500ml	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500m
2503520	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500ml	COLORANTE DE ZIELH NEELSEN AZUL DE METILENO. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500ml
2503521	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTE FUSCINA DE ZIELH NEELSEN PRESENTACIÓN FRASCO POR 200ml	COLORANTE FUSCINA DE ZIELH NEELSEN. PRESENTACION FRASCO POR 200ml

2502957	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	COLORANTES FUSCINA DE ZIELH NEELSEN. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500ml	COLORANTE FUSCINA DE ZIELH NEELSEN. PRESENTACIÓN FRASCO POR 500ml
2584367	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	DECOLORANTES DE ZIEHL O ALCOHOL ACIDO.	LIQUIDO DECOLORANTES EN LA COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN, TRANSPARENTE SIN PRESENCIA DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS, NI PRECIPITADAS, TAMBIÉN ACETONA25%) OFERTAR TODOS LOS COLORANTES DE UNA MISMA MARCA.
2501419	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	DECOLORANTES DE GRAM O ALCOHOL ACETONA, FRASCO AMBAR X 500ml	DECOLORANTES DE GRAM O ALCOHOL ACETONA: FAMILIA QUÍMICA "ALCOHOLES". COMPOSICIÓN: METANOL75%, ACETONA 25%.
2502408	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO X 200ml	PARA COLORACIÓN DE FIELD- HEMOPARÁSITOS. FRASCO X 200ml
2502409	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	FIELD SALES FOSFATADAS X 500ml DILUYENTE EN LA TINCIÓN DE HEMOPARÁSITOS (FIELD-GIEMSA).	SALES FOSFATADAS, SOLUCIÓN AMORTIGUADORA, SALES AMORTIGUADORAS. CONTIENE: FOSFATO DISÓDICO ANHIDRO, FOSFATO MONOPOTÁSICO. ESPECIFICA
2587162	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	COLORACION DE GRAM FUSCINA DE GRAM, FRASCO X 200ml	FUCSHINA DE GRAM X 200ml COLORANTES PARA TINCION DE GRAM
2500097	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	LUGOL/YODO 2% PARASITOLÓGICO FRASCO X 1000ml. PARA VISUALIZAR ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN MATERIA FECAL	LUGOL YODO 2%, PARA VISUALIZAR ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN MATERIA FECAL FRASCOS X 1000ml
2505984	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	LUGOL PARASITOLÓGI	DISOLUCIÓN PARA EL CONTRASTE VISUAL EN EL EXAMEN PARASITOLÓGICO

							CO FRASCO X 200ml	
2502170	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	LUGOL PARASITOLÓGICO FRASCO X 500ml	LUGOL YODO 2%, PARA VISUALIZAR ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN MATERIA FECAL FRASCOS X 500ml
2501644	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	METANOL /ALCOHOL METÍLICO FIJACIÓN LAMINAS	METANOL PARA FIJACIÓN DE LÁMINAS FRASCO X 500ml
2501257	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO HIDRÓXIDO POTASIO 10% X FRASCO 100ml	REACTIVO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% (KOH) FRASCO X 100ml, PARA EXAMEN DIRECTO EN BUSCA DE ESTRUCTURAS MICÓTICAS EN PIEL
2501827	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% KOH FRASCO X 100ml	FRASCO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO PARA DIRECTO DE HONGOS. FRASCO X 100ml
2501650	41116005	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-02	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% (KOH) FRASCO X 100ml	FRASCO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO KOH PARA DISOLUCIÓN DE QUERATINA Y ACLARACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE HONGOS. FRASCO X 100ml
CONTROL DE CALIDAD MOLECULAR								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2504526	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-03	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MALARIA DIRECTO. COMPONENTES: LAMINAS CON PREPARACIONES DE GOTA GRUESA Y EXTENDIDO	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MALARIA DIRECTO. COMPONENTES: LAMINAS CON PREPARACIONES DE GOTA GRUESA Y EXTENDIDO FINO. LAMINAS POR PANE L 20. LAS LÁMINAS DEBEN INCLUIR ESPECIES PRESENTES EN LA REGIÓN Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES, INFECCIONES MIXTAS, DIFERENTES DENSIDA DES PARASITARIAS Y MUESTRAS NEGATIVAS. CADA LAMINA SERÁ ASIGNADA CON UN CÓDIGO SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO. CADA PANEL VA CON UN FORMATO.

							FINO. LAMINAS POR PANE	
2504633	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-03	C/U	A-02-02-01-003-005	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DIRECTO DE CHAGAS	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DIRECTO DE CHAGAS
2501463	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-03	C/U	A-02-02-01-003-005	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE CHAGAS POR IFI	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE CHAGAS POR IFI
2501464	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-03	C/U	A-02-02-01-003-005	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE LEISHMANIA POR IFI	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE LEISHMANIA POR IFI
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de a rtículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502560	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	FCO	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE HEMOCLASIFIC ACIÓN. SEGÚN EQUIPO INSTITUCIÓN.	CONTROL CALIDAD EXTERNO HEMOCLASIFICACIÓN. ANALITOS SEGÚN LAS NECESIDAD-DES DE LOS EQUIPOS DE CADA INSTITUCIÓN. FRASCOS CON CONTROL Y ANORMAL
2503155	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE MARCADORES VIRALES, 5 MUESTRAS POR EVENTO	CONTROL CALIDAD EXTER MARCADORES VIRALES. EVENTOS (5 MUESTRAS POR EVENTO), MARCADORES VIRALES: PARA HIV-HEPATITIS B
2501542	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA CLÍNICA KIT X 10 ANALITOS X 2 MUESTRAS	ANALITOS: ACIDO URICO, ALBUMINA, AMILASA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECTA, COLESTEROL HDL, COLESTEROL, TOTAL, CREATININA EN S LICEMIA, GGT, HIERRO SÉRICO, NITRÓGENO UREICO, PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO, TRANSAMINASA GOT, TRANSAMINASA GPT, TRIGLICÉRIDOS. LOS1C ONTRATO

2503156	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE QUÍMICA CLÍNICA POR 15 ANALITOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE QUÍMICA CLÍNICA POR 15 ANALITOS: ÁCIDO ÚRICO, ALBUMINA, AMILASA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECT CLO RO Y CALCIO POR IÓN SELECTIVO), FOSFATASA ALCALINA, GLICEMIA, GGT, HIERRO SÉRICO, NITRÓGENO UREICO, PROTEÍNAS TOTALES EN SUER.
2503153	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL CALIDAD EXTERNO DE QUÍMICA CLÍNICA 30 ANALITOS	ANALITOS: ÁCIDO ÚRICO, ALBUMINA, AMILASA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECTA, COLESTEROL HDL, COLESTEROL, TOTAL, CREATININA EN S GLI CEMIA, GGT, HIERRO SÉRICO, NITRÓGENO UREICO, PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO, TRANSAMINASA GOT, TRANSAMINASA GPT, TRIGLICÉRIDOS
2502189	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PROGRAMA DE LEISHMANIASIS POR IFI	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PROGRAMA DE LEISHMANIASIS POR IFI
2501536	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO GASES ARTERIALES	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES - ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2501543	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL CALIDAD EXTERNO HBA1C	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HBA1C-ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2501540	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL CALIDAD EXTERNO HORMONAS Y PRUEBAS ESPECIALES	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HORMONAS Y PRUEBAS ESPECIALES -ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2503154	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO-INFECCIOSA TORCH, 5 MUESTRAS POR EVENTO	COMTROL DE CALIDAD EXTERNO-INFECCIOSA TORCH. (5 MUESTRAS POR EVENTO), CONTROL DE CALIDAD EXTERNO TORCH TOXOPLASMA IGG, TOXOPLASMA I IGM
2501535	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGÍA	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA - ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO

2501537	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL CALIDAD EXTERNO PARA UROANÁLISIS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANÁLISIS- ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2501571	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGÍA	PROGRAMA PARA CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE PARASITOLOGÍA
2501554	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	KIT	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD CUALITATIVO PARA VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES	CONTROL DE CALIDAD CUALITATIVO PARA VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES (CONTROL DE CALIDAD KIT X 4 F INVIMA
2501534	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COAGULACIÓN PLASMAS LIOFILIZADOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COAGULACIÓN PLASMAS LIOFILIZADOS. ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIO DE PRUEBAS QUE SE PROCESE EN LABORATORIO
2501533	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMATOLOGÍA	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMATOLOGIA. ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2502190	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGÍA	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA - ANALITOS ELEGIBLES DE ACUERDO CON EL PORTAFOLIOS DE PRUEBAS QUE SE PROCESEN EN CADA LABORATORIO
2503850	41116100	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-04	C/U	A-02-02-01-003-005	PROGRAMA METABOLITOS EN ORINA: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. MONITOREA HASTA 24 ENSAYOS	CARACTERÍSTICAS PROGRAMA RIQAS METABOLITOS EN ORINA, ES UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, DISEÑADO PARA MONITOREAR EL DESEMPEÑO DE HASTA 24 ENSAYOS DE QUÍMICA DE RUTINA EN ORINA. FRECUENCIA DEL REPORTE: QUINCENAL (1X6 MESES). PARÁMETROS: ALBUMINA, AMILASA, CALCIO, CLORO, COBRE, CORTISOL, CREATININA, DOPAMINA, EPINEFRINA, GLUCOSA, NOREPINEFRINA, NORMETANEFRINA, OSMOLARIDAD, OXALATO, FOSF ORO (INORGÁNICO), POTASIO, PROTEÍNA TOTAL, SODIO, UREA, ÁCIDO ÚRICO, VMA, S- HIAA, METANEFRINA, MAGNESIO.

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO								
Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502214	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI-B 10ML /PRUEBA	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH, REACTIVO MONOCLONAL ANTI-B 10ML OFERTAR TODO LOS HEMOCLASIFICADORES DE LA MISMA MARCA.
2502183	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO SEMIAUTOMATIZADO	PRUEBA PARA CUADROS HEMÁTICOS (CH) SEMIAUTOMATIZADOS. PARA EQUIPOS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONJUNTO DE REACTIVOS PARA EL EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO
2501838	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE TURK PARA RECUENTO DE LEUCOCITOS. FRASCO X 500ML	REACTIVO PARA EL RECUENTO DE LEUCOCITOS. LIQUIDO AZUL CRISTALINO SIN PRESENCIA DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS NI PRECIPITADAS, COMPUESTO POR AGUA
2502209	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO AUTOMATIZADO Y PARÁMETROS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	PRUEBA PARA CUADROS HEMÁTICOS (CH) SEMIAUTOMATIZADOS. PARA EQUIPOS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONJUNTO DE REACTIVOS PARA LA CH AUTOMATIZADA
2501568	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	TIRA PARA HEMOGLOBINA CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO	TIRA PARA MEDICIÓN MANUAL DE HEMOGLOBINA, DEBE INCLUIR CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO

HEMATOLOGIA								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502214	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI-B 10ML /PRUEBA	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH, REACTIVO MONOCLONAL ANTI-B 10ML OFERTAR TODO LOS HEMOCLASIFICADORES DE LA MISMA MARCA.
2502183	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO SEMIAUTOMATIZADO	PRUEBA PARA CUADROS HEMÁTICOS (CH) SEMIAUTOMATIZADOS. PARA EQUIPOS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONJUNTO DE REACTIVOS PARA EL EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO
2501838	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	FCO	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DE TURK PARA RECUENTO DE LEUCOCITOS. FRASCO X 500ML	REACTIVO PARA EL RECUENTO DE LEUCOCITOS. LIQUIDO AZUL CRISTALINO SIN PRESENCIA DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS NI PRECIPITADAS, COMPUESTO POR AGUA
2502209	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO AUTOMATIZADO Y PARÁMETROS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	PRUEBA PARA CUADROS HEMÁTICOS (CH) SEMIAUTOMATIZADOS. PARA EQUIPOS SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN. CONJUNTO DE REACTIVOS PARA LA CH AUTOMATIZADA
2501568	41116008	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	TIRA PARA HEMOGLOBINA CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO	TIRA PARA MEDICIÓN MANUAL DE HEMOGLOBINA, DEBE INCLUIR CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO

INMUNOLOGIA								
Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2502203	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA EN LÁTEX PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE PROTEÍNA C REACTIVA EN SUERO POR AGLUTINACIÓN	REACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA, POR MÉTODO DE REACCIÓN INMUNOLÓGICA DE AGLUTINACIÓN EN SUERO, KIT COMPLETO QUE INCLUYA CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, MEZCLADORES Y LAMINA DE REACCIÓN.
2501673	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIESTREPTOLISINA EN SUERO. CON CONTROL INTERNO	PRUEBA RÁPIDA EN LÁTEX PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS ANTIESTREPTOLISINA EN SUERO. KIT COMPLETO CON LÁMINAS CONTROL INTERNOS Y MEZCLADORES
2501072	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA DE ALCOHOL EN ALIENTO, EXAMEN DE FILTRADO SEMI-CUANTITATIVO	PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DE ALCOHOL EN ALIENTO, EXAMEN RÁPIDO DE FILTRADO SEMI-CUANTITATIVO. INDICA LA RELATIVA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN EL ALIENTO EXHALADO. INDICA LA CONCENTRACIÓN RELATIVA DE ALCOHOL EN SANGRE DE 0.02%, 0.04%, ETC. LA CAPSULA ESTÁ SUJETA AL TUBO POR DOS FILTROS EN AMBOS LADOS
2501555	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	KIT	A.02.02.01.003.005	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIESTREPTOLISINAS LATEX	TÉCNICA DE AGLUTACION (AGLUTINACIÓN) EN LAMINA CON PARTÍCULAS DE LATEX SENSIBILIZADOS CON ÑESTREPTOLISINA. KIT COMPLETO CON CONTROL NEGATIVO Y POSITIVO.
2501365	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA (ULTRASENSIBLE), PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PCR EN SANGRE POR INMUNOTURBIDIMETRÍA, PRUEBA AUTOMATIZADA.

2587193	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA ELISA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG Y/O IGM FRENTE AL VIRUS DE LA PAROTIDITIS EN SUERO/PLASMA HUMANO.	PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG Y/O IGM FRENTE AL VIRUS DE LA PAROTIDITIS EN SUERO/PLASMA HUMANO. 96 TESTS.
2503302	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA DE AGLUTINACIÓN PARA LA DETECCIÓN DIRECTA CUALITATIVA DE LOS FACTORES REUMATOIDE PRESENTES EN SANGRE	PRUEBA RÁPIDA DE AGLUTINACIÓN PARA LA DETECCIÓN DIRECTA CUALITATIVA DE LOS FACTORES REUMATOIDE PRESENTES EN SANGRE, KIT COMPLETO QU INCLUYA CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, MEZCLADORES Y LÁMINAS DE REACCIÓN
2504322	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA HIV AG/AC CUARTA GENERACIÓN	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV 1 Y 2) DE CUARTA GENERACIÓN, EN SUERO O PLASMA Y EN CASSETTE.
2505977	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN HIV/SIFILIS EN SANGRE.	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN HIV/SIFILIS DUO EN SANGRE TOTAL. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFICO EN CASSETTE.
2505848	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO QUE DETECTA PROTEÍNAS DEL SARS-COV2	PRUEBA RÁPIDA ANTÍGENO IG SARS-COV2 TEST ES UN INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE LA NUCLEOCÁPSIDE DEL SARS- COV-2 EN MUESTRAS DE HISOPADOS NASOFARÍNGEOS (NP) DE INDIVIDUOS SOSPECHOSOS DE COVID-19, DENTRO DE LOS PRIMEROS SIETE DÍAS DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS.
2501518	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR ALCOHOL EN SALIVA	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO EN SALIVA HUMANA. CASSETTE O TIRA INDIVIDUAL

2501565	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR ANTICUERPOS TREPONEMA PALLIDUM	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA LA TREPONEMA PALLIDUM, EN SANGRE. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFICO
2501891	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPO DE HELICOBACTER PYLORI EN SUERO TOTAL	PRUEBA RÁPIDA DE INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO DE MEMBRANA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPO DE HELICOBACTER PYLORI EN SUERO TOTAL
2501503	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA DETECCIÓN VIRUS RESPIRATORIOS	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ADENOVIRUS + INFLUENZA A & B + PARA INFLUENZA 1, 2 & 3 Y VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO.
2503794	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPO ANTITOXOPLASMA (IGG-IGM), MÉTODO CUALITATIVO	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS (IGG-IGM): MEDIANTE ENSAYO INMUNOCROMATOGRAFICO PERMITE LA DETERMINACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE ANTICUERPOS IGG-IGM DEL TOXOPLASMA GOMDII EN SANGRE-SUERO-PLASMA. TIPO DE ENSAYO: CUALITATIVO. MUESTRA: SANGRE, SUERO OP LASMA. MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFICO. PRESENTACIÓN: CASSETE. REF1: 2740005
2503240	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA I CARDIACA DE UN SOLO PASO EN CASSETTE	INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA I CARDIACA HUMANA EN MUESTRAS DE SANGRE ENTERA, SUERO Y PLASMA.
2500851	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE BETA/HCG, (GONADOTROPI	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA EN CASETTE PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE HCG (GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA) EN SUERO Y ORINA, SENSIBILIDAD DE MÍNIMO 25 UI/ML.

							NA CORIONICA HUMANA)	
2502443	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS PARA LA HEPATITIS C	PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) EN SUERO HUMANO
2500849	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNÓSTICO DE MALARIA, PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE PLASMODIUM EN SANGRE TOTAL	PRUEBA RÁPIDA POR INMUNOCROMATOGRAFÍA, CUALITATIVA EN SÁNDWICH DE ANTÍGENOS DE PLASMODIUM PF / PV EN SANGRE TOTAL.
2500117	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B-HBSAG	PRUEBA RÁPIDA SEGUNDA GENERACIÓN PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA PARA USO EXCLUSIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO SENSIBILIDAD ANALITICA MENOR A 1 UI/ML.SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 96,0 MUI/ML; ESPECIFICIDAD MÍNIMA DE 99%.
2502208	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS A IGM E IGG	PRUEBA DE INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM E IGE EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A.
2587214	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA HIV AG/AC TERCERA GENERACIÓN	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV 1 Y 2) DE TERCERA GENERACIÓN, EN SUERO O PLASMA Y EN CASSETTE O TIRA.
2501514	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR ADENOVIRUS EN SUERO	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA IDENTIFICACIÓN DE AG DE ADENOVIRUS
2501667	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA	PRUEBA RÁPIDA INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A Y B. IDENTIFICACIÓN DEL ANTIGENOIDAD (ANTIGENICIDAD) SUPERIOR 23.04.2020 SE

							DETECCION DE AG INFLUENZA A/B Y A (H1N1)	ACTUALIZA NOMBRE SIN CAMBIAR ESENCIA DEL MATERIAL, SE ANEXA FICHA TÉCNICA
2500847	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA DENGUE	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA NS1 Y ANTICUERPOS IGG E IGM EN SUERO, PLASMA O SANGRE TOTAL HUMANA EN CASSETTE. CON UNA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MAYOR O IGUAL A 93%. KIT COMPLETO.
2501599	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM -IGG CONTRA LEPTOSPIRA SP EN SUERO O PLASMA	PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IG M IG GCONTRA LEPTOSPIRA SP EN SUERO O PLASMA
2501452	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE STREPTOCOCO BETAHEMOLÍTICO DEL GRUPO A	PRUEBA INDIVIDUAL RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE ESTREPTOCOCO BETAHEMOLÍTICO DEL GRUPO A POR INMUNOCROMATOGRÁFICA.
2504570	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DE DIEZ (10) PARÁMETROS. EN ORINA HUMANA. EMPAQUE INDIVIDUAL	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA SIMULTANEA DE DROGAS MÚLTIPLES Y SUS METABOLITOS (ANFETAMINAS, BARBITÚRICOS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, MARIHUANA, METADONA, METANFETAMINAS, METILENDIOXIMETANFETAMINA, MORFINA Y ANTIDEPRESIVOS TRICICLOS) EN ORINA HUMANA. SOLO PARA USO MÉDICO Y OTRO PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO IN VITRO
2587215	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUEROS IGG E IGM TOXOPLASMA.	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUEROS IGG E IGM TOXOPLASMA GONDI POR MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO EN SUERO O PLASMA Y EN CASSETTE O TIRA

2501512	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA DETECCIÓN VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO
2502177	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	SOB	A.02.02.01.003.005	PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2 PARÁMETROS COC-THC	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE COCAÍNA Y MARIHUANA. PRUEBA EN ORINA
2501671	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 5 PARÁMETROS (COC-THC-OPI-ANF- BENZ)	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANFETAMINAS, BENZODIAZEPINAS, COCAÍNA, MARIHUANA, METANFETAMINAS Y OPIÁCEOS. PRUEBA EN ORINA, SE USA PARA DIAGNOSTICO INVITRO.
2502368	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DIFERENCIAL DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A (H1N1)	PRUEBA RÁPIDA INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DIFERENCIAL DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A (H1N1). IDENTIFICACIÓN
2501510	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DETERMINACIÓN RÁPIDA POR LATEX EN SUERO PARA FACTOR REUMATOIDE.	DETERMINACIÓN DE FACTOR REUMATOIDE EN SUERO, SEMICUANTITATIVA POR AGLUTINACIÓN EN LATEX.
2500843	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	RPR PRUEBA SEROLÓGICA/ KIT DETERMINACIÓN DE SIFILIS. PRUEBA RÁPIDA	REACTIVO CON MICROPARTÍCULAS DE CARBÓN QUE INCLUYA: LAMINAS DESECHABLES CON 10 ÁREAS, AGUJA PRECALIBRADA DE 16 UL, FRASCO DOSIFICADOR, SEROLOGÍA POR CARBÓN ACTIVADO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE FUENTES NO TREPONÉMICAS.

2502200	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-05	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA PRUEBA DE SEROLOGÍA VDRL	SUSPENSIÓN ANTIGÉNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE VDRL EN SUERO SIN INACTIVAR.

INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2500030	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ACEITE DE INMERSIÓN FRASCO X 100ml. PARA ANALIZAR ESTRUCTURAS MICROSCÓPICAS	ACEITE PARA MICROSCOPIA. LIQUIDO CLARO Y VISCOSO, CON PROPIEDADES DE REFRACCIÓN. ÍNDICE DE REFRACCIÓN: (20°C) 1,515 - 1,517. DENSIDAD: 20 °C / 4 °C) 1,0245 - 1,0265 G/CM3. VISCOSIDAD: (20°C) 100 - 200 MPA*S. FLUORESCENCIA: < (><<)> 1500 PPB.
2500094	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ACEITE DE INMERSIÓN FRASCO X 200ml. PARA ANALIZAR ESTRUCTURAS MICROSCÓPICAS	ACEITE PARA MICROSCOPIA. LIQUIDO CLARO Y VISCOSO, CON PROPIEDADES DE REFRACCIÓN. ÍNDICE DE REFRACCIÓN: (20°C) 1,515 - 1,517. DENSIDAD: 20 °C / 4 °C) 1,0245 - 1,0265 G/CM3. VISCOSIDAD: (20°C) 100 - 200 MPA*S. FLUORESCENCIA: < (><<)> 1500 PPB.
2501804	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ACIDO SULFOSALICILICO AL 3% PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE PROTEINURIA	ÁCIDO SULFOSALICILICO AL 3% PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE PROTEINURIA
2504036	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	AGUA DESTILADA (LIBRE DE IONES) PH 6-7, CONDUCTIVIDAD MÁXIMA 0.1 LIBRE DE IONES. 5l	AGUA DESTILADA PH 6-7, CONDUCTIVIDAD MÁXIMA 0.1 LIBRE DE IONES.AGUA ULTRAPURA LIBRE DE RNAS Y DNASAS
2501585	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	AGUA DESTILADA LIBRE DE IONES FRASCO 1000	PH: 6-7 CONDUCTIVIDAD MÁXIMA 01 LIBRE DE IONES

2504320	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	GAR	A.02.02.01.003.005	AGUA DESTILADA LIBRE DE IONES GAR 20 L	AGUA DESTILADA O AGUA DESIONIZADA DE ALTA PUREZA, CONDUCTIVIDAD CERO
2502614	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ASA BACTERIOLÓGICA REDONDA CALIBRADA DE 10 UL	ASA REDONDA, PLÁSTICA, DESECHABLE CALIBRADA PARA MICROBIOLOGÍA DE 10 UL
2501520	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ASA RECTA DE FERONIQUEL	ASA RECTA GRUESA EN FERRONIQUEL PARA USO EN MICOLOGÍA
2587206	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO POR 100ml INDICADOR DE PH PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL.	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO 100 ml EL AZUL DE BROMOTIMOL ACTÚA COMO UN ÁCIDO DÉBIL EN SOLUCIÓN. INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AMAÍILLO: 6,0 INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AZUL: 7,6
2587209	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO POR 1000ml INDICADOR DE PH PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL.	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO 1000 ml EL AZUL DE BROMOTIMOL ACTÚA COMO UN ÁCIDO DÉBIL EN SOLUCIÓN. INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AMAÍILLO: 6,0 INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AZUL: 7,6
2587208	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO POR 500ml. INDICADOR DE PH PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL.	AZUL DE BROMOTIMOL FRASCO 500 ml EL AZUL DE BROMOTIMOL ACTÚA COMO UN ÁCIDO DÉBIL EN SOLUCIÓN. INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AMAÍILLO: 6,0 INTEÍVALO DE VIÍAJE DE PH: AZUL: 7,6
2502612	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	VASO DE PRECIPITADO 100 CC VIDRIO	VASO DE PRECIPITADO 100 CC VIDRIO: CON PICO, FABRICADO CON UN ESPESOR DE PARED UNIFORME, OFRECE UN EQUILIBRIO OPTIMO ENTRE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Y RESISTENCIA MECÁNICA. TIENEN UNA ESCALA MÉTRICA GRADUABLE DOBLE.

2503989	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	BEAKER O VASO DE PRECIPITADO 500ml	VASO DE PRECIPITADO 500 CC VIDRIO: CON PICO, FABRICADO CON UN ESPESOR DE PARED UNIFORME, OFRECE UN EQUILIBRIO OPTIMO ENTRE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Y RESISTENCIA MECÁNICA. TIENEN UNA ESCALA MÉTRICA GRADUABLE DOBLE. NORMA ASTM E-960.
2504003	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	VASO DE PRECIPITADO 50ml VIDRIO: CON PICO, FABRICADO CON UN ESPESOR DE PARED UNIFORME. UNIDAD	VASO DE PRECIPITADO 50ml, VIDRIO: CON PICO, FABRICADO CON UN ESPESOR DE PARED UNIFORME, OFRECE UN EQUILIBRIO OPTIMO ENTRE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Y RESISTENCIA MECÁNICA. TIENEN UNA ESCALA MÉTRICA GRADUABLE DOBLE. FORMA BAJA. PRECISIÓN DE 10 ml. REF: CO10100 0071. NORMA ASTM E-960.
2503232	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	BEAKER O VASO DE PRECIPITADO DE 600ml, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON FORMA CILÍNDRICA Y BOCA ANCHA	BEAKER O VASO DE PRECIPITADO DE 600ml, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON FORMA CILÍNDRICA Y BOCA ANCHA
2502175	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	BOLSA RECOLECTORA URINARIO PEDIÁTRICO GRADUADO, DESECHABLE E HIPOALERGÉNICO	BOLSA RECOLECTOR URINARIO PEDIÁTRICO GRADUADO, DESECHABLE E HIPOALERGÉNICO
2503984	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	BOTELLA DE 8 ONZAS DE TAPA AZUL EN VIDRIO BOROSILICATO COLOR ÁMBAR, CON TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO AZUL	BOTELLA DE 8 ONZAS DE TAPA AZUL EN VIDRIO BOROSILICATO COLOR ÁMBAR, CON TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO AZUL. USO: PROTEGER LOS REACTIVOS S Y SOLUCIONES SENSIBLES A LA LUZ.
2501604	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CAJA DE PETRI EN VIDRIO RESISTENTES AL CALOR, CON TAPA GRANDE	CAJA DE PETRI EN VIDRIO RESISTENTES AL CALOR, CON TAPA GRANDE DE 8CM DE DIÁMETRO. TAPA GRANDE DE 8CM DE DIÁMETRO

							DE 8CM DE DIÁMETRO. TAPA GRANDE DE 8CM DE DIÁMETRO	
2501515	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CAJA DE PETRI EN VIDRIO 90 X 15 mm	CAJA DE PETRI EN VIDRIO 90mm DE DIÁMETRO X 15mm DE ALTURA, FABRICADA CON POLIESTIRENO CRISTAL. ESTERILIZADAS POR RADIACIÓN GAMMA, PARA MICROBIOLOGÍA
2501832	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CÁMARA DE NEUBAUER LÍNEA BRILLANTE PARA RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS Y ROJOS	CÁMARA DE NEUBAUER LÍNEA BRILLANTE PARA RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS Y ROJOS. ES UN APARATO DE PRECISIÓN COMPUESTO DE VIDRIO ÓPTICO.
2501517	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CAMISA DE BIOSEGURIDAD, ACCESORIO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE AL VACÍO	CAMISA DE BIOSEGURIDAD, ACCESORIO PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE AL VACÍO. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, DE AJUSTE PERFECTO A LA AGUJA, LATEX
2502187	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CARGA LIQUIDA GLUCOSA DEXTROSA X 75G	CARGA LIQUIDA DE GLUCOSA DEXTROSA LISTA PARA USAR X 75G X 150ml
2502551	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CERA PARA SELLADO CAPILARES HEMATOCRITO	CERA DE PLÁSTICO -VINILICO QUE NO SE SECA, SOBRE PLACA PLÁSTICA DE DOBLE CANAL. PARA EL SELLADO RAPIDO Y SEGURO DE LOS CAPILARES DE HEMATOCRITO
2503988	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	CONTROLADOR DE PIPETA MANUAL DE ALTA CAPACIDAD, PIPETA 0,1-100ml	CONTROLADOR DE PIPETA MANUAL DE ALTA CAPACIDAD, PIPETA 0,1-100ml DIMENSIONES LONGITUD: 8 PULGADAS (205 mm) DEL BULBO. ANCHO 1,75 PUL GADAS (44 mm). INTERRUPTOR DEL PULGAR, BOTÓN DE ARRIBA PULSADOR (BOTÓN DE SOPLADO. FÁCIL DE USAR, DISEÑO CÓMODO, ADAPTADOR DE SILICONA AUTOCLAVABLE, PIPETEO PRECISO, FILTRO HIDROFÓBICO DE 3 UM REEPLAZABLE, A PRUEBA DE FUGAS.
2503800	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	GLN	A.02.02.01.003.005	DETERGENTE NEUTRO A BASE DE ALQUILSULFONATO GALÓN	DETERGENTE NEUTRO A BASE DE ALQUILSULFONATO. USO: LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO Y USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO.

							(MINIMO 3,75 LITROS). USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO	
2503235	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	EMBUDO DECANTACIÓN/ SEPARACIÓN PLÁSTICO DE MATERIAL PLÁSTICO (POLIETILENO, PVC, TEFLON/POLITE TRAFLUORETIL ENO), DE FORMA CONICA	EMBUDO DECANTACIÓN/SEPARACIÓN PLÁSTICO DE MATERIAL PLÁSTICO (POLIETILENO, PVC, TEFLON/POLITETRAFLUORETILENO), DE FORMA CONICA
2502369	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	ERLENMEYER DE 1000ml. RECIPIENTE FABRICADO EN VIDRIO	RECIPIENTE FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO, DE BASE REDONDA Y CUELLO ESTRECHO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CON REBORDE Y GRAD CC
2504425	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCO DE BOCA ANCHA EN POLIMETILPENT ANO (PMP)+TAPÓN ROSCA 500ml	FRASCO BOCA ANCHA, PMP, NALGENE® FRASCO DE BOCA ANCHA EN POLIMETILPENTANO (PMP) TRANSPARENTE, CON TAPÓN DE ROSCA DE POLIPROPILENO (P P). CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD 500ml. DIÁMETRO (Ø) EXTERIOR 71mm. ALTURA 155mm. DIÁMETRO (Ø)INTERIOR-CUELLO 38mm. DE USO UNIVERSALE N LABORATORIO Y TOMA DE MUESTRAS, BOCA ANCHA, ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. RESISTENTE A TEMPERATURAS DESDE -20 HASTA + 175°C. ANTIGOTEO. AUTOCLAVABLE
2503985	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCO GOTERO DE 30ml DE POLIPROPILEN O BLANCO, DIÁMETRO DE ROSCA 13mm, TAPA CON CÓDIGO DE COLORES SEGÚN NORMA INTERNACIONA L	FRASCO GOTERO DE 30ml DE POLIPROPILENO BLANCO, DIÁMETRO DE ROSCA 13mm, TAPA CON CÓDIGO DE COLORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL

2501674	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA DE POLIPROPILENO CON TAPA ROSCA	FRASCO PLÁSTICO RECOLECTOR DE ORINA ESTÉRIL, DE POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO, INCOLORO CON ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN Y TAPA ROSCA, ADECUADO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANÁLISIS
2503990	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCOS ÁMBAR BOCA ANCHA TAPA 1 LITRO	FRASCO EN VIDRIO BOROSILICATO, DE COLOR ÁMBAR CLASE A, SIN BURBUJAS, BOCA ANCHA, CON TAPA PLÁSTICA TIPO ROSCA. AUTOCLAVABLE. CAPACIDAD D 1 LITRO
2503992	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCO EN VIDRIO BOROSILICATO, DE COLOR ÁMBAR, BOCA ANCHA, TAPA PLÁSTICA EN ROSCA	FRASCO EN VIDRIO BOROSILICATO, DE COLOR ÁMBAR CLASE A, SIN BURBUJAS, BOCA ANCHA, CON TAPA PLÁSTICA TIPO ROSCA. AUTOCLAVABLE. CAPACIDAD D 500ml
2503991	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	FRASCO VIDRIO ÁMBAR BOCA ANCHA TAPA 50ml	FRASCO EN VIDRIO BOROSILICATO, DE COLOR ÁMBAR CLASE A, SIN BURBUJAS, BOCA ANCHA, CON TAPA PLÁSTICA TIPO ROSCA. AUTOCLAVABLE. CAPACIDAD D 50ml
2502193	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	POLVO PARA PREPARAR CARGAS SOBRE X 25 GR	POLVO DE DEXTROSA ANHIDRA PARA PREPARAR CARGAS DE GLUCOSA DE 25 G
2501562	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	GRADILLA PARA 50 TUBOS DE ENSAYO EN METACRILATO	GRADILLA PARA 50 TUBOS DE ENSAYO EN METACRILATO TRANSPARENTE, NO AUTOCLAVABLE
2587188	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	GRADILLA PLÁSTICA PARA 40 TUBOS DE ENSAYOS DE 20 mm	GRADILLA PLÁSTICA PARA 40 TUBOS DE ENSAYOS DE 20 mm
2502565	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	GRADILLAS PLÁSTICAS PARA TUBOS DE 2 CC (PARA 96 TUBOS) EN POLIPROPILENO	GRADILLAS PLÁSTICAS PARA TUBOS DE 2 CC (PARA 96 TUBOS) EN POLIPROPILENO
2505126	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	GRADILLA/CAJA EN POLIPROPILENO CON TAPA CON BISAGRA PARA TUBOS DE	GRADILLA/CAJA EN POLIPROPILENO (PP) RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON TAPA CON BISAGRA. MEDIDAS: 140X153X53mm. PARA MICROTUBOS DE 1,5 ml - 2,0ml, AGUJEROS IDENTIFICADOS ALFANUMÉRICAMENTE. REFERENCIA: AUM-513

							1,5 ml -2,0 ml RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS	
2587165	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.005	HIDRÓXIDO DE POTASIO PARA DIRECTO DE HONGOS. FRASCO X 100ml	SOLUCIÓN PARA LA DISOLUCIÓN DE QUERATINA Y ACLARACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE HONGOS
2505130	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARÁMETRO EN FORMA DE TIRA+TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CAJA X 50 TIRAS	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARÁMETRO, EN FORMA DE TIRA PREPICADA, MARCADA CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, EN TODOS SUS CICLOS DE VAPOR POR GRAVEDAD Y ASISTIDOS POR VACÍO A 121°C Y 132°C, DE FÁCIL LECTURA E IDENTIFICACIÓN, LARGO 20,5CM X ANCHO 15MM. USO: VERIFICA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CLASE 4. CUMPLE CON ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005. PRESENTACIÓN: CAJA POR 50 TIRAS.
2504598	41122605	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.005	KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA - 50 PURIFICACIONES. SIMPLIFICA EL AISLAMIENTO TOTAL DE ARN DE DIFERENTES MATERIALES DE PARTIDA	KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA - 50 PURIFICACIONES. SIMPLIFICA EL AISLAMIENTO TOTAL DE ARN DE DIFERENTES MATERIALES DE PARTIDA, COMO CÉLULAS, TEJIDOS Y SANGRE. EL ADN GENÓMICO SE ELIMINA SIN UNA ETAPA DE DIGESTIÓN ENZIMÁTICA. LAS RNASAS SE INACTIVAN PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DEL ARN. ADEMÁS, TODOS LOS KITS DE ARN INVITRAP CUENTAN CON COLUMNAS DE ESPIN TAPADAS PARA UNA PURIFICACIÓN DE ARN SEGURA Y CONFIABLE. CARACTERÍSTICAS: ARN PURO SIN DIGESTIÓN POR DNASAS, ALTA FLEXIBILIDAD, ALTO RENDIMIENTO, USO UNIVERSAL.
2501389	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA DE SUPERFIE CÓNCAVA EN ACRÍLICO	LAMINA CÓNCAVA, SEMICURVA, PARA COLORACIÓN DE FIELD, GOTA GRUESA
2503393	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA CUBRE OBJETOS EN VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE 24X60mm	LAMINA DE HOJA FINA, TRANSPARENTE CUADRADA DE 24X60 MM LIBRE DE GRASA Y CON BUENA CALIDAD OPTICA.
2501640	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA DE VIDRIO CUBRE	LÁMINAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, CUBREOBJETOS. ADECUADA PARA LA

							OBJETO DE 22mm X 22mm	OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE PREPARACIONES EN FRESCO. LAMINILLAS DE 22
2501355	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA DE CUARZO PARA LECTURA EN CÁMARA DE NEWBAUER	LAMINA DE CUARZO PARA LECTURA EN CÁMARA DE NEWBAUER, CUBRE OBJETO, MEDIDAS: 20 X 26 mm PRESENTACIÓN: CAJA X 10 UNIDADES
2502182	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA PARA HEMOCLASIFICACIONES, DIVISIÓN PARA 50 PACIENTES	LAMINA PARA HEMOCLASIFICACIONES, DIVISIÓN PARA 50 PACIENTES
2502188	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA PARA R.H. (ANTI A.B.D.) LAMINA DE VIDRIO MARCADA PARA REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN CON ANTISUEROS ANTI-A, B Y D.	LAMINA PARA R.H. (ANTI A.B.D.) LAMINA DE VIDRIO MARCADA PARA REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN CON ANTISUEROS ANTI-A, B Y D.
2502181	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA CÓNCAVA VIDRIO POZO CON 12 ANILLOS/EXCAVACIONES	LAMINA CÓNCAVA VIDRIO POZO CON 12 ANILLOS/EXCAVACIONES
2501489	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA PORTA OBJETOS DE 76 X 52mm, EN VIDRIO ESMERILADO SENCILLO	LAMINA EN VIDRIO ESMERILADO SENCILLO DE 25,4 X 76,2 mm ADECUADAS PARA REALIZAR EXÁMENES EN FRESCO Y COLORACIONES PARA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA.
2504047	41122600	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LAMINA PORTA OBJETOS CON CAMPOS REACCIÓN, DE COLOR AZUL. FABRICADAS EN VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO, CON CAMPOS REACCIÓN 3 LÍNEAS 6 POZOS	LAMINA PORTA OBJETOS CON CAMPOS REACCIÓN, DE COLOR AZUL. FABRICADAS EN VIDRIO SODICO-CALCICO, QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE LA NO RMA DIN ISO 8037/1. DIMENSIONES APROXIMADAS: 76X26mm. CON BORDES ESMERILADOS A 90°. MASCARA DE RESINA EPOXICA. CON CAMPOS REACCION3, LÍNEAS 6 POZOS. AUTOCLAVABLES. LISTAS PARA USAR. CON DIÁMETRO Y NUMERACIÓN CON CAMPOS REACCIÓN 3 LÍNEAS 6 POZOS

2502603	42142515	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LANCETA AUTOMÁTICA PEDIÁTRICA PARA EFECTUAR PUNCIÓN CAPILAR CON CUCHILLA RETRÁCTIL SESGADA	LANCETA AUTOMÁTICA PEDIÁTRICA PARA EFECTUAR PUNCIÓN CAPILAR CON CUCHILLA RETRÁCTIL SESGADA, CON PROFUNDIDAD CONTROLADA DE 1.O mm Y L BLOQUEO.
2501523	42142515	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LANCETA DE SEGURIDAD ACTIVABLE POR CONTACTO DE BAJO FLUJO	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE, CON BOTÓN DISPARADOR, CARCASA, CAPUCHÓN ESTÉRIL DE LA AGUJA, DIÁMETRO DE LA AGUJA (0,36mm, 28 G)
2501643	42142515	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	LANCETA DESECHABLE PARA PUNCIÓN CAPILAR, EMPAQUE INDIVIDUAL X 200 UNIDADES	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE, CON BOTÓN DISPARADOR, CARCASA, CAPUCHÓN ESTÉRIL DE LA AGUJA, DIÁMETRO DE LA AGUJA (0,36mm, 28 G) X 200 UNIDADES
2504005	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A DE 1000ml, EN VIDRIO BOROSILICATO, CERTIFICADO, DE BASE REDONDA Y PLANA CON FORMA DE BALÓN 1000ml	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A DE 1000ml, EN VIDRIO BOROSILICATO, CERTIFICADO, DE BASE REDONDA Y PLANA CON FORMA DE BALÓN Y CUELLO LARGO. COLOR CLARO, PINTURA DE GRADUACIÓN AZUL, TAPÓN PE, PRECISIÓN DE MÍNIMA +/- 0,5 M.
2504004	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A DE 250ml, EN VIDRIO BOROSILICATO, CERTIFICADO, DE BASE REDONDA Y PLANA CON FORMA DE BALÓN 250ml	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A DE 250ml, EN VIDRIO BOROSILICATO, CERTIFICADO, DE BASE REDONDA Y PLANA CON FORMA DE BALÓN Y CUELLO LARGO. COLOR CLARO, PINTURA DE GRADUACIÓN AZUL, TAPÓN PE, PRECISIÓN DE MÍNIMA +/- 0,5 M.

2505441	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 10 ml (A)	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 10 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2505442	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 20 ml (A)	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 20 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2503229	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 200 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 200 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2505443	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 25 ml (A)	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 25 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2505440	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 5 ml (CLASE A) VIDRIO	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 5 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2503230	41121805	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 500 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO	MATRAZ-BALÓN VOLUMÉTRICO DE 500 ml, EN VIDRIO BOROSILICATO
2501608	123523	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	FCO	A.02.02.01.003.004	METABISULFITO DE SODIO X 50ml PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA DE DREPANOCÍTICO EN SANGRE TOTAL	METABISULFITO DE SODIO X 50ml PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA DE DREPANOCÍTICO EN SANGRE TOTAL
2501895	41121709	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITO DE VIDRIO HEPARINIZADO	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA TOMA DE HEMATOCRITO CON HEPARINA
2502568	41121709	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO CAPILAR PARA TOMA DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA	TUBO CAPILAR PARA TOMA DE HEMATOCRITO, SIN HEPARINA
2502404	41121510	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICR	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICR

2504569	41121701	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO DE POLIPROPILENO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO. CAPACIDAD 0.5ml, PARA ALMACENAMIENTO MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	MICROTUBO DE POLIPROPILENO (PP) GRADO MEDICO, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y CAPACIDAD DE 0.5ml PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE L LABORATORIO CLÍNICO. USO: CENTRIFUGADO, CONGELACIÓN -CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS. CON CERTIFICACIÓN QUE GARANTICE QUE NO CONTIENEN RNASA, ADNASA, ADN HUMANO, PIRÓGENOS, INHIBIDORES DE RCP NI ATP.
2502178	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO DE POLIPROPILENO CON TAPA ROSCA. CAPACIDAD 2.0/CRIOVIAL	MICROTUBO DE POLIPROPILENO CON TAPA ROSCA ESTÉRIL, CAPACIDAD DE 2.0 CC, PARA CONGELACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
2502569	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO SECO COLOR ÁMBAR, CON GEL SEPARADOR, TAPA AMARILLA. PUNCIÓN CAPILAR	MICROTUBO SECO DE POLIPROPILENO, CON GEL SEPARADOR, COLOR ÁMBAR, IRROMPIBLE, TAPA AMARILLA CON CIERRE HERMÉTICO, PARA PUNCIÓN CAPILA COLORES)
2501893	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO TAPA LILA PARA PUNCIÓN CAPILAR.	MICROTUBO TAPA LILA PARA PUNCIÓN CAPILAR. TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CON ANTICOAGULANTE K2 EDTA, IRROMPIBLE, CAPACIDAD 250 A 500UL, CON EMBUDO DE POLIPROPILENO PARA LA RECOLECCIÓN DE SANGRE.
2503543	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO EN POLIPROPILENO, TAPA ROJA DE SEGURIDAD, SIN GEL PARA PUNCIÓN CAPILAR	MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN CAPILAR DE SANGRE: CONSTA DE UN RESERVORIO PLÁSTICO/POLIPROPILENO IRROMPIBLE DE UNA SOLA PIEZA CON TAPÓN SEGURIDAD INTEGRADO DE COLOR ROJO, CIERRE A PRESIÓN Y APERTURA DE ROSCA; EL BORDE SUPERIOR SIRVE COMO RECEPTÁCULO, LÍNEAS INDICADORAS DE LLENADO Y UN VOLUMEN DE 250 A 500 µL. UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS. ETIQUETA ESTÁNDAR SEGÚN NORMATIVIDAD
2501620	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO DE TIPO EPPENDORF CON TAPA DE	MICROTUBO DE POLIPROPILENO TIPO EPPENDORF CON CIERRE HERMÉTICO Y CAPACIDAD DE 1.5 CC, PARA CONGELACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

							CIERRE HERMÉTICO. CAPACIDAD 1.5ml	
2503986	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-02	MORTERO DE PORCELANA CON VÁSTAGO PARA MACERAMIENTO DE X 180mm-150ml	MORTERO DE PORCELANA CON VÁSTAGO PARA MACERAMIENTO DE X 180mm- 150ml. DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, DILATACIÓN DE CALOR MÍNIMA, ELEVA DA RESISTENCIA CONTRA CAMBIO DE TEMPERATURA. FABRICADO SEGÚN NORMA DIN 12906
2503825	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	ORGANIZADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO: BASTIDORES DE TUBOS CÓNICOS EMERGENTES MÍNIMO 15 TUBOS	ORGANIZADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO: BASTIDORES DE TUBOS CÓNICOS EMERGENTES; HECHOS EN POLIPROPILENO DISEÑADOS PARA CAPACIDAD DE MINIMO 15 TUBOS DE 15ml. MEDIDAS: ALTURA: 2-7/8", LONGITUD: 10", ANCHO 5 3/8". PARA USAR CON TUBOS DE ENSAYO. REF: HS24320B. HTTP://ESPANOL.GRAINGER.COM/PRODUCT/HEATHROW-SCIENTIFIC-RACK-6PTK6
2502489	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.002	DISCOS DE PAPEL PARA FILTRAR DE 12,5CM DE DIÁMETRO	DISCOS DE PAPEL PARA FILTRAR DE 12,5CM DE DIÁMETRO
2501414	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.002	PAPEL FILTRO X 50mm PARA LABORATORIO	PAPEL SEMIPERMEABLE DE CELULOSA U OTROS COMPUESTOS DE FIBRA DE VIDRIO DE DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS DE 50mm
2505127	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	RO	A.02.02.01.003.006	PELÍCULA/LAMINA SEMITRANSPARENTE PARAFINADA, FLEXIBLE, MALEABLE Y EXTENSIBLE, SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE. ROLLO DE 10CMX38M	PELÍCULA/LAMINA DE MATERIAL SEMITRANSPARENTE A BASE DE POLIOLEFINA Y CERA PARAFINADA, ESPESOR 220MM, FLEXIBLE, MALEABLE Y EXTENSIBLE A 200%, QUE SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE, RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS, BASES, SOLUCIONES ALACLINAS Y OTROS. TEMPERATURA DE USO-45°C A LOS +50°C. PERMEABLE AL GAS. USADO COMO BARRERA PARA LA HUMEDAD. PRESENTACIÓN: ROLLO DE 4" (10.16CM) X 125 PIES (38.10M).
2503841	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	CRIOVIALES CON LIQUIDO CRIOGÉNICO Y PERLAS DE PORCELANA POROSA	CRIOVIALES CON LIQUIDO CRIOGÉNICO Y PERLAS DE PORCELANA POROSA, QUE PERMITEN LA REUTILIZACIÓN DE LA MISMA GENERACIÓN MICROBIANA EN U PERFRINGES, SPOROGENES), AL TRATARSE SIEMPRE DE PRIMERA GENERACIÓN. RELLENOS CON 18ml DE UN MEDIO QUE CONTIENE AGENTES REDUCTORES PCE

2503878	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-000-003-02	PINZA EN MADERA PARA SOPORTE TUBOS DE ENSAYO	PINZA EN MADERA PARA SOPORTE DE TUBOS DE ENSAYO, DE 2 HASTA 25mm. CON RESORTE PARA LA MANIPULACION DE TUBOS CALIENTES O PARA PONER E N CONTACTO EL TUBO CON LA LLAMA. REF1: 816/1
2501662	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETA PASTEUR PLÁSTICO X 3ml, CON PERA DE PIPETEO INTEGRADA	PIPETA PASTEUR PLÁSTICA DE 3ml. ELEVADA REPRODUCTIBILIDAD DEL NÚMERO DE GOTAS X ml, IDEALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DE R. CON PERA DERADIACION GAMMARADIACION GAMMA
2501420	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETAS FABRICADAS EN POLIESTIRENO CON SISTEMA DE CIERRE-CERO	PIPETAS PARA VSG DE CERO AUTOMÁTICO. MÉTODO WESTERGREEN. USO MANUAL POLIESTIRENO DESCARTABLE.
2501381	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETAS PLÁSTICAS	PIPETA PLÁSTICA EN POLIETILENO DE 1,0 A 3,0 ml.
2503255	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	PROBETA PLÁSTICA GRADUADA DE 1000ml	PROBETA GRADUADA USADA PARA LA MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE TODA CLASE DE LÍQUIDOS, BASE HEXAGONAL Y/O PENTAGONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD.
2503234	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 50 ML EN VIDRIO EN VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO, CON O SIN TAPÓN	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 50 ml EN VIDRIO EN VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO, CON O SIN TAPÓN
2504376	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 500 ML EN VIDRIO EN VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO, CON O SIN TAPÓN	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 500 ml EN VIDRIO EN VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO, CON O SIN TAPÓN
2502186	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	PUNTA PLÁSTICA AMARILLA DESECHABLE	PUNTA AMARILLA DE AJUSTE PERFECTO, DESECHABLE DE PIPETA AUTOMÁTICA PARA ASPIRAR Y DISPENSAR LÍQUIDOS ENTRE 5 HASTA 2000UL PARA PIPETAS COMPATIBLES CON LA MARCA (HUMAN, BOECO, SOCOREX, BRAND)
2501651	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.004.008	PUNTA DE PIPETA AZULE UNIVERSAL, PARA ASPIRAR	PUNTA DE PIPETA AZULE UNIVERSAL, DE 70 mm DE LONGITUD, EN POLIPROPILENO PARA ASPIRAR Y DISPENSAR LÍQUIDOS ENTRE 100 HASTA 1000UL

							Y DISPENSAR ENTRE 100 HASTA 1000UL	PARA PIPETAS (HUMAN, BOECO, SOCOREX, BRAND)
2501830	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	BOL	A.02.02.01.004.008	PUNTAS BLANCAS DESECHABLES BOLSA X 1000 UNIDADES	PUNTAS PLÁSTICAS BLANCAS DESECHABLES, CON AJUSTE PERFECTO PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN ENTRE 1 Y 10 MICROLITOS (COMPATIBLES CON PIPET A HUMAN, BRAND, BOECO)
2584004	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% KOH FRASCO X 500ml	SOLUCIÓN PARA LA DISOLUCIÓN DE QUERATINA Y ACLARACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE HONGOS
2502958	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA RECOLECTAR MATERIA FECAL	RECIPIENTE PLÁSTICO CON ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN, ESPECIAL PARA RECOLECTAR MATERIA FECAL
2501521	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA DESCARTAR PUNTAS	RECIPIENTE PLÁSTICO DESCARTAR PUNTAS PLÁSTICO CUADRADO PARA USO DEL LABORATORIO
2505951	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN ESTÁNDAR, CLORURO SÓDICO 500ml	SOLUCIÓN ESTÁNDAR, CLORURO SÓDICO 500ml
2501663	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.004	TIRAS DE GLUCOMETRÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL EN UN SOLO USO X 50 UNIDADES	TIRAS DE GLUCOMETRÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL EN UN SOLO USO X 50 UNIDADES
2501256	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO, TAPA AMARILLO CON GEL, CON CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO DESDE 5.0 A 6.0ml	TUBO PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACÍO, AMARILLO CON GEL SEPARADOR, CON CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO CAPACIDAD DE 5,0ml 13X100mm Y/O 13*75*3.0ml - 6.0 ml-5.0 ml.
2504960	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE PLÁSTICO PARA SEPARACIÓN	TUBO DE PLÁSTICO PARA SEPARACIÓN DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 4ml.

							DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 4 ml.	
2501669	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLASTICO TAPA LILA, CON EDTA K2, CAPACIDAD DE 2-3ml PEDIÁTRICO	TUBO DE PLÁSTICO EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAPÓN CONVENCIONAL, COLOR LILA, CON ANTICOAGULANTE EDTA K2, IRROMPIBLE CON LÍNEA D E LLENADO. CAPACIDAD DE 2-3ml. PEDIÁTRICO
2502194	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE VIDRIO SIN TAPA DE 12 mm X 75 mm, 13 X 10 mm	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO TRANSPARENTE, DE BORDE RECTO Y BASE REDONDEADA, DE 12 mm X 75 mm, 13 X 100 mm SIN TAPA. RESISTENTE AL
2587156	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE ALMACENAR MUESTRA CON TAPON12X75	TUBOS DISEÑADOS PARA EL PROCESAMIENTO DEMUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO Y SU POSTERIOR ANÁLISIS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO
2504961	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO DE ENSAYO PARA LABORATORIO, VIDRIO FLAMEABLE (REFRACTARIO) DE: 12 X 75 mm	TUBO DE ENSAYO PARA LABORATORIO, VIDRIO FLAMEABLE (REFRACTARIO) DE: 12 X 75 mm
2504962	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO DE ENSAYO PARA LABORATORIO, VIDRIO FLAMEABLE (REFRACTARIO) DE 13X100mm	TUBO DE ENSAYO PARA LABORATORIO, VIDRIO FLAMEABLE (REFRACTARIO) DE 13X100mm
2584019	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO POLIPROPILENO 12X75mm CON TAPA HERMÉTICA QUE RESISTAN 80°C DE CALENTAMIENTO	TUBO POLIPROPILENO 12X75mm CON TAPA HERMÉTICA, QUE RESISTAN 80°C DE CALENTAMIENTO, NO ESTÉRIL
2505649	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO DE ENSAYO POLIPROPILENO DIMENSIÓN 13X100mm	TUBO DE ENSAYO POLIPROPILENO DE 13X100mm, VOLUMEN 7ml, DIAMETRO INTERIOR 11,0 ml. DIÁMETRO EXTERIOR 12,7. LONGITUD TOTAL 98,4mm. VOLUMEN MÁXIMO 8,1 ML. UTILIDAD: EL MATERIAL ES APTO PARA CENTRIFUGAS, PARA MÚLTIPLES USOS EN LABORATORIO.

2504629	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO EN VIDRIO RECUBIERTO CON TEREFTALATO DE POLIETILENO (MYLAR)-EXTRACCIÓN DE SANGRE CAPILAR, MAS HEPARINA-LITIO. TAPÓN BLANCO	TUBO EN VIDRIO RECUBIERTO CON TEREFTALATO DE POLIETILENO (MYLAR) PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CAPILAR, MAS HEPARINA DE LITIO. CONSTA DE ANÁLISIS DE SANGRE CON LAS TARJETAS DEL SISTEMA EPOC. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2501267	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBOS DE SEDIMENTACIÓN WINTROBE DE VIDRIO DE 0-100 PARA VSG	TUBOS DE VIDRIO SÓDICO - CÁLCICO CON UN DIÁMETRO DE 3mm. GRADUADO EN mm EN UNA ESCALA NUMERADA DE 0 A 10 CM, CON FONDO REDONDO, BORDE RECTO PARA PROCESAR VSG
2502396	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD AZUL, CON CITRATO DE SODIO AL 3.2% CAPACIDAD 4.5ml. ADULTO	TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD AZUL, CON ANTICOAGULANTE DE CITRATO DE SODIO A UNA CONCENTRACIÓN DE 3.2 %, IRROMPIBLE, CON LÍNEA DE LLENADO Y CAPACIDAD DE 4.5ML
2501259	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD AZUL, CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%. CAPACIDAD 2.7ml PEDIÁTRICO	TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD AZUL, CON ANTICOAGULANTE DE CITRATO DE SODIO A UNA CONCENTRACIÓN DE 3.2 %, IRROMPIBLE, CON LÍNEA DE LLENADO Y CAPACIDAD DE 2.7ml.
2500841	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO CON SISTEMA AL VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA, CON EDTA K2, CAPACIDAD DE	TUBO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA, CON ANTICOAGULANTE EDTA K2, IRROM PIBLE Y CON LÍNEA DE LLENADO, CAPACIDAD DE 4.0-5.0M

							4.0-5.0ml. ADULTO	
2504545	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO, CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR VERDE, ANTICOAGULANTE HEPARINA DE SODIO O DE LITIO, CAPACIDAD 4-5ml	TUBO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR VERDE, CON ANTICOAGULANTE HEPARINA DE SODIO O DE LITIO APLICADA POR ASPERSIÓN, IRROMPIBLE Y CON LÍNEA DE LLENADO, SE UTILIZA PARA LA DETERMINACIÓN DE QUÍMICA CLÍNICA EN PLASMA. TAMAÑO 13X75, CAPACIDAD DE 4.0-5.0M
2502589	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, TAPA ROJA ADULTO, TAPÓN CONVENCIONAL	TUBO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, TAPÓN CONVENCIONAL ROJO, SIN ACTIVADOR DE COAGULO, CON CAPACIDAD DE 4.0-7.0 CC DE 13 mm X 100 mm ETIQUETAS COLORES
2503416	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO, TAPA ROJA, CAPACIDAD 3-6ml. PEDIÁTRICO	TUBO PLÁSTICO TAPÓN CONVENCIONAL ROJO, CAPACIDAD 3-6ML DE 13mm X 75mm. PEDIÁTRICO. ETIQUETA NORMA ISO 6710 (CÓDIGO DE COLORES)
2501678	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO TAPA ROSCA DE VIDRIO BOROSILICATADO	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CON TAPA ROSCA 10 A 13 ml PARA TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS REUTILIZABLE. RESISTENTE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN LAVABLES
2503619	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO TAPA ROSCA DE VIDRIO 16ml, EN BOROSILICATO, AUTOCLAVABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CON TAPA ROSCA 16 mm X 125 mm PARA TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS REUTILIZABLE. RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BAJA DILATACIÓN TÉRMICA, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ROSCADOS CON TAPONES NEGROS DE ROSCA Y ARANDELA, AUTOCLAVABLE, SIN GRADUACIÓN. 16ml
2505086	41100000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLASTICO TAPA GRIS DE 4 ml PARA CONSERVACIÓN DE ORINAS	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO. FONDO REDONDO, TAPÓN GRIS DE SEGURIDAD. DIMENSIONES: 13 X 75mm, CON PRESERVANTE "ÁCIDO BÓRICO, FORMATO DE SODIO Y BORATO DE SODIO". USO: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA

								ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2502642	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAPA AZUL, CON ANTICOAGULANTE, CAPACIDAD 4.5ml ADULTO	TUBO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAPA AZUL, QUE CONTENGA ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO A UNA CONCENTRACIÓN DE 3.2%, IRROMPIBLE, CON LÍNEA DE LLENADO Y CAPACIDAD DE 4.5ml
2502643	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A-02-02-01-003-007-01	TUBO VIDRIO, SISTEMA AL VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA, CON EDTA K2	TUBO EN VIDRIO, CON SISTEMA DE VACÍO, TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA, CON ANTICOAGULANTE EDTA K2, IRROMPIBLE Y CON LÍNEA DE LLENADO, CAPACIDAD DE 4.0-5.0M
2504597	41104107	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.004	UNIVERSAL QPCR MAXTER MIX, TAMAÑO 200 RXN (2 X 1 ml). PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE QPCR RÁPIDA	UNIVERSAL QPCR MAXTER MIX, TAMAÑO 200 RXN (2 X 1 ml). PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE QPCR RÁPIDA, SENSIBLE Y PRECISA, BASADAE N COLORANTE DE LAS SECUENCIAS DE DNA Y CDNA DIANA.
2501403	41104118	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-06	C/U	A.02.02.01.003.006	VIALES CON TAPA ROSCA DE 1.5ml, PARA ALMACENAR MATERIAL BIOLÓGICO. ESTÉRIL	VIALES CON TAPA ROSCA DE 1.5ml, PARA ALMACENAR MATERIAL BIOLÓGICO. EN POLIPROPILENO GRADUADOS, DIÁMETRO EXT. 12,5mm, FONDO EN U. F ESTÉRIL
MICROBIOLOGIA								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de a rtículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502609	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR MULLER HILTON PLACA ESTÉRIL LISTA PARA USAR	MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN MICROORGANISMOS AEROBICOS POR EL MÉTODO DE UNIDADES
2504637	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR EN POLVO MYCOSEL	BASE PARA MEDIO SELECTIVO PARA AISLAR HONGOS PATÓGENOS, POLVO PARA AÑADIR AGUA PURIFICADA.

							BASE, ESTÉRIL, FRASCO X 500G	
2501598	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	FCO	A.02.02.01.003.005	AGAR SABOURAUD, PARA AISLAMIENTO Y CULTIVO DE HONGOS (LEVADURA, MOHOS Y DERMATOFITOS)	AGAR SABOURAUD, PARA AISLAMIENTO Y CULTIVO DE HONGOS (LEVADURA, MOHOS YDERMATOFITOS). ESTÉRIL. FRASCO X 500G DE AGAR POLVO
2501588	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR BASE PARA AISLAMIENTO DE SALMONELLA SHIGUELLA, ESTÉRIL, EN FRASCO	AGAR EN POLVO PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE SALMONELLA - SHIGUELLA, ESTÉRIL EN FRASCO
2503254	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR SANGRE BASE X 500G. PARA EL AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS	AGAR SANGRE BASE X 500G. MEDIO DE USO GENERAL PARA EL AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS EN POLVO
2501601	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR SANGRE CORDERO, ESTÉRIL, LISTO PARA USAR	PLACA DE AGAR SANGRE DE CORDERO ESTÉRIL, CON ALTA SENSIBILIDAD PARA LA DETECCIÓN DE HEMOLISIS.
2501596	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR TAYER MARTIN, ESTÉRIL, LISTO PARA USAR	CAJA DE PETRI LISTA PARA SU USO, PLACA DE AGAR TAYER MARTIN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPECIES DE NEISSERIA, MÍNIMO DE 15ml Y 5mm DE PROFUNDIDAD, ESTÉRIL
2505958	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	AGAR TRIPTICASA/TRIPTONA DE SOYA 500g	AGAR TRIPTICASA/TRIPTONA DE SOYA 500g RQ. 5000057137 REF. 7043500 HTTPS://WWW.BIOSER.COM/PRODUCTOS/TRYPTO-CASEIN-SOY-AGAR-TSA-74P/
2502553	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	CALDO BIH: MEDIO DE CULTIVO LISTO PARA SU USO, CALDO INFUSIÓN CEREBRO CORAZON	BRAIN HEART INFUSIÓN (B.H.I), INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN, ES UN MEDIO LÍQUIDO, DE ENRIQUECIMIENTO INDICADO SU USO PARA EL CULTIVO DE UNA GRAN VARIEDAD DE MICROORGANISMOS EXIGENTES NUTRICIONALMENTE, TANTO AEROBIOS COMO ANAEROBIOS, ASÍ COMO DE HONGOS Y LEVADURAS, TANTO DE MUESTRAS CLÍNICAS COMO NO CLÍNICAS.

2503168	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	CALDO SELECTIVO DESTINADO PARA LA DETECCIÓN DE ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B	CALDO SELECTIVO CON ANTIBIÓTICOS PARA CULTIVAR ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B.
2505107	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	CALDO MEDIO CULTIVO TIOGLICOLATO (NIH)	CALDO MEDIO CULTIVO TIOGLICOLATO (NIH), MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO PARA DETECTAR MICROORGANISMOS EN MATERIALES ESTÉRILES Y ES UNA ALTERNATIVA PARA PRODUCTOS QUE NO PUEDEN CULTIVARSE FÁCILMENTE DEBIDO A LA VISCOSIDAD.
2502959	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	CALDO SELENITO FCO X 500G PARA EL CRECIMIENTO DE SALMONELLA	MEDIO ENRIQUECIDO PARA EL CRECIMIENTO DE SALMONELLA SPP. MEDIO PREPARADO, AMBAR CLARO, TRASLUCIDO. EN HECES YORINA
2503830	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CLINDAMICINA: DISCOS DE 2Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE CLINDAMICINA: DISCOS DE 2Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDE IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.
2503827	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	DISCO DE SENSIBILIDAD DETECCIÓN DE BETALACTAMASA CEFINASA: DISCOS DE 6mm, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	DISCO DE SENSIBILIDAD DETECCIÓN DE BETALACTAMASA CEFINASA: DISCOS DE 6mm, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADO SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO ENA 622
2503833	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CEFOTAXIME: DISCOS DE 30Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE	SENSIDISCO DE CEFOTAXIME: DISCOS DE 30Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDEN IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.

							DE ALTA CALIDAD	
2503832	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CEFOXITINA: DISCOS DE 30mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE CEFOXITINA: DISCOS DE 30Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDEN IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.
2503835	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CEFTAZIDIME: DISCOS DE 30mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE CEFTAZIDIME: DISCOS DE 30mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDE IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.
2503831	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE ERITROMICINA: DISCOS DE 15mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE ERITROMICINA: DISCOS DE 15mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA ID IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.
2503838	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE ERTAPENEM: DISCOS DE 10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO	SENSIDISCO DE ERTAPENEM: DISCOS DE 10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDENT VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR
2503837	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE MEROPENEM: DISCOS DE 10Mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE	SENSIDISCO DE MEROPENEM: DISCOS DE 10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL REACTIVO, PARA LA IDENT VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR.

							DE ALTA CALIDAD	
2503836	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CEFTAXIDIME/ ÁCIDO CLAVULINICO: DISCOS DE 30/10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE CEFTAXIDIME/ ÁCIDO CLAVULINICO: DISCOS DE 30/10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON ELS EMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO
2503834	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCO DE CEFOTAXIME/A CIDO CLAVULINICO: DISCOS DE 30/10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD	SENSIDISCO DE CEFOTAXIME/ACIDO CLAVULINICO: DISCOS DE 30/10mcg, FABRICADOS DE PAPEL ABSORBENTE DE ALTA CALIDAD, IMPREGNADOS CON EL R SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DIFUSIÓN DE DISCO ENA
2501444	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOCULTIVO ADULTO, ESTÉRIL, LISTO PARA USAR	BOTELLA CON CALDO DE CULTIVO ENRIQUECIDO (BHI) CON RESINA O CARBÓN ACTIVADO PARA LA DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS AEROBIOS PRESENTES EN SANGRE Y LIQUIDOS CORPORALES PARA ADULTOS.
2501445	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO, ESTÉRIL, LISTO PARA USAR	BOTELLA CON CALDO DE CULTIVO ENRIQUECIDO (BIH), CON RESINA O CARBÓN ACTIVADO, PARA LA RECUPERACIÓN DE BACTERIAS AEROBIAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.
2501896	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	LIQUIDO DILUYENTE PARA CONTEO DE ESPERMATOZOIDES	LIQUIDO DE DILUCIÓN AL 1% X 200 ml SATISFACTORIO PARA EL RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES, QUE, POR SU CONTENIDO DE FORMALDEHIDO, INMOVILIZA LOS ESPERMAT RECUENTO
2501559	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	MEDIO DE CULTIVO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AEROBIOS Y ANAEROBIOS EN TUBO	MEDIO TOMA DE MUESTRAS URETRA/NASOFARING. MEDIO DE CULTIVO PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS, PREPARADO, LISTO PARA SU USO PARA MICROORGANISMOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS, EN TUBO; MÁS ESCOBILLON, ESTERILIZADO CON RADIACIONES IONIZANTES. PARA RECOGER MUESTREAS DE

								GARGANTA, VAGINA, BOCA, HERIDAS ENTRE OTROS. REFERENCIA 41 999
2505571	41116011	ZMQX	ZMQX-002	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	RECIPIENTE MÁS MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	MEDIO TRANSPORTE VIRAL TUBO 1.5 - 10 ml EL MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL ESTÁ DESTINADO A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS QUE CONTIENEN VIRUS, MICOPLASMA, ENTRE OTROS, DESDE EL SITIO DE RECOLECCIÓN HASTA EL LABORATORIO DE PRUEBAS. EL MEDIO CONSISTE EN LA SOLUCIÓN DE SALES BALANCEADO, MODIFICADO Y ENRIQUECIDA CON ALBUMINA DE SUERO BOVINO, PEPTONA, CLORURO DE SODIO, DEXTROSA, ENTRE OTROS. TIENE ADICIÓN DE ANFOTERICINA B (FUNGIZONE) Y GENTAMICINA QUE INHIBEN LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y LEVADURAS. EL MEDIO ES ISOTÓNICO Y CARECE DE TOXICIDAD PARA LAS CÉLULAS.
2587175	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	KIT	A.02.02.01.003.005	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA KIT DE 25 LA PRUEBA RAPIDEC® CARBA NP CONSISTE EN UNA TIRA LISTA PARA USAR PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y ACINETOBACTER BAUMANNII, PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASA	PRUEBA RÁPIDA DETECCIÓN CARBAPENEMASA KIT DE 25 LA PRUEBA RAPIDEC® CARBA NP CONSISTE EN UNA TIRA LISTA PARA USAR PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y ACINETOBACTER BAUMANNII, PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASA UTILIZANDO BACTERIAS CULTIVADAS EN UN MEDIO CON AGAR. LA PRUEBA SE BASA EN EL PRINCIPIO DESCRITO POR NORDMANN, POIREL Y DORTET (1, 2). KIT PARA 25 PRUEBAS (REF. 417498) - 25 TIRAS (STR). - 25 AMPOLLAS DE MEDIO DE SUSPENSIÓN API®, 2ml (MED). - 25 TAPAS DE INCUBACIÓN (INCUB). - 1 BOLSITA DE BASTONCILLOS DE MEZCLAR (STK). - 1 SOPORTE BICOLOR (BLANCO Y NEGRO).
2502580	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE GÉRMENES OXIDASA POSITIVA	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE GÉRMENES OXIDASA POSITIVA

2501815	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	ESTOS DISCOS SE UTILIZAN PARA PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS	ESTOS DISCOS SE UTILIZAN PARA PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS COMUNES DE CRECIMIENTO RAP AGAR
2501889	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SENSIDISCOS DE PENICILINA PARA PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD BACTERIANA	SENSIDISCOS DE PENICILINA, ESTOS DISCOS SE UTILIZAN PARA PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO DE PATÓGENOS BACTERIANOS COMUNES DE CRECIMIENTO RAP AGAR
2501556	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTEMA PARA ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS (GRAM +)	SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS (GRAM +) CON CÓDIGO DE ANTIBIOBRAMA CON TABLAS DE LECTURA, CON REACTIVOS E INSUMOS NECE FARLAND
2502202	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTMA DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS	IDENTIFICACIÓN DE GÉRMENES GRAM POSITIVOS (GRAM +) CON CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN, CON TABLAS DE LECTURA, CON REACTIVOS E INSUMOS NEC)
2502174	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS INCLUYE URINARIOS	IDENTIFICACIÓN DE GÉRMENES URINARIOS, CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN CON TABLAS DE LECTURA, CON REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CADAP FARLAND)
2502172	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	SISTEMA PARA ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS INCLUYE URINARIOS	SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES URINARIOS CON CÓDIGOS DE ANTIBIOGRAMA CON TABLAS DE LECTURA, CON REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA C FARLAND)

2501450	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS (GRAM -), INCLUYE URINARIOS.	SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS (INCLUYE URINARIOS), PANELES O TARJETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA MICROBIANA POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITARIO (MIC) GRAM NEGATIVOS, DEBE INCLUIR PRUEBA CONFIRMATORIA DE BETALACTAMASA (BLEE), LISTADO DE ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE ACTUALIZADOS SEGÚN NORMA CLSI VIGENTE
2502607	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDAD/ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS (GRAM +) PRUEBA	SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS, PANELES O TARJETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA MICROBIANA POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITARIO (MIC) GRAM POSITIVOS, DEBE INCLUIR PRUEBA CONFIRMATORIA DE OXACILINA (CEFOXITIN), PRUEBA DE RESISTENCIA INDUCIBLE EN MACRÓLIDOS, PRUEBA DE BETALACTAMASA, LISTADO DE ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE ACTUALIZADOS SEGÚN NORMA CLSI VIGENTE. INCLUYE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS.
2501451	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS, (GRAM +)	TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE GÉRMENES GRAM POSITIVOS. CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRUEBA
2501800	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS Y HONGOS. PRUEBA AUTOMATIZADA MAS INSUMOS	IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE LEVADURAS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA
2501484	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA NEISERIA HAEMOPHYLUS	PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE NEISERIA Y HAEMOPHYLUS CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO.

2504655	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDAD GÉRMENES GRAM (-) MAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA	SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS, PANELES O TARJETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA MICROBIANA POR CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITARIO (MIC) GRAM NEGATIVOS, DEBE INCLUIR PRUEBA CONFIRMATORIA DE BETALACTAMASA (BLEE), LISTADO DE ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE ACTUALIZADOS SEGÚN NORMA CLSI VIGENTE. INCLUYE TODOS LOS INSUMOS.
2505018	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA PARA STREPTOCOCCU	TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA PARA STREPTOCOCCUS, PRUEBA IN VITRO PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD DE S. PNEUMONIAE, ESTREPTOCOCO BETA-HEMOLITICO Y STREPTOCOCCUS VIRIDANS A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS
2501491	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	C/U	A.02.02.01.003.005	TARJETA/PANEL IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES (GRAM -) + GÉRMENES URINARIOS	TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA
2501530	41116011	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-07	KIT	A.02.02.01.003.005	TARJETA O PANEL SENSIBILIDAD PARA LEVADURAS Y HONGOS. PRUEBA AUTOMATIZADA + INSUMOS Y REVELADORES	IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA PARA LEVADURAS Y HONGOS MÁS LOS INSUMOS Y REVELADORES REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA

MICROSCOPIA

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501602	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	FCO	A.02.02.01.003.005	SUSPENSIÓN DE AZUL DE LACTOFENOL AL 0,5% PARA LA	SUSPENSIÓN DE AZUL DE LACTOFENOL AL 0,5% PARA LA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE ESTRUCTURAS DE HONGOS

							OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE ESTRUCTURAS DE HONGOS	
2501607	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	FCO	A.02.02.01.003.005	EOSINA DEL 0,5 AL 1% EN AGUA DESIONIZADA PARA ESPERMOGRAMA. FCO X 100ml	SOLUCIÓN DE EOSINA AMARILLENTA DEL 0,5 AL 1% EN AGUA DESIONIZADA PARA ESPERMOGRAMA. SOLUCIÓN LISTA PARA USAR
2501641	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	LAMINA ESTANDARIZADA PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO	LAMINA ESTANDARIZADA PARA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO. CAJA DE 100 LÁMINAS X 10 DETERMINACIONES
2501654	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	RO	A.02.02.01.003.005	ROLLO DE CINTA PARA INDICAR EL PH DE 1-14	ROLLO DE PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE PH EN UN RANGO ENTRE 1-14
2501442	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETA ESTANDARIZADA PARA SEDIMENTO URINARIO	PIPETAS PLÁSTICAS ESTANDARIZADA DE SEDIMENTO URINARIO. COMPATIBLE CON TUBO ESTANDARIZADO PARA LECTURA
2502964	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DIFERENCIACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES.	REACTIVO PARA LA DIFERENCIACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES. FRASCO X 500ml
2505972	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN MATERIA FECAL.	REACTIVO LISTO PARA USAR, PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN MATERIA FECAL NO REQUIERE CALENTAMIENTO.
2501577	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL. PRUEBA. EN CASSETTE	PRUEBA RÁPIDA INDIVIDUAL INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL. SIN DIETA. KIT COMPLETO

2501558	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	TABLETAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN MATERIA FECAL	TABLETAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN MATERIA FECAL
2504791	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	TIRAS REACTIVAS PARA LECTURA MANUAL/VISUAL 10 PARÁMETROS	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE UROANÁLISIS, MÍNIMO DE: 10 PARÁMETROS.
2500099	41116010	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.005	TIRAS PARA UROANÁLISIS PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y/O SEMIAUTOMATIZADOS.	TIRAS DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA MÍNIMO DE PH, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, GLUCOSA, CUERPOS CETÓNICOS, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, SANGRE EN ORINA, GRAVEDAD ESPECÍFICA.
2502437	41104108	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-08	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PLÁSTICO CÓNICO DE 12ml DE 17 X 105mm, PARA ANÁLISIS ESTANDARIZADO DE SEDIMENTO URINARIO.	TUBO PLÁSTICO CÓNICO DE 12ml DE 17 X 105mm, PARA ANÁLISIS ESTANDARIZADO DE SEDIMENTO URINARIO.
MOLECULAR								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2502505	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR DE PESO MOLECULAR ESCALERA DE 50 PB PARA ELECTROFORESIS EN AGAROSA	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 50 PARES DE BASES, PARA ELECTROFORESIS DE DNA EN GELES DE AGAROSA.GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (KIT O VIAL) ESCALERA DE 50 A 800 PB
2503572	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	AGAROSA, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, PARA	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, PARA ELECTROFORESIS, LIBRE DE RNASA, DNASAS. ESPECIFICACIÓN: TEMPERATURA DE GELIFICACION: ENTRE 34,5°C A 39°C DUREZA DEL

							ELECTROFORESIS, LIBRE DE DNAASA/RNASAS. FRASCO/BOLX500g	GEL (AL 1%): >1200g/CM2 HUMEDAD: < (><<)> 10% TEMPERATURA DE FUSIÓN: >85°C. FRASCO/BOLSA X 500g
2501552	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	AGAROSA ULTRAPURA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR PARA ELECTROFORESIS, FRASCO O BOLSA	AGAROSA ES AGAROSA DE PUNTO DE FUSIÓN ESTÁNDAR, DISEÑADO PARA EL ANÁLISIS DE RUTINA DE LA SEPARACIÓN DEL ADN Y FRAGMENTOS DE ARN ENE PCRY OTROS APLICACIONES: EN-GEL DE LA LIGADURA Y LA TRANSFORMACIÓN. EN-GEL APLICACIONES: EN-GEL DE LA LIGADURA Y LA TRANSFORMACIÓN OTROS
2502410	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	BOL	A.02.02.01.003.004	AGUA DESTILADA LIBRE DE IONES X 500ml	AGUA DESTILADA PH 6-7, CONDUCTIVIDAD MÁXIMA 0.1 LIBRE DE IONES. AGUA ULTRAPURA LIBRE DE RNAS Y DNASAS
2502393	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ALBUMINA BOVINA AL 30% USO: INMUNOHEMATOLOGÍA	ALBUMINA BOVINA AL 30% USO: INMUNOHEMATOLOGÍA
2501856	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	BUFFER DE CARGA PARA ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA	CÓDIGO ONU: 41105317. EL BUFFER DE CARGA PARA ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA PROPORCIONA DENSIDAD A LA MUESTRA, PERMITIENDO QUE CAI APROXIMADA ENTE EN UNA
2501417	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 250ml PARA CULTIVO DE 75CM². EN POLIESTIRENO, ESTÉRIL	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 250ml PARA CULTIVO DE 75CM3. EN POLIESTIRENO GRADO CRISTALINO PARA CULTIVO CELULAR, ESTÉRIL, NO PIRÓGENOS
2501416	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	CAJAS PARA CULTIVO CELULAR DE 50ml, EN POLIESTIRENO GRADO CRISTALINO, ESTÉRIL	CAJAS PARA CULTIVO CELULAR DE 50ml PARA CULTIVO DE 25CM3. EN POLIESTIRENO GRADO CRISTALINO PARA CULTIVO CELULAR, ESTÉRIL, NO PIRÓGENOS
2503394	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.001.006	CELDA DE CUARZO 50mm	CELDA DE CUARZO 50mm DE PASO ÓPTICO

							DE PASO ÓPTICO	
2505129	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	CLORANFENICOL ANTIBIÓTICO PARA CULTIVOS GRADO REACTIVO A UNA PUREZA IGUAL O MAYOR AL 98%. FRASCO X 5g	ANTIBIOTICO PARA CULTIVOS GRADO REACTIVO A UNA PUREZA IGUAL O MAYOR AL 98%. FORMULA MOLECULAR C11H12CL2N2O5. PESO MOLECULAR 323.1 E1% (278 NM) = 298 (WATER)1. CAS 56-75-7 ANTIBIÓTICO SINTÉTICO DE AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD. PESO MOLECULAR CONTRA BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Y NEGATIVAS. USO: EN BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA SELECCIÓN DE BACTERIAS. CERTIFICADOS DE ANÁLISIS
2501867	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	CLORURO DE SODIO GRADO BIOLOGÍA MOLÉCULA	CLORURO DE SODIO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. FRASCO POR 2.5kg
2501860	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	COLORANTE PARA TINCIÓN DE GEL DE AGAROSA 10000X FRASCO X 400uL	COLORANTE PARA TINCIÓN DE GEL DE AGAROSA 10000XFRASCO X 400uL
2502440	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	CUANTIFICADOR DE DNA SISTEMA PARA CUANTIFICACIÓN DIRECTA DE DNA POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV	CUANTIFICADOR DE DNA SISTEMA PARA CUANTIFICACIÓN DIRECTA DE DNA POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV, QUE UTILICE MENOS DE 10 UL DE MUESTRA ORI GINAL
2503573	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS TRIFOSFATO PARA PCR - DATP, DCTP, DGTP, DTTP - SAL DE SODIO, ESTÉRILES, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, 100mm C/DNTP	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. DESOXIRRIBONUCLEÓTIDOS TRIFOSFATO, EN VIAL INDIVIDUAL, C/U A 100 UM, 250 UL, 25 UMOLES DATP: 2´-DEOX IADENOSINA 5´ (TETRAHIDROGEN TRIFOSFATO), 100 MM X 250 UL DCTP: 2´-DEOXICITIDINA 5´ (TETRAHIDROGEN TRIFOSFATO), 100 MM X 250 UL DGTP:2 ´-DEOXIGUANISINA 5´ (TETRAHIDROGEN TRIFOSFATO), 100 MM X 250 UL DTTP: 2´-DEOXITIMIDINE 5´ (TETRAHIDROGEN TRIFOSFATO), 100mm X 250 ULN EUTRALIZADOS CON HIDRÓXIDO DE SODIO / SALES DE SODIO PH 7,0 PUREZA MAYOR AL 99% (POR HPLC). KIT DE 4 VIALES
2501865	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	REACTIVO ALCOHOL ETÍLICO GRADO ANALÍTICO	REACTIVO ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO (C2H5OH) GRADO ANALÍTICO, UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE EXTRACCIÓN DEADN

2501861	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	L	A.02.02.01.003.004	ACIDO ETILEN DIAMINOTETRA CETICO (EDTA) GRADO MOLECULAR 1000ml	CÓDIGO ONU: 12352106. ACIDO ETILEN DIAMINOTETRACETICO (EDTA) GRADO MOLECULAR SOLUCIÓN 0,5M PH 8,0 X 1 LITRO
2501553	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ENZIMAS DE RESTRICCIÓN NCO L REF R 0193L X 500 UND/VIAL	ENZIMA DE RESTRICCIÓN RECOMBINANTE, SUMINISTRADA CON BUFFER DEL FABRICANTE.
2501623	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ENZIMAS DE RESTRICCIÓN EAE L R 05008 X 1000 UND/VIAL	ENZIMA DE RESTRICCIÓN RECOMBINANTE, SUMINISTRADA CON BUFFER DEL FABRICANTE.
2501434	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ESTUCHE DE ANTÍGENO PARA TRIPANOSOMA CRUZI CON CEPAS COLOMBIANAS PARA INMUNOFLUOR ESCENCIA INDIRECTA (PAQUETE X 15 LÁMINAS)	ESTUCHE DE ANTÍGENO PARA TRIPANOSOMA CRUZI CON CEPAS COLOMBIANAS PARA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA. PAQUETE X 15 LAMINAS
2502448	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	FENOLFTALEIN A INDICADOR DE VALORACIONES ACIDO-BASE. SOLIDO BLANCO INODORO, SUS CRISTALES SON INCOLOROS	FENOFTALEINA INDICADOR DE VALORACIONES ACIDO-BASE. SOLIDO BLANCO INODORO, SUS CRISTALES SON INCOLOROS. PARA USOS DE LABORATORIO EN A FINA
2501864	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO 25:24:1 PARA EXTRACCIÓN DE ADN	CÓDIGO ONU: 41105514. FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO 25:24:1 PARA EXTRACCIÓN DE ADN
2503613	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	BT	A.02.02.01.003.004	FLUOROSCYTO SINE ANTIMICOTICO	FLUOROSCYTOSINE ANTIMICÓTICO PARA CULTIVOS F-7129-5g SIGMA. "4-AMINO-5- FLUORO-2 (1H) PIRIMIDINONA; LA FLUCITOSINA".

							PARA CULTIVOS. SE UTILIZA EN LOS ESTUDIOS SOBRE BIOSINTESIS DE TMP. BOTELLA POLI X 1.5g	C 4 H 4 FN 3 O. SE UTILISA EN LOS ESTUDIOS SOBRE BIOSINTESIS DE TMP. BOTELLA POLI X 1.5g
2503571	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	GLICEROL 99,5%; PARA CULTIVO CELULAR, REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. BOTELLA X 500ml	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. GLICEROL, GLYCEROL, 1,2,3-PROPANETRIOL, GLYCERIN, HOCH2CH(OH)CH2OH CAS NO: 56-81-5 REACTIVO PARA C ULTIVO CELULAR. LIQUIDO VISCOSO INCOLORO PUERZA: > 99,5% POR GC METALES PESADOS < (><<)> 5 PPM AGUA (KARL FISHER) < (><<)> 0,1% ADECUA DO COMO COMPONENTE PARA CULTIVO CELULAR. BOTELLA X 500ml "
2501438	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	GLOBULINA DE CABRA ANTI IGG HUMANO FRASCO DE 1 CC	GLOBULINA DE CABRA ANTI IGG HUMANO, MARCADO CON ISOTIOCIANATO DEB FLUORESCEINA, PARA IFI (INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA). SIRVE PARA REVELAR IGG HUMANA FIJADA SOBRE LOS ANTÍGENOS DE LOS PORTAS. FRASCO X 1ml. REF: REF 75 692
2503225	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	HP VIRAL NUCLEIC ACID KIT, PARA USO CON CICLADORES TERMICOS CONVENCIONALES	HP VIRAL NUCLEIC ACID KIT QUE CONTIENE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LAS REACCIONES DECDNA PARA SU USO CON CICLADORES TÉRMICOS CONVENCIONALES Y LOREAL REF. M665A46
2503574	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	INICIADORES/PRIMERS PARA PCR SINTETIZADOS POR DEMANDA, DESALADOS, ESCALA DE 100NMOL	PRODUCTO BIOLÓGICO PARA USO EN LABORATORIO (RUO) INICIADORES PARA PCR SINTETIZADOS POR DEMANDA. (PRIMER`S, OLIGOS INICIADORES, CEBAD ORES PARA PCR) ESPECIFICACIONES: DESALADOS, DESPROTEGIDOS, LIOFILIZADOS ESCALA DE SÍNTESIS 100 NMOLES SOLICITUD DE SÍNTESIS POR BAS E SINTETIZADA DE ACUERDO CON SECUENCIA SUMINISTRADA. UNIDAD DE MEDIDA: BASE SINTETIZADA EN ESCALA DE 100 NMOLES PRODUCTO BIOLÓGICO P ARA USO EN LABORATORIO (RUO) INICIADORES PARA PCR SINTETIZADOS POR DEMANDA. (PRIMER`S, OLIGOS INICIADORES, CEBADORES PARA PCR) ESPEC IFICACIONES: DESALADOS, DESPROTEGIDOS, LIOFILIZADOS ESCALA DE

								SÍNTESIS 100 NMOLES SOLICITUD DE SINTESIS POR BASE SINTETIZADA DE ACU
2503575	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	INICIADORES/PRIMERS PARA PCR SINTETIZADOS POR DEMANDA, PURIFICADOS POR HPLC, ESCALA DE 10 NMOLES	PRODUCTO BIOLÓGICO PARA USO EN LABORATORIO (RUO) INICIADORES PARA PCR SINTETIZADOS POR DEMANDA. (PRIMER`S, OLIGOS INICIADORES, CEBAD ORES PARA PCR) ESPECIFICACIONES: DESALADOS, DESPROTEGIDOS, LIOFILIZADOS, PURIFICADOS POR HPLC ESCALA DE SÍNTESIS 10 NMOLES SOLICITU D DE SÍNTESIS POR BASE SINTETIZADA DE ACUERDO CON SECUENCIA SUMINISTRADA. UNIDAD DE MEDIDA: BASE SINTETIZADA EN ESCALA DE 10 NMOLES
2505128	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	KANAMICINA SULFATO POR 5 GRAMOS. ANTIBIÓTICO PARA CULTIVOS GRADO REACTIVO A UNA PUREZA IGUAL O MAYOR AL 98%.	KANAMICINA SULFATO POR 5 GRAMOS. ANTIBIÓTICO PARA CULTIVOS GRADO REACTIVO A UNA PUREZA IGUAL O MAYOR AL 98%. PESO MOLECULARA: 582.58. FORMULA MOLECULAR: C18H36N4O11*H2SO4. CAS 70560-51-9. CERTIFICADOS DE ANÁLISIS
2501863	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT AMPLIFICACIÓN DE PCR QUE INCLUYA COMO MÍNIMO LOS MARCADORES MOLECULARES DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II Y OTROS	CÓDIGO ONU: 41106103. KIT AMPLIFICACIÓN DE PCR QUE INCLUYA COMO MÍNIMO LOS MARCADORES MOLECULARES DYS456, DYS389I. DYS390, DYS38 EACCIONEL KIT, DNA CONTROL Y LADDEEL KIT, DNA CONTROL Y LADDE
2503568	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT (1), DNA POLIMERASA, HOT-START PARA USO EN LABORATORIO/INVESTIGACIÓN KIT X 500 U	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO, SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN (RUO) COMPONENTES KIT/ESTUCHE: KIT, DNA POLIMERASA, HOT-START 1) EN ZIMA, 5U/UL, 100 UL, 500 U: DNA POLIMERASA TERMOESTABLE, CON MODIFICACIÓN QUÍMICA QUE LE CONFIERE A LA ENZIMA ACTIVIDAD DE ARRANQUE EN CALIENTE ""HOT-START"" Y ELIMINA UNIONES NO ESPECÍFICAS. ACTIVIDAD POLIMERASA 5`->3` ACTIVACION DE LA ENZIMA 10 MIN @95°C 2) BUF FER 10X PARA PCR, 2 X 1,2 ml; 160mm (NH4)2SO4, 1 M TRIS-HCL, PH 8,3 3) CLORURO DE MAGNESIO, 50 mm. 2 X1,2 ml. KIT X 500 U

2503570	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT (2), DNA POLIMERASA, HOT-START, REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO/I NVESTIGACIÓN	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO, SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN (RUO) COMPONENTES KIT/ESTUCHE: KIT, DNA POLIMERASA, HOT-START 1) EN ZIMA, 5U/UL; 100 UL; 500 U: POLIMERASA TERMOESTABLE, CON ANTICUERPO QUE INHIBE ACTIVIDAD POLIMERASA POR DEBAJO DE 70ºC - ACTIVIDAD" "HOT-START"". ACTIVIDAD POLIMERASA/EXONUCLEASA 5`->3`. ACTIVACIÓN DE LA ENZIMA 2 MIN @94/95ºC 2) BUFFER 5X, 4 VIALES X 1 ML. CONTIENE DOS REVELADORES (AZUL Y AMARILLO), PARA CARGAR EL PRODUCTO DE PCR EN EL GEL DE AGAROSA. PH 8,5. 3) BUFFER: CONCENTRACIÓN 5X,4VI ALES X 1 ML. BUFFER INCOLORO PH 8,5 3) CLORURO DE MAGNESIO, 25 mm, 3 X1,2 ml. KIT X 500 U
2505142	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	KIT	A.02.02.01.003.004	SALMONELLA 2 SISTEMA DE DETECCIÓN MOLECULAR	SOLUCIÓN RÁPIDA, ACCESIBLE Y FÁCIL DE USAR SIN SACRIFICAR SENSIBILIDAD O ESPECIFICIDAD. UTILIZA LA AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA COMO TECNOLOGÍA CENTRAL PARA AMPLIFICAR LAS SECUENCIAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS CON UNA ALTA ESPECIFICIDAD DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE. SIMULTÁNEAMENTE LA BIOLUMINISCENCIA SE UTILIZA PARA DETECTAR LA AMPLIFICACIÓN. LOS RESULTADOS POSITIVOS PRESUNTIVOS SE INFORMAN EN TIEMPO REAL MIENTRAS QUE LOS RESULTADOS NEGATIVOS SE MUESTRAN DESPUÉS DE QUE EL ANÁLISIS SE HA COMPLETADO
2501880	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN PARA PRUEBAS DE PANICOLAU. KIT	EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS CERVICOUTERINAS OBTENIDAS EN LA SOLUCIÓN PRESERVCYT CON SISTEMA DE CONSERVACIÓN THINPREP, PARA PRUEBAS LAVADO
2503222	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	LIGTH MIX DENGUE, KIT DE DETECCIÓN VIRUS DEL DENGUE POR PCR	LIGTH MIX DENGUE, KIT DE DETECCIÓN VIRUS DEL DENGUE POR PCR
2584012	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	KIT EXTRACCION DNA X 250 REACCIONES A PARTIR DE TEJIDOS PURELINK GENOMIC X 250 RXNS K 182002	KIT EXTRACCIÓN DNA X 250 REACCIONES A PARTIR DE TEJIDOS PURELINK GENOMICX 250 RXNS

2501455	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	KIT	A.02.02.01.003.004	KIT PARA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN MOLDE A PARTIR DE TEJIDOS PARA PCR PARA 250 PREPARACIONES - INCLUYE PROTEINASA K	KIT PARA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN MOLDE A PARTIR DE TEJIDOS PARA PCR, EN BANDAS DE GEL DE AGAROSA, PARA 250 PREPARACIONES - I K
2501457	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	KIT	A.02.02.01.003.004	PLATINUM TAQ DNA POLIMERASA, KIT 500U, 5U/UL	KIT TAQ POLIMERASA CON ACTIVIDAD HOT START 5U/UL X 500 UNIDADES, INCLUYEBUFFER 10X; SOLUCIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 50mm. PLATINUM TA E BANDASEL MONTAJE DE LA PCR. TAQ ADN POLIMERASA ES UN "ARRANQUE EN CALIENTE"EL MONTAJE DE LA PCR. TAQ ADN POLIMERASA ES UN "ARRAN ES
2502867	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	DNA DE FAGO LAMBDA, PARA BIOLOGÍA MOLECULAR, USO EN ELECTROFORESIS COMO MARCADOR DE TAMAÑO MOLECULAR	DNA DE FAGO LAMBDA, PARA BIOLOGÍA MOLECULAR, USO EN ELECTROFORESIS COMO MARCADOR DE TAMAÑO MOLECULAR Y ANÁLISIS DE ENDONUCLEASAS DER ESTRICCIÓN.
2503227	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	LC COLOR COM SET: KIT CON REACTIVOS DE COMPENSACIÓN DE COLOR UNIVERSAL COMPUESTO POR 4 VIALES CON SONDAS LIOFILIZADAS	LC COLOR COM SET: KIT CON REACTIVOS DE COMPENSACION DE COLOR UNIVERSAL COMPUESTO POR 4 VIALES CON SONDAS LIOFILIZADAS
2503226	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	LIGHTCYCLER CAPILLAIRES (20 UL) 5X96	LIGHTCYCLER CAPILLAIRES (20 UL) 5X96: CAJA DE 5 CONTENEDORES CADA UNO CON 96 CAPILARES
2501462	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	MEDIO DROSOPHILA DE SCHNEIDER ESTERILIZADO POR FILTRACIÓN 1X LIQUIDO. FRASCO X 500ml	MEDIO DROSOPHILA DE SCHNEIDER ESTERILIZADO POR FILTRACIÓN 1X LIQUIDO. FRASCO X 500ml

2501858	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MEZCLA MAESTRA PARA PCR QUE INCLUYA DNTPS, TAQ POLIMERASA, BUFFER, Y CLURURO DE MAGANESIO	CÓDIGO ONU: 41105317. MEZCLA MAESTRA PARA PCR QUE INCLUYA DNTPS, TAQPOLIMERASA, BUFFER, Y CLURURO DE MAGANESIO
2501850	1151511	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MICROPLACAS DE 96 POZOS, ELABORADA EN POLIESTIRENO CLARO, TRATADAS PARA OPTIMA ADHERENCIA DE CÉLULAS	CÓDIGO ONU: 41121812. MICROPLACAS DE 96 POZOS, ELABORADA EN POLIESTIRENOCLARO, TRATADAS PARA OPTIMA ADHERENCIA DE CÉLULAS, TAPA NO R PIRÓGENOS
2501859	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PATRÓN DE PESO MOLECULAR DE 100 A 1500 PB	PATRON DE PESO MOLECULAR DE 100 A 1500 P
2503618	1151511	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PLACA EN POLIPROPILENO DE 96 POZOS ANÁLISIS QPCR NO ESTÉRIL	PLACA EN POLIPROPILENO DE 96 POZOS PARA ANÁLISIS QPCR LIBRE DE RNASE < (>&<)> DNASE Y ENDOTOXINAS; COLOR TRANSPARENTE, NUMERO DE POZO S 96, NO ESTÉRIL
2501513	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PLACAS HLA B 27 CAJA X6 PLACAS DE TIPAJE SEROLÓGICO	LAS PLACAS DE TIPAJE SEROLOGICO DEBEN ESTAR ELABORADAS CON ANTICUERPO MONOCLONALES E INCLUIR EL COMPLEMENTO. EL TIPAJE POR BIOLOGÍA M DQB1
2504677	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA ELISA CHAGAS IGG (PRUEBA RAPIDA)	ESTUCHE DE ELISA - PRUEBA INMUNOENZIMATICA EN FASE SOLIDA DE PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LA CLASE IGG FRENTE A TRYPANOSOMA CRUZI EN SUERO O PLASMA HUMANO. CONTIENE ANTÍGENOS DE EXTRACTOS TOTALES O LIOFILIZADO DE ANTIENSOS. USO: DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.TODOS LOS REACTIVOS A EXCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO VIENEN LISTOS PARA USAR.

2504673	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA INMUNOENZIMATICA INDIRECTA DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES Y PEPTIDOS SINTETICOS, PARA DETERMINAR IGG+IGM PARA TRYPANOSOMA CRUZI	ESTUCHE DE ELISA - PRUEBA INMUNOENZIMATICA INDIRECTA DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES Y PEPTIDOS SINTETICOS, PARA DETERMINAR ANTICUERPOS I GG+IGM FRENTE A TRYPANOSOMA CRUZI EN SUERO O PLASMA HUMANO. USO: DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. TODOS LOS REACTIVOS A EXCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO VIENEN LISTOS PARA USAR. REF: T1020
2502718	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA DE HEMAGLUTINACION INDIRECTA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI. EN SUERO	PRUEBA HEMAGLUTINACION INDIR TRIPA CRUZI. PRUEBA DE HEMAGLUTINACION INDIRECTA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI. EN SUERO. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS POR LA DIRECTIVA EUROPEA 98/79 CE DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL DIAGNOSTICO "IN VITRO"
2502445	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PUNTAS CON BARRERA PARA MICROPIPETA DE 10UL LIBRE DE DNASAS/RNASAS, ESTÉRILES (PAQUETE X 960 PUNTAS)	PUNTAS CON FILTRO, EN POLIPROPILENO, CON CONTROL DE VOLUMEN RÁPIDO, ESTERILIZADAS, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA, ENDOTOXINAS Y ATP. A UTOCLAVABLES
2502572	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARA MICROPIPETA DE 100 UL LIBRE DE DNASAS/RNASA	PUNTAS CON FILTRO/BARRERA 100 UL (1-100µL) EN POLIPROPILENO, CON CONTROL DE VOLUMEN RÁPIDO, ESTERILIZADAS, LIBRES DE ADN, DNASA, RNAS A, ENDOTOXINAS Y ATP. AUTOCLAVABLES. REF 36060 HTTPS://TRANSLATE.GOOGLE.COM.CO/TRANSLATE?HL=ES-419 INDEX.PHP/PRODUCTS-CATALOG/ITEM/100-UL-1- 100-UL-BARRIER36060<(>&<)>PREV=SEARCH
2503579	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 1000 UL, CON FILTRO (BARRERA), LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIRÓGENOS.	MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARA MICROPIPETA (PIPETA DE EMBOLO DE VOLUMEN VARIABLE O VOLUMEN FIJO), ESPECIFICACIONES: VOLUMEN 100-1.000 UL MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR NATURAL CALIDAD: LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIROGENSO, ESTÉRIL. EM PAQUE: RACK X 96 PUNTAS ESTÉRILES.

							ESTÉRILES. CAJAX10 RACKS	COMPATIBILIDAD EXTENDIDA CON VARIAS MARCAS DE PIPETAS (GILSON, EPPENDORF, FINNIPET, BOECO, DIAGGE R, RAINING, SOCOREX). CAJAX10 RACKS DE 96 UNIDADES (960 UNIDADES)
2503583	41121609	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 200 UL, CON FILTRO (BARRERA), LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIRÓGENOS, ESTÉRILES	MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARA MICROPIPETA (PIPETA DE EMBOLO DE VOLUMEN VARIABLE O VOLUMEN FIJO), ESPECIFICACIONES: VOLUMEN 20-200 UL MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR NATURAL CALIDAD: LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIROGENSO, ESTÉRIL. EMPAQ UE: BOLSA X 1000 PUNTAS ESTÉRILES. COMPATIBILIDAD EXTENDIDA CON VARIAS MARCAS DE PIPETAS (GILSON, EPPENDORF, FINNIPET, BOECO, DIAGGE R, RAINING, SOCOREX). BOLSA X 1000 UNIDADES
2501866	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	REACTIVO ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) ABSOLUTO, GRADO BIOLGIA MOLECULAR	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) ABSOLUTO (C2H5OH) GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR
2501341	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG CONTRA TRIPANOSOMA CRUZI/CHAGAS	PRUEBA PARA DETECCIÓN ANTICUERPOS CONTRA TRYPANOZONA CRUZY EN SUERO OPLASMA HUMANO. MÉTODO INMUNOENZIMATICO. ELISA TERCERA GENERACIO AUTOMATIZADO
2502421	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SERVICIO DE SECUENCIACIÓ N MAS PURIFICACIÓN A PARTIR DE PRODUCTOS DE PCR	SERVICIO DE SECUENCIACIÓN MAS PURIFICACIÓN A PARTIR DE PRODUCTOS DE PCR
2503565	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SODIO BICARBONATO, POLVO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, >99% FRASCO 5.0kg	"REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO SODIO BICARBONATO, BICARBONATO DE SODIO, CARBONATO ÁCIDO DE SODIO, SODIUM BICARBONATE (NAHCO3) CAS NO: 144-55-8 EN POLVO, ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR (INSECTOS, PLANTAS), GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR PUREZA MÍNIMA DEL 99% CON CERTIFI CADO DE LOTE METALES PESADOS >10 mg/kg DETECCIÓN DNASAS/EXONUCLEASAS: NO DETECTABLE DETECCIÓN

								NICKASAS/ENDONUCLEASAS: NO DETE CTABLE DETECCIÓN RNASAS: NO DETECTABLE DETECCIÓN PROTEASAS: NO DETECTABLE FRASCO POR 5.0 kg
2503578	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 10,00, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST. FRASCO X1L	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 10,00, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST ESPECIFICACIÓN: CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST CUMPLE ESPECIFICACIÓN MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO. FRASCO X 1 LITRO
2503576	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 4,01, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST. FRASCO X1L	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 4,01, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST ESPECIFICACIÓN ON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST CUMPLE ESPECIFICACIÓN MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO. FRASCO X 1 LITRO
2503577	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 7,01, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST. FRASCO X1L	REACTIVO PARA USO EN LABORATORIO. SOLUCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE PH METROS, PH 7,01, CON CERTIFICADO, TRAZABLE A NIST ESPECIFICACIÓN ON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST CUMPLE ESPECIFICACIÓN MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO. FRASCO X 1 LITRO
2502543	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN DE DESOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATO (DNTPS), APLICACIÓN EN LAS REACCIONES EN LS QUE SE NECESITE (DNTPS)	SOLUCIÓN DE DESOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATO (DNTPS), APLICACIÓN EN LAS REACCIONES EN LS QUE SE NECESITE (DNTPS) PARA LA SÍNTESIS DE NUE ADN
2502432	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SUERO FETAL BOVINO ESTÉRIL	SUERO FETAL BOVINO, EMPACADO EN FRASCOS PLÁSTICOS. FABRICADO A PARTIR DESANGRE FETAL BOVINA. ESTÉRIL
2502429	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SULFATO GENTAMICINA SOLUCIÓN	LA SOLUCIÓN SULFATO DE GENTAMICINA SE UTILIZA COMO UN INHIBIDOR PARA EL CRECIMIENTO DE UNA AMPLIA VARIEDAD

							50MG/ml USO INVESTIGACIÓN EN LABORATORIO	DE MICROORGANISMOS GRAM-PO CONCENTRACIÓN X50MG/ml
2503224	123521	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	TRANSCRIPTOR CDNA KIT 100 REACCIONES, PARA LAS REACCIONES DE CDNA	TRANSCRIPTOR CDNA KIT 100 REACCIONES: KIT QUE CONTIENE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LAS REACCIONES DE CDNA PARA SU USO CONCI REAL
2502446	41121701	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE. LIBRE DE RNASA Y DNASA. TAPA PLANA UNIDA AL TUBO. CIERRE HERMÉTICO	MICROTUBO EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE. LIBRE DE RNASA Y DNASA. TAPA PLANA UNIDA AL TUBO. CIERRE HERMÉTICO. TUBO GRADUADO HASTA 1. ESTÉRIL
2501862	41121701	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBOS PARA ULTRA CENTRIFUGACIÓN, CAPACIDAD DE 15ml, CON MEMBRANA DE CELULOSA REGENERADA YM 100	CÓDIGO ONU: 41121702. TUBOS PARA ULTRA CENTRIFUGACIÓN, CAPACIDAD DE15ml, CON MEMBRANA DE CELULOSA REGENERADA Y M 100 PARA CONCENTRACIÓN HIDROFILICA
2501258	41121701	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO TIPO FALCON EN POLIPROPILENO, TAPA ROSCA, CAPACIDAD 50ml	TUBO TIPO FALCON EN POLIPROPILENO, TAPA ROSCA, GRADUADO, ESTÉRIL, FONDO CÓNICO. LIBRES DE DNASA, RNASA. QUE PERMITE LA CENTRIFUGACION50ML 21.04.2020 SE ACTUALIZA NOMBRE POR ESTAR CREADO CON NOMBRE COMERCIAL DE LA MARCA DE LA CENTRIFUGA (FALCON) NOMBRE ANTIGUO: TUBO TIPO FALCON ESTÉRIL CAPACIDAD 50ml
2501427	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.007.01	EMBUDO ANALÍTICO DE 7-10 CM DE DIÁMETRO APROX. VÁSTAGO CORTO EN VIDRIO	EMBUDO ANALÍTICO DE 7-10 CM DE DIÁMETRO APROX. VÁSTAGO CORTO. MOLDEADO EN VIDRIO BOROSILICATO, CON NERVIOS INTERNOS Y EXTERNOS, PARA AIRE

2501428	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	EMBUDO ANALÍTICO DE 7-10 CM DE DIÁMETRO APROX. VÁSTAGO CORTO EN (PLASTICO) POLIPROPILENO	EMBUDO ANALÍTICO DE 7-10 CM DE DIÁMETRO APROXIMADO VÁSTAGO CORTO, EN POLIPROPILENO
2501431	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS DESECHABLES TRANSPARENTES PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE 1000 A 5000 UL	PUNTAS DESECHABLES TRANSPARENTES PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE 1000 A 5000 UL
2501436	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	FILTROS DE MEMBRANA DE 0.22mm DE NITROCELULOSA ESTÉRILES /ESTERILIZABLES X 47mm	FILTROS DE MEMBRANA DE 0.22mm DE NITROCELULOSA ESTÉRILES/ESTERILIZABLES X 47mm
2501437	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.007.02	MORTERO PEQUEÑO DE PORCELANA CON VÁSTAGO PARA MACERAMIENTO O DE BIOPSIAS X 80mm UNIDAD	MORTERO PEQUEÑO DE PORCELANA CON VÁSTAGO PARA MACERAMIENTO DE X80mm – 50ml. DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, DILATACIÓN DE CALOR MÍNIMA, ELEVADA RESISTENCIA CONTRA CAMBIO DE TEMPERATURA. FABRICADO SEGÚN NORMA DIN 12906
2501446	41121701	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO PARA PCR EN POLIPROPILENO LIBRE DE RNASA DNASA Y PIROJENOS, TAPA PLAN, CAPACIDAD 0.2ml	CÓDIGO ONU:41121702. MICROTUBO PARA PCR EN POLIPROPILENO LIBRE DERNASA DNASA Y PIROJENOS, CON TAPA PLANA UNIDA AL TUBO (CIERRE DESEGU ESTÉRIL
2501459	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U		BARRA RECUBIERTA CON IMAN PARA RECOLECCIÓN DE MAGNETOS	BARRA RECUBIERTA CON IMAN PARA RECOLECCIÓN DE MAGNETOS CON POLO NEGATIVO DE 35CM DE LONGITUD. UNIDAD

							CON POLO NEGATIVO	
2501460	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U		MAGNETOS PEQUEÑOS RECUBIERTOS CON RESINA FLUOROCARBURICA, TEFLÓN CON ANILLO 6X15mm	MAGNETOS PEQUEÑOS RECUBIERTOS CON RESINA FLUOROCARBURICA, TEFLÓN CONANILLO 6X15mm
2501461	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR DE PESO - LADDER DE 100PB, PARA ELECTROFORESIS EN AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR	MARCADOR DE PESO - LADDER DE 100PB, PARA ELECTROFORESIS EN AGAROSA GRADOBIOLOGIA MOLECULAR
2501463	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE CHAGAS POR IFI	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE CHAGAS POR IFI
2501464	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE LEISHMANIA POR IFI	PAQUETE DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE LEISHMANIA POR IFI
2501468	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	SISTEMA FILTRACIÓN REUTILIZABLE POR 250ml PARA FILTROS DE MEMBRANA DE 47mm DE DIÁMETRO	SISTEMA DE FILTRACIÓN REUTILIZABLE POR 250ml PARA FILTROS DE MEMBRANA DE47MM DE DIÁMETRO, COMPATIBLES CON FILTROS DE MEMBRANA DE 0,2 45mm
2501481	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 75CM2 EN POLIESTIRENO	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 75 CM2. CAJA DE POLIESTIRENO GRADO CRISTALINO PARA CULTIVO CELULAR, ESTÉRIL, NO PIRÓGENOS
2501551	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.002	PAPEL FILTRO CUALITATIVO MEDIO RÁPIDO DE BAJA VISCOSIDAD	PAPEL FILTRO CUALITATIVO MEDIO RÁPIDO, GRAMAJE 65G/M2 PORO 7-10 UM, VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 10ml/35 SEGUNDOS, BAJA VISCOSIDAD, 70mm 100

2501807	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBO PARA MICROCENTRIFUGA X 2ml, EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE	MICROTUBO EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE. LIBRE DE RNASA Y DNASA. TAPA PLANA UNIDA AL TUBO. CIERRE HERMÉTICO. TUBO GRADUADO HASTA 2C ESTÉRIL
2501848	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	SELLADOR TÉRMICO EN POLIPROPILENO ESTÉRIL PARA MICROPLACAS DE 96 POZOS	CÓDIGO ONU: 41105309. SELLADOR TÉRMICO EN POLIPROPILENO ESTÉRIL PARAMICROPLACAS DE 96 POZOS. FILM ADHESIVO, LIBRE DE RNASA Y DNASA, T 75%
2501869	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETA SEROLÓGICA 10ml GRADUACIONES0.1ml, CON RAYAS CODIFICADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL	PIPETA SEROLÓGICA DE 10ml GRADUACIONES DE 0.1ml, PUNTA ESTÁNDAR ENVUELTA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, RAYAS CODIFICADAS DE COLOR EN LAP LÍNEAS DE
2501870	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PIPETA SEROLÓGICA 25ml GRADUACIONES0.1ml, MARCACIONES CODIFICADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL	PIPETA SEROLÓGICA DE 5ml GRADUACIONES DE 0.1ml, PUNTA ESTÁNDAR ENVUELTA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, RAYAS CODIFICADAS DE COLOR EN LA LÍNEAS DE
2501871	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PORTA FILTRO DE POLISULFONA, CAPACIDAD 250ml, CONVENIENTE FILTRO EN LA BOCA DE LA BOTELLA	PORTA FILTRO DE POLISULFONA, CAPACIDAD 250ml, CONVENIENTE FILTRO EN LA BOCA DE LA BOTELLA, REUTILIZABLE, AUTOCLAVABLE, SE ENROSCA FA CON VACÍO
2501872	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	UNIDAD DE FILTRACIÓN DE 250ml FILTRO 0.22UM INCLUYE EL FILTRO Y LA BOTELLA RECEPTORA	UNIDAD DE FILTRACIÓN DE 250ml FILTRO 0.22UM INCLUYE EL FILTRO Y LA BOTELLA RECEPTORA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EXTREMADAMENTE BAJ INDIVIDUAL

							INDIVIDUALMENTE EMPACADO ESTÉRIL	
2501873	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.006	UNIDAD DE FILTRACIÓN DE 500ml. FILTRO 0.22 UM INCLUYE EL FILTRO Y LA BOTELLA RECEPTORA INDIVIDUALMENTE EMPACADO ESTÉRIL	UNIDAD DE FILTRACIÓN DE 500ml, FILTRO 0.22UM, INCLUYE EL FILTRO Y LA BOTELLA RECEPTORA, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, EXTREMADAMENTE B INDIVIDUAL
2501874	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	BOL	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN SALINA 0.85% NO ESTÉRIL BOLSA X 1000CC USO PARA LABORATORIO CLÍNICO	SOLUCIÓN SALINA 0.85% NO ESTÉRIL BOLSA X 1000CC USO PARA LABORATORIO CLÍNICO
2501875	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	GRADILLAS PARA TUBOS FALCON DE 50 CC EN POLIPROPILENO	GRADILLAS PARA TUBOS FALCON DE 50 CC EN POLIPROPILENO
2501876	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	GRADILLAS PARA TUBOS FALCON DE 15ml EN POLIPROPILENO	GRADILLAS PARA TUBOS FALCON DE 15ml EN POLIPROPILENO
2501877	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE CRIOTUBOS EN POLICARBONATO. TAPA CON CUADRICULA NUMÉRICA Y REJILLAS REMOVIBLES	CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE CRIOTUBOS (DE 1ml HASTA 5ml), EN POLICARBONATO RESISTENTE. LA TAPA TIENE CUADRICULA NUMÉRICA IMPRESA PARA COL ORES. CONPARA 25 TUBOS. CAJA COMPATIBLE CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN TANQUEPARA 25 TUBOS. CAJA COMPATIBLE CON SISTEMA DE ALM NITRÓGENO
2501885	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBO TAPA ROSCA, EN POLIPROPILEN	MICROTUBO TAPA ROSCA, EN POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE X 0.5 CC. PUEDEUTILIZARSE EN TEMPERATURAS EXTREMAS Y CENTRIFUGACIÓN. LIBRES DE DN PIRÓGENOS

							O AUTOCLAVABLE X 0.5 CC. PUEDE UTILIZARSE EN TEMPERATURAS EXTREMAS	
2502210	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTA EN RACK 0.1 - 10 FILTRO ESTÉRILES	PUNTA EN RACK 0.1 - 10 FILTRO ESTÉRILES
2502211	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTA 1-200 UL FILTRO ESTÉRILES RACK 10	PUNTA 1-200 UL FILTRO ESTÉRILES RACK 10
2502434	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	GLICEROL ULTRAPURO 99.5+% 500ml USO EN LABORATORIO	GLICEROL ULTRAPURO 99.5+% 500ml
2502435	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MEDIO SCHNEIDER (MEDIO PARA INSECTOS CON L- GLUTAMINA SIN CLORURO DE CALCIO Y BICARBONATO DE SODIO, EN POLVO	MEDIO SCHNEIDER (MEDIO PARA INSECTOS CON L- GLUTAMINA SIN CLORURO DE CALCIO Y BICARBONATO DE SODIO, EN POLVO
2502436	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO, REACTIVO BIOLÓGICO	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO, REACTIVO BIOLÓGICO, APROPIADO PARA CULTIVO DE CÉLULAS DE INSECTO Y PARA CULTIVO DE CÉLULAS DE PLANTAS. FRASCO 100g
2502450	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	CUBETA PARA TINCIÓN CON CESTILLO APTA PARA MICROONDAS	CUBETA EN TPX (POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE METILPENTENE). COMPUESTA POR UNA GRADILLA Y UNA TAPA, CON COLOCACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL PORTAOBJETOS
2502513	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	GLN	A.02.02.01.003.004	ACIDO ACÉTICO O ACIDO ETANOICO, DE ORIGEN NATURAL. PRESENTACIÓN EN GALÓN	ACIDO ACÉTICO TAMBIÉN SE CONOCE COMO ACIDO ETANOICO O METILENCARBOXILICO; DE ORIGEN NATURAL QUE SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FRUTAS. LI HISTOLOGIA, FIJA NUCLEOPROTEÍNAS, ETC. PRESENTACIÓN EN GALÓN
2502514	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	AMONIO X 50ml	AMONIO X 50ml

2502515	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	ACIDO CLORHÍDRICO X 50ml	ACIDO CLORHÍDRICO X 50ml
2502552	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTA CON FILTRO DE 0-20 UL BOLSA X 1000 PUNTAS	PUNTA CON FILTRO DE 0-20 UL BOLSA X 1000 PUNTAS
2502579	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ALBUMINA BOVINA AL 22%. USO: INMUNOHEMATOLOGÍA	ALBUMINA BOVINA AL 22%. USO: INMUNOHEMATOLOGÍA
2503231	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	ESTÁNDAR DE AGUA PARA DENSÍMETRO	ESTÁNDAR DE AGUA PARA DENSÍMETRO
2504609	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	CAJA PLÁSTICA (EN POLIPROPILENO-PP PARA MICROVIALES CRIOGENICOS DE 1,5ml. POLIPROPILENO DURABLE, SOPORTAR TEMPERATURA ULTRABAJA	CAJA PLÁSTICA (EN POLIPROPILENO-PP PARA MICROVIALES CRIOGENICOS DE 1,5ml. POLIPROPILENO DURABLE, SOPORTAR TEMPERATURA ULTRABAJA DE -90°C -121°C. TAPA TRANSLUCIDA. RED ALFANUMÉRICA
2504610	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE ARN/ADN PARA LA MEDULA ÓSEA/SANGRE FRASCO X 500ml	REACTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE ARN/ADN PARA LA MEDULA ÓSEA/SANGRE. CONTIENE UN FUERTE DESNATURALIZANTE DE PROTEÍNAS, DETERGENTES Y AGENTES REDUCTORES PARA LOGRAR LA LISIS INSTANTÁNEA Y LA INACTIVACIÓN DE NUCLEASAS. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS SE ESTABILIZAN Y ESTÁN LISTOSPARA SU TRANSPORTE SEGURO. DESTINADO PARA USO GENERAL EN EL LABORATORIO
2504611	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	SONDA ESCALA DE SÍNTESIS DE 50 NANOMOLES, PARA USO EXCLUSIVO EN EQUIPO LIGHT CYCLER 96.	SONDA ESCALA DE SÍNTESIS DE 50 NANOMOLES, PARA USO EXCLUSIVO EN EQUIPO LIGHT CYCLER 96. SONDA COMPLETA. LA DETECCIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS AMPLIFICADOS CON SONDAS DE HIBRIDACIÓN PERMITE EL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL DE LAS SECUENCIAS AMPLIFICADAS A PARTIR DE SECUENCIAS BLANCO O TARGET

2504832	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR DE PESO MOLECULAR. DNA LADDER ESCALERA DE 100PB	MARCADOR DE PESO MOLECULAR. ESCALERA DE 100PB NOMBRE DEL PRODUCTO: DNA LADDER. CARACTERÍSTICAS: DOS RANGOS DE PESO MOLECULAR: 100 –3000 PARES DE BASES Y 250 – 10000 PARES DE BASES. 0.5mg DE ADN POR BANDA. FRENTE DE AZUL DE BROMOFENOL. APLICACIONES: ELECTROFORESIS DE ADN. ESPECIFICACIONES: RANGO 100 – 3000 PARES DE BASES. PRODUCTOS DE PCR Y ADN2C DIGERIDO, FENOLIZADOS Y EQUILIBRADOS EN TAMPÓNTE 10 Nº DE BANDAS: 12. BANDAS DE INTENSIDAD ESPECIAL: 500 Y 1500 PB. CONCENTRACIÓN: 100mg/ml. CONTENIDO: 50MG/500ML CANTIDAD RECOMENDADA PARA CARGAR: 5 ML/POCILLO. REF. MWD100
2504833	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR PESO MOLECULAR DNA LADDER/ 50PB	MARCADOR PESO MOLECULAR DNA LADDER/ 50PB EL ADN INCLUYE FRAGMENTOS QUE VARÍAN DE 50 A 1.500 PARES DE BASES. LAS BANDAS DE 200, 500 Y 1200 PARES DE BASES TIENEN UNA MAYOR INTENSIDAD PARA SERVIR COMO PUNTOS DE REFERENCIA. SE PROPORCIONA LA MASA APROXIMADA DE ADN ENCADA BANDA (0,56 mg POR CARGA) PARA APROXIMAR LA MASA DE ADN EN MUESTRAS COMPARATIVAMENTE INTENSAS DE TAMAÑO SIMILAR. DISEÑADO PARA PRODUCTOS MUY PEQUEÑOS 50 PB - 1500 PB TRES BANDAS DE SEGUIMIENTO REF. MWD50
2504834	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR PESO MOLECULAR DNA LADDER/ 1KB	MARCADOR PESO MOLECULAR DNA LADDER/ 1KB. RANGO 250 – 10000 PARES DE BASES. PRODUCTOS DE PCR Y ADN2C DIGERIDO, FENOLIZADOS Y EQUILIBRADOS EN TAMPÓN TE 10:1. Nº DE BANDAS: 13. BANDAS DE INTENSIDAD ESPECIAL: 1KB Y 3 KB. CONCENTRACIÓN: 100mg/ml. CONTENIDO: 50mg/500ml. CANTIDAD RECOMENDADA PARA CARGAR: 5 ML/POCILLO. REF. MWD1

2504835	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MATRIZ-8 CAPILARES 50CM PARA USAR CON EQUIPO ANALIZADOR GENÉTICO 3500 DX	MATRIZ-8 CAPILARES 50CM ANALIZA GENETICO ESTOS CAPILARES DE 50 CM SIN RECUBRIMIENTO INTERNO SE SUMINISTRAN EN CONJUNTOS DE CONJUNTOS PREMONTADOS DE 8 CAPILARES POR CONJUNTO, CON UN MARCO INCORPORADO PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN. UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA (RFID) ESTÁ INCORPORADA EN EL MARCO PARA RASTREAR LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CRÍTICA, QUE LUEGO SE INFORMA EN EL TABLERO DEL SOFTWARE. LAS MATRICES SE PUEDEN USAR PARA 160 INYECCIONES EN MODO DX. ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO EN LOS ANALIZADORES GENÉTICOS DE LA SERIE DX DE APPLIED BIOSYSTEMS 3500 Y NO ESTÁ VALIDADO PARA SU USO CON OTROS SISTEMAS O APLICACIONES.
2504836	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR FRAGMENTOS ADN (15-120) NUCLEOTIDOS (120 LIZ)	MARCADOR FRAGMENTOS ADN 120 EL ESTÁNDAR DE TAMAÑO GENESCAN ™ 120 LIZ® ES UN ESTÁNDAR DE TAMAÑO DE CINCO TINTES QUE ESTÁ DISEÑADO PARA EL TAMAÑO REPRODUCIBLE DE DATOS DE ANÁLISIS DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS. GENESCAN ™ 120 LIZ® SIZE STANDARD ESTÁ DISEÑADO PARA DIMENSIONAR FRAGMENTOS DE ADN EN EL RANGO DE 15-120 NUCLEÓTIDOS Y PROPORCIONA NUEVE FRAGMENTOS ETIQUETADOS DE CADENA SENCILLA DE: 15, 20, 25, 35, 50, 62, 80, 110 Y 120 NUCLEÓTIDOS.
2504837	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	MARCADOR FRAGMENTOS ADN (15-120) NUCLEÓTIDOS (120 LIZ)	MARCADOR FRAGMENTO ADN/20-1200 NUCLEOTID CONTIENE FRAGMENTOS DE ADN MONOCATENARIOS MARCADOS CON 68 LIZ PARA USO COMO QUINTO COLORANTE ESTÁNDAR. ALMACENAR EL KIT A 2 - 8 ° C. (NO CONGELAR). EL ESTÁNDAR DE TAMAÑO GENESCAN ™ 1200 LIZ® ES UN QUINTO ESTÁNDAR DE TAMAÑO DE ALTA DENSIDAD ETIQUETADO CON TINTE (LIZ®) PARA EL TAMAÑO REPRODUCIBLE DE MUESTRAS DE ANÁLISIS DE FRAGMENTOS. EL ESTÁNDAR CONTIENE 68 FRAGMENTOS DE ADN MONOCATENARIOS MARCADOS CON COLORANTE LIZ®. ESTÁ DISEÑADO PARA DIMENSIONAR FRAGMENTOS DE ADN EN EL RANGO DE 20-1200 NUCLEÓTIDOS

2504838	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO LIMPIEZA ENZIMÁTICA DE PCR EXOSAP-IT	REACTIVO LIMPIEZA ENZIMÁTICA DE PCR LA LIMPIEZA ENZIMÁTICA ES UN MÉTODO MUY EFICAZ PARA LA PURIFICACIÓN DE PCR. LA ADICIÓN DE REACTIVO EXOSAP-IT DIRECTAMENTE AL PRODUCTO DE PCR ELIMINA LOS PASOS DE TRANSFERENCIA A TUBOS, POCILLOS O COLUMNAS Y CONSERVA LOS AMPLIACIONES DE PCR, LO QUE AYUDA A REDUCIR LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN CRUZADA; NO SE NECESITA PROCESAMIENTO ADICIONAL.
2505095	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	KIT	A.02.02.01.003.004	KIT DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO SIMULTANEO DE DNA Y RNA USANDO BUFFERS ADAPTADO PARA LA UNIÓN DNA Y RNA. POR 250 PURIFICACIONES	KIT DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO SIMULTANEO DE DNA Y RNA USANDO BUFFERS ADAPTADO PARA LA UNIÓN DNA Y RNA. SE PUEDE USAR SANGRE, PLASMA O SUERO; PUEDE CONTENER CITRATO O EDTA. POR 250 PURIFICACIONES
2505096	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	OLIGONUCLEÓTIDOS PERSONALIZADOS. ESCALA DE SÍNTESIS DESDE 0.025~1MMOL. PURIFICACIÓN MOPC (MÉTODO DEL CARTUCHO)	OLIGONUCLEÓTIDOS PERSONALIZADOS. ESCALA DE SÍNTESIS DESDE 0.025~1µMOL. PURIFICACIÓN MOPC (MÉTODO DEL CARTUCHO). LONGITUD DE SECUENCIA DE 3-130 BASES. SISTEMA DE MANEJO DE LIQUIDOS (NORMALIZACIÓN). SE PROCESAN BAJO EL ANÁLISIS MALDI-TOF MS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
2505097	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	TINTE DE ADN SEGURO 20,000X EN AGUA	TINTE DE ADN SEGURO 20,000X EN AGUA, 20,000X. REACTIVO QUE PERMITE VISUALIZAR EL ADN EN UNA ELECTROFORESIS. ALCANZA PARA 400 GELESDE 50ml O 200 GELES DE 100. PRESENTACIÓN: FRASCO VIAL DE 1ml H
2505131	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	BX	A.02.02.01.003.004	PISTILOS EN POLIPROPILENO (PP) DE APROXIMADAMENTE 75-85mm DE LONGITUD, SIN DNASA, RNASA Y	PISTILOS EN POLIPROPILENO (PP) DE APROXIMADAMENTE 75-85 mm DE LONGITUD, SIN DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS. USO: PARA HOMOGENIZAR CELULASY TEJIDOS EN VIALES DE 1,5ml/2ml EN FORMA EXACTA. ADECUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOMOGENIZADOR. DE UN SOLO USO.

							PIROGENOS. DE UN SOLO USO.	
2505562	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	MICROTUBOS ROSADOS, PP TRANSPARENTE TUBOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE. APTOS PARA SER USADOS EN NITRÓGENO LIQUIDO, AUTOCLAVE Y PROCESOS DE EBULLICIÓN X 2ml	MICROTUBOS ROSADOS, PP TRANSPARENTE TUBOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE. APTOS PARA SER USADOS EN NITRÓGENO LIQUIDO, AUTOCLAVE Y PROCESOS DE EBULLICIÓN. RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE –190°C. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS. PRODUCTO IDEAL PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO. RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: 20.000 G.
2505656	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	TARJETA LIBRE DE QUÍMICOS DISEÑADA PARA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN EFICIENTE DE ADN.	TARJETA PARA EL PROCESAMIENTO RÁPIDO MEDIANTE AMPLIFICACIÓN DIRECTA DE ADN. LA TARJETA GENCOLLECT ™ 2.0 ES UNA TARJETA TRATADA QUÍMICAMENTE QUE LISA LAS CÉLULAS Y PRESERVA LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA. ES TOTALMENTE COMPATIBLE PARA LA AMPLIFICACIÓN DIRECTA DE ADN, ELIMINANDO EL PASO DE EXTRACCIÓN.
2505726	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PIPETA 125 ML ESTÉRIL/FILTRO/RACK	PUNTAS PIPETA 125 µL ESTÉRIL/FILTRO/RACK, MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARAMICROPIPETA (PIPETA DE EMBOLO DE VOLUMEN VARIABLE O VOLUMEN FIJO), ESPECIFICACIONES: VOLUMEN 50-100 UL MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR NATURAL CALIDAD: LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIROGENSO, ESTÉRIL. EMPAQUE: RACK X 96 PUNTAS ESTÉRILES. COMPATIBILIDAD EXTENDIDA CON VARIAS MARCAS DE PIPETAS (GILSON, EPPENDORF, FINNIPET, BOECO, DIAGGER, RAINING, SOCOREX). C10 SOPORTES DE 96 GRIP TIPS

2505727	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PIPETA 125ML ESTER/FILTRO/ RACK384	PUNTAS PIPETA 125µL ESTER/FILTRO/RACK384. MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARAMICROPIPETA (PIPETA DE EMBOLO DE VOLUMEN VARIABLE O VOLUMEN FIJO), ESPECIFICACIONES: VOLUMEN 50-100 UL MATERIAL: POLIPROPILENO COLORNATURAL CALIDAD: LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIROGENSO, ESTÉRIL. EMPAQUE: RACK X 96 PUNTAS ESTÉRILES. COMPATIBILIDAD EXTENDIDA CON VARIAS MARCAS DE PIPETAS (GILSON, EPPENDORF, FINNIPET, BOECO, DIAGGER, RAINING, SOCOREX). C10 SOPORTES DE 384 GRIP TIPS
2505728	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	PUNTAS PIPETA 300ML ESTERI/FILTRO/ RACK96	PUNTAS PIPETA 300µL ESTERI/FILTRO/RACK96, MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO PUNTAS CON FILTRO (BARRERA) PARA MICROPIPETA (PIPETA DE EMBOLO DE VOLUMEN VARIABLE O VOLUMEN FIJO), ESPECIFICACIONES: VOLUMEN 300 UL MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR NATURAL CALIDAD: LIBRES DE DNASAS/RNASAS/PIROGENSO, ESTÉRIL. EMPAQUE: RACK X 96 PUNTAS ESTÉRILES. COMPATIBILIDAD EXTENDIDA CON VARIAS MARCAS DE PIPETAS (GILSON, EPPENDORF, FINNIPET, BOECO, DIAGGER, RAINING, SOCOREX). C10 SOPORTES DE 96 GRIP TIPS
2505746	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.006	TUBOS DE PCR 0.2ml BLANCO X 8 SIN TAPA	TIRA DE TUBOS PARA PCR 0.2ml X8 SIN TAPA, TIRAS DE 8 TUBOS DE 0,2ml DE PERFIL BAJO DE BIO-RAD PARA PCR CON VOLÚMENESDE 5 A 125 µL (200 µL MÁX.). LA BAJA ALTURA TOTAL (15,48 mm) REDUCE LA CONDENSACIÓN IDEAL PARA PCR RÁPIDA, REACCIONES DE BAJO VOLUMEN Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL LIBRE DE ADNASA, ARNASA Y ADN HUMANO TUBOS BLANCOS.
2584011	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	BUFFER TRIS, ACETATO EDTA PARA USO EN ELECTROFORESIS, DE CONCENTRACIÓN 10X DEL USO RECOMENDADO, PH DE 8.2 A 8.4	BUFFER TRIS, ACETATO EDTA PARA USO EN ELECTROFORESIS, DE CONCENTRACIÓN 10X DEL USO RECOMENDADO, PH DE 8.2 A 8.4

2584013	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	PROTEINASA K VIAL X 100mcg SERINA PROTEASA NO ESPECIFICA	PROTEINASA K ES UNA SERINA PROTEASA NO ESPECIFICA.ENZIMA ACTIVA EN UN AMPLIO RANGO DE PH, EN SDS, EDTA Y UREA; ES ESTABLE A ALTAS TEM PERATURAS
2587194	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	KIT	A.02.02.01.003.004	EL COLUMN-PURE GEL AND PCR CLEAN-UP KIT DE ABM ES UN SISTEMA RÁPIDO Y VERSÁTIL PARA EL AISLAMIENTO Y LA PURIFICACIÓN DE ADN	EL COLUMN-PURE GEL AND PCR CLEAN-UP KIT DE ABM ES UN SISTEMA RÁPIDO Y VERSÁTIL PARA EL AISLAMIENTO Y LA PURIFICACIÓN DE ADN. ESTE KIT DOS EN UNO SE PUEDE UTILIZAR PARA PURIFICAR ADN DE ALTA CALIDAD DESPUÉS DE LA AMPLIFICACIÓN POR PCR Y EL AISLAMIENTO EN GEL DE AGAROSA. LA TECNOLOGÍA DE COLUMNA GIRATORIA DE SÍLICE PERMITE LA RECUPERACIÓN RÁPIDA DE MUESTRAS DE ADN DE ALTA CALIDAD QUE ESTÁN LISTAS PARA APLICACIONES POSTERIORES COMO PCR, RESTRICCIÓN DE DIGESTIÓN, CLONACIÓN Y SECUENCIACIÓN.
2587195	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	C/U	A.02.02.01.003.004	TAQ 2X PCR MASTERMIX ES UN MASTERMIX LISTO PARA USAR QUE CONTIENE ADN POLIMERASA TAQ EN UN TAMPÓN DE FÓRMULA ÚNICA CON COLORANTE DE CARGA DE GEL. TAQ TIENE POLIMERASA 5'-3' Y 5'-ACTIVIDADES EXONUCLEASA 3', CARECE DE ACTIVIDAD EXONUCLEASA 3'-5' Y PRODUCE COLA 3'-DA AMPLIACIONES LOS PRODUCTOS DE PCR HECHOS CON TAQ SE PUEDEN USAR CON VECTORES	TAQ 2X PCR MASTERMIX ES UN MASTERMIX LISTO PARA USAR QUE CONTIENE ADN POLIMERASA TAQ EN UN TAMPÓN DE FÓRMULA ÚNICA CON COLORANTE DE CARGA DE GEL. TAQ TIENE POLIMERASA 5'-3' Y 5'- ACTIVIDADES EXONUCLEASA 3', CARECE DE ACTIVIDAD EXONUCLEASA 3'-5' Y PRODUCE COLA 3'-DA AMPLIACIONES LOS PRODUCTOS DE PCR HECHOS CON TAQ SE PUEDEN USAR CON VECTORES DE CLONACIÓN TA.

							DE CLONACIÓN TA.	
2587196	41000000	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-09	FCO	A.02.02.01.003.004	BUFFER PBS 1X GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR FRASCO 500ml LA SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO (DPBS) DE DULBECCO ES UNA SOLUCIÓN SALINA A BASE DE AGUA QUE SE UTILIZA EN VARIAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN	BER PBS 1X GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR FRASCO 500ml LA SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO (DPBS) DE DULBECCO ES UNA SOLUCIÓN SALINA A BASE DE AGUA QUE SE UTILIZA EN VARIAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN. EL TAMPÓN NO ES TÓXICO. Y PROPORCIONA A LAS CÉLULAS AGUA E IONES INORGÁNICOS QUE SON NECESARIOS PARA EL METABOLISMO CELULAR. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR PARA ENJUAGAR, COMO DILUYENTE O SOLUCIÓN DE REFERENCIA.

PRUEBAS ESPECIALES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501409	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGG CONTRA CITOMEGALOVIRUS	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGG CONTRA CITOMEGALOVIRUS. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501410	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGM CONTRA CITOMEGALOVIRUS	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGM CONTRA CITOMEGALOVIRUS. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2504404	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FACTOR	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FACTOR REUMATOIDEO EN SUERO Y PLASMA. AUTOMATIZADO

							REUMATOIDEO EN SUERO Y PLASMA AUTOMATIZADA	
2501385	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA DE ELISA IGM PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE	ENSAYO DE INMUNOADSORCIÓN ENZIMÁTICA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE
2501466	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA DE ELISA IGM PARA LEPTOSPIRA	ENSAYO DE INMUNOADSORCIÓN ENZIMATICA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM CONTRA LEPTOSPIRA
2501339	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) PARA HEPATITIS B-MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) EN SUERO O PLASMA POR ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA O QUIMIOLUMINISCENCIA.
2500580	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPO ANTI TPO (ANTI-TIROPEROXIDASA). PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTI-TPO (ANTI-TIROPEROXIDASA) EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA
2501387	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FERRITINA. MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FERRITINA EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501397	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE IGG RUBEOLA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGG CONTRA RUBEOLA, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.

2501398	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE IGM RUBEOLA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGM CONTRA RUBEOLA, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2502537	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PROGESTERONA MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROGESTERONA EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA.
2501402	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TESTOSTERONA EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501392	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOGLOBULINA E (IGE) MÉTODO CUANTITATIVO - PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE IGE EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501379	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PSA LIBRE CUANTITATIVA PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO FRACCIÓN LIBRE EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501380	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PSA TOTAL CUANTITATIVA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO TOTAL EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA.

							PRUEBA AUTOMATIZADA	
2503515	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE AFP ALFA FETO PROTEÍNA PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AFP ALFA FETO PROTEÍNA
2503167	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA - PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA I DEL ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO EN SUERO Y PLASMA HUMANO.
2501375	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DETERMINACIÓN ACIDO FÓLICO PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ACIDO FÓLICO POR QUIMIO O ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA. EN SUERO Y/O PLASMA
2501390	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	ANTI-HEPATITIS A- TOTALES MÉTODO CUANTITATIVO - PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IG M. POR ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA O QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2500096	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BETA HCG, (GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA). PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE SUB-UNIDAD BETA EN SUERO, CON ANTICUERPOS MONOCLONALES POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2503516	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CA 125 PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CA 125
2501386	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ESTRADIOL EN SUERO, POR

							DETERMINACIÓN DE ESTRADIOL PRUEBA AUTOMATIZADA	QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2503164	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE INSULINA, PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA INSULINA HUMANA EN SUERO Y PLASMA HUMANO.
2501485	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TROPONINA EN SUERO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TROPONINA EN SUERO. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501388	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE FSH MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FSH EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501404	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE IGG TOXOPLASMA MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGG CONTRA TOXOPLASMA POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501405	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE IGM TOXOPLASMA MÉTODO CUANTITATIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGM CONTRA TOXOPLASMA POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.

2503162	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PARATHORMONA (HORMONA PARATIROIDEA)	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA IN VITRO DE LA HORMONA PARATIROIDEA INTACTA EN SUERO Y PLASMA. POR ELECTROQUIMIOLUMINISCQUIMIOLUMINISCENCIA
2501396	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROLACTINA PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROLACTINA EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501479	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T3 LIBRE. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T3 LIBRE EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO/QUIMIOLUMINISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501400	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 LIBRE. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 LIBRE EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2500846	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS DE VIH TIPO 1 Y ANTICUERPOS DE VIH 2 DE CUARTA GENERACIÓN. PRUEBA CUANTITA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS DE VIH 1 Y ANTICUERPOS DEL VIH 2, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO-QUIMIOLGENERACION RQ. 5000010722
2502956	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓ	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE VITAINA B12 EN SANGRE, POR QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA

							N CUANTITATIVA DE VITAINA B12 EN SANGRE	
2503163	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN VITAMINA D, PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA IN VITRO DE LA 25-HIDROXIVITAMINA D TOTAL EN SUERO Y PLASMA. POR ELECTROQUIMIOLUMINIS QUIMIOLUMINISCENCIA
2501394	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LH. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LH EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501399	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T3. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T3 EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501407	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TSH. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TSH EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501401	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 TOTAL. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 TOTAL EN SUERO POR QUIMIO O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501564	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DETERMINACIÓN ANTICUERPOS TOTALES CONTRA ANTÍGENO CORE	PRUEBA PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES CONTRA EL ANTÍGENO CORE DE HEPATITIS B EN SUERO O PLASMA HUMANO MÉTODO INMUNOENZIMATICO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTRO QUIMIOLUMINISCENCIA

							HEPATITIS B PRUEBA AUTOMATIZADA	
2501595	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	FCO	A.02.02.01.003.004	SOLUCIÓN POTENCIALIZADORA DE BAJA FUERZA IÓNICA (PS LISS) USADA PARA ACELERAR LA REACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO	SOLUCIÓN POTENCIALIZADORA DE BAJA FUERZA IÓNICA ("PS" LISS) USADA PARA ACELERAR LA REACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO. USO BANCO DE SANGRE INVIMA
2501593	411032	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-10	FCO	A.02.02.01.003.004	TEST PARA LA VALIDACIÓN DE LA ANTIGLOBULINA NEGATIVA (SUERO DE COOMBS)	TEST PARA LA VALIDACIÓN DE LA ANTIGLOBULINA NEGATIVA (SUERO DE COOMBS). USO BANCO DE SANGRE. REGISTRO INVIMA
QUIMICA								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2587166	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE AMILASA, PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE AMILASA EN SUERO POR FOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA
2587167	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL DIRECTO. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA.	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2502531	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA HEMOGLOBINA	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA HEMOGLOBINA

2501488	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA UREA	REACTIVOS DE UNIDAD PARA DETERMINACIÓN DE NITROGENO URÉICO METODO FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA.
2501487	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA CK	REACTIVOS DE UNIDAD PARA DETERMINACIÓN DE CK METODO FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA.
2501360	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINAR HIERRO SERICO PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE HIERRO SERICO METODO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501797	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA BILLIRUBINAS	PRUEBA DE QUIMICA SECA PARA BILLIRUBINAS
2503845	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA DE DIAGNOSTICO RAPIDO POR MEDIO DE UNA TIRA REACTIVA DE SANGRE PARA DETERMINACIÓ N DE COLESTEROL TOTAL.	PRUEBA QUIMICA SECA PARA COLESTEROL TOTAL. PRUEBA DE DIAGNOSTICO RAPIDO POR MEDIO DE UNA TIRA REACTIVA DE SANGRE. ANALISIS CUANTITAT IVO DEL COLESTEROL TOTAL EN 5 MINUTOS A PARTIR DE SANGRE CAPILAR. EL METODO SE BASA EN LA FOTOMETRIA DE REFLEXION, MEDIDA DEL CAMBIO DEL COLOR PRODUCIDO EN EL REACTIVO SECO. PRECISO, EXACTO, SENCILLO Y FIABLE. PRESENTACION FRASCO POR 30 TIRAS. COMPATIBLE CON EL EQU IPO DE LA INSTITUCION. REF1: 10745065204
2501342	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACIO N DE ALBUMINA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE ALBUMINA EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501344	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACO N CUANTITATIVA DE ASPARTATO AMINOTRANSFE RASA (AST/GOT). PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE AST/GOT EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501778	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACIO N DE GAMA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) EN SANGRE POR FOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO

							GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT). PRUEBA AUTOMATIZADA	COLORIMETRICO O METODO CINETICO. PRUEBA AUTOMOTIZADA
2501359	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETECCION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA FRACCION HBA1C - PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA Del % HBA1C HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR INMUNOTURBIDIMETRIA, Y/O ELECTROFORESIS CAPILAR Y/O MÉTODO HPLC EN SANGRE TOTAL CON EDTA.
2504563	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMIN FOSFATASA ALKALINA SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALKALINA EN SUERO. POR ESPECTOFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2504560	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMIN BILIRRUBINA DIRECTA SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRECTA EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2504561	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINA BILIRRUBINA TOTAL SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2501356	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALCALINA EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501345	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE BILIRRUBINA DIRECTA EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.

2504562	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2501653	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DESHIDROGENASA LACTICA. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE DHL EN SANGRE, POR ESPECTOFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501531	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA TRANSAMINASA ALT/GPT PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GPT (TRANSAMINASA GLUTAMICOPIRUVICA) O ALT (TRANSAMINASA ALANINO AMINOTRANSFERASA) EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA. METODO ENZIMÁTICO O COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2502504	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA TRANSAMINASA ALT/GPT PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALANINO AMINOTRANSFERASA EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRIA PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINETICA O ABSORBANCIA, CON REACTIVO A Y REACTIVO B O QUIMICA SECA
2502563	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (GOT). PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GOT (TRANSAMINASA GLUTAMICOOXALACETICA) O AST (TRANSAMINASA ASPARTATO AMINOTRANSFERASA)
2501346	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL METODO COLORIMETRIC	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE BILIRRUBINA TOTAL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.

							O. PRUEBA AUTOMATIZADA	
2501367	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE PROTEINAS TOTALES EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA METODO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA
2504567	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE TRANSAMINASA AST/GOT SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMINO ASPARTATO TRANSFERASA AST/GOT EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRÍA PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICA O ABSORBANCIA, CON REACTIVO A Y REACTIVO B O QUIMICA SECA
2501349	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE CREATIN KINASA FRACCION MB PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE CK-MB EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRIA, ENZIMATICO O COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501350	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CLORO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE CLORO POR TECNICA ISE INDIRECTA, EN SUERO Y ORINA
2501352	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL DIRECTO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE COLESTEROL HDL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501353	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION COLESTEROL LDL ENZIMATICO. PRUEBA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL LDL POR METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO

2501351	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501348	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE CREATIN KINASA. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE CPK EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, ENZIMATICO O COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501354	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CREATININA PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE CREATININA EN SUERO Y ORINA POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2505093	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE CREATININA SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE CREATININA EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRIA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2501340	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE ACIDO URICO. METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE ACIDO URICO EN SUERO Y ORINA POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2504559	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE ACIDO URICO SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION DE ACIDO URICO, POR METODO COLORIMETRICO, ENZIMATICO, O QUIMICA SECA. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADO
2501347	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETRMINACION DE CALCIO	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE CALCIO TOTAL EN SUERO, PLASMA Y ORINA POR ESPECTROFOTOMETRIA PRUEBA AUTOMATIZADA.

							PRUEBA AUTOMATIZADA	
2501358	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE Y ORINA, POR ESPECTROFOTOMETRIA METODO ENZIMATICO UV DE LA HEXOQUINASA U OXIDASA O COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2504564	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SUERO, SANGRE TOTAL Y/O ORINA, SEMIAUTOMATIZA POR ESPECTROFOTOMETRÍA PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICA O ABSORBANCIA, CON REACTIVO A Y REACTIVO ESTÁNDAR O QUIMICA SECA.
2505706	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA LIPASA EN SUERO Y PLASMA HUMANO.	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA LIPASA EN SUERO Y PLASMA HUMANO, TEST ENZIMÁTICO
2502566	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO POR ION SELECTIVO.	PRUEBA PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO. POR ION SELECTIVO. PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA
2501357	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FOSFORO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA CUANTITATIVA PARA DETERMINAR FOSFORO EN SUERO, PLASMA Y ORINA POR MÉTODO UV. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501361	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE MAGNESIO EN SUERO. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE MAGNESIO EN SUERO PÓR METODO COLORIMETRICO O CALMAGITA O AZUL DE XILIDIL PUNTO FINAL, PRUEBA AUTOMATIZADA.

2501362	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA. PRUEBA AUTOMATIZADA	PRUEBA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE ALBUMINA EN ORINA POR INMUNOTURBIDIMETRIA. PRUEBA AUTOMATIZADA
2501492	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE NITROGENO UREICO (BUN). PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE UREA EN SUERO Y ORINA POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMÁTICO, UV, CINETICO O COLORIMÉTRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501368	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PROTEINAS URINARIAS. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS EN ORINA Y/O FLUIDOS CORPORALES POR INMUNOTURBIDIMETRIA, PRUEBA AUTOMATIZADA.
2501370	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE TRIGLICÉRIDOS EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2504568	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS POR METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA SEMIAUTOMATIZADA	PRUEBA PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS (GPO/PAP) EN SUERO Y PLASMA POR FOTOMETRIA O QUIMICA SECA.
2501262	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO)	REACTIVO DEDICADO SE DEBEN INCLUIR GASES (PH, PCO2) OXIMETRIA THB, O2HB, COHB, METHB, SO2) METABOLITOS (GLUCOSA/LACTAT O) Y REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO POR ION SELECTIVO - PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA

							AUTOMATIZADO SEMIAUTOMATIZADO	
2501343	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE AMILASA. PRUEBA AUTOMATIZADA	REACTIVO PARA LA DETERMNACION DE AMILASA EN SUERO POR ESPECTROFOTOMETRÍA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. PRUEBA AUTOMATIZADA.
2587213	41116004	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-11	C/U	A.02.02.01.003.005	REACTIVO DETERMINACION DE NITROGENO UREICO SEMIAUTOMATIZADO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE UREA -NITROGENO UREICO (BUN) EN SUERO, SANGRE TOTAL Y/O ORINA, POR ESPECTROFOTOMETRÍA PUNTO FINAL, TIEMPO FIJO, CINÉTICA O ABSORBANCIA, CON REACTIVO A Y REACTIVO B O QUIMICA SECA.

SERVICIO TRANSFUCIONAL

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación Técnica
2501580	41104109	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.006	BOLSAS ESTERILES DE 150ml PARA TRANSFERIR CANTIDADES ESPECIFICAS DE SANGRE A PARTIR DE BOLSA PRIMARIA	BOLSAS ESTERILES DE 150ml PARA TRANSFERIR CANTIDADES ESPECIFICAS DE SANGRE A PARTIR DE BOLSA PRIMARIA. USO BANCO DE SANGRE. REGISTRO INVIMA
2504224	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	CELULAS PARA LA DETERMINACION DEL GRUPO SERICO, CONFIRMACION DEL GRUPO ABO, EN TECNICA DE GEL	CELULAS PARA LA DETERMINACION DEL GRUPO SERICO, CONFIRMACION DEL GRUPO ABO, EN TECNICA DE GEL. REACTIVOS ERITROCITARIOS PARA LA DETE RMINACION DEL GRUPO SERICO. SUSPENSIONES DE HEMATIES DE DONANTES DE LOS GRUPOS A1, A2, B Y O PARA LA DETERMINACION DEL GRUPO INVERSO O SERICO. CADA VIAL DE CONTIENE 5-10 ML DE HEMATIES HUMANOS EN SUSPENSION AL 0.8% EN SOLUCION TAMPON CON CONSERVANTES. CADA VIAL PRO CEDE DE UN SOLO DONANTE. LISTO PARA USAR. CONSERVACIÓN: 2-8 °C.

2504223	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	CELULAS PARA LA INVESTIGACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES, EN TECNICA DE GEL	CELULAS PARA LA INVESTIGACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES, EN TECNICA DE GEL. CADA VIAL CONTIENE 10ml DE HEMATIES HUMANOS DEL GRUPO O EN SUSPENSION AL 0.8% EN SOLUCION TAMPON CON CONSERVANTES. DE UN SOLO DONANTE.LISTO PARA USAR. CONSERVACION 2-8°c
2504930	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	ERITROCITOS PARA EL CONTROL DE LA PRUEBA ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS-CONTROL IGG. FRASCO POR 10ML.	ERITROCITOS PARA EL CONTROL DE LA PRUEBA ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS- CONTROL IgG. USO REALIZAR PRUEBAS CRUZADAS EN BANCO DE SANGRE. PRESENTACION: FRASCO POR 10ml.
2584018	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	GLOBULOS ROJOS DE CONEJO, ESTERILES, DESFRIBRINADOS CON FECHA DE VENCIMIENTO, FRASCO POR 50ml	GLOBULOS ROJOS DE CONEJO, ESTERILES, DESFRIBRINADOS CON FECHA DE VENCIMIENTO, FRASCO POR 50ml
2501263	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	HEMOCLASIFICACION DE RECIEN NACIDO (REACTIVO PARA EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UNIDAD TRANSFUSIONAL)	HEMOCLASIFICACION GLOBULAR, MAS COOMBS DIRECTO PARA RECIEN NACIDOS: IDECARD DIACLON ABO/D DIRECT FOR COOMBS, FOR NEWBORNS, ID DILUYE DILUCION
2501670	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI A 10ml/PRUEBA	REACTIVO MONOCLONAL ANTIA, HEMOCLASIFICADOR PARA LA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH, REACTIVO DE 10ml DE LA MISMA MARCA DE LOS HEMOCLASIFICADORES D, B y CDE.
2501668	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL	REACTIVO MONOCLONAL ANTID, HEMOCLASIFICADOR PARA LA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH, REACTIVO

							ANTI-D 10ml/RUEBA	DE 10ml DE LA MISMA MARCA DE LOS HEMOCLASIFICADORES A, B y CDE.
2501458	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	FCO	A.02.02.01.003.004	SUERO HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL anti-CDE (IgM/IgG)	SUSPENSION DE ANTICUERPOS IgM/IgG MONOCLONAL. FRASCO X 10ml. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR PARA LA DETECCION DEL ANTIGENO C, D Y E.
2501557	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA CRUZADA COMPLETA (REACTIVO PARA EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UNIDAD TRANSFUSIONAL)	PRUEBA CRUZADA COMPLETA (ID CARD LISS COOMBS, ID DILUYENTE 2, TUBO PARA DILUCION
2501572	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA DE COOMBS/REACTIVO PARA EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UNIDAD TRANSFUSIONAL	COOMBS DIRECTO/ID CARD LISS COOMBS, ID DILUYENTE 2, TUBO PARA DILUCION
2504227	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	TECNICA EN GEL PARA LA DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DE LOS SISTEMAS ABO RH (D) Y LA DETERMINACION DEL ABO REVERSO	TECNICA EN GEL PARA LA DETERMINACION DE LOS ANTIGENOS DE LOS SISTEMAS ABO Rh (D) Y LA DETERMINACION DEL ABO REVERSO. EL SUERO ANTI AB ES CAPAZ DE DECTAR SUBGRUPOS DE A. PERMITE HACER UNA DOBLE DETERMIANCION DE D (DV)+ YDVI-). CON TUBO CONTROL DE Rh
2502167	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA HEMOCLASIFICACION ABO. REACTIVO PARA EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UNIDAD TRANSFUSIONAL	HEMOCLASIFICACION MONOCLONAL DIRECTA E INVERSA MONOCLONAL A-B- D-Ctrl/A1-B (1 TARJETA DE IDENTIFICAICON ABO /D + REVERSE GROUP, ID D DILUCION)

2501575	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	KIT	A.02.02.01.003.004	PRUEBA PARA RASTREO DE ANTICUERPOS (REACTIVO PARA EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UNIDAD TRANSFUSIONAL	RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES O COOMBS INDIRECTO PARA PACIENTES CON DOS CELULAS PANTALLA. ID CARD LISS COOMBS. ID DIACELL I, ID DILUCION
2505023	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA FCO X 10 ml	REACTIVO ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA, DE CELULAS ROJAS PARA REALIZAR PRUEBAS CRUZADAS DE BANCO DE SANGRE. FRASCO DE 10 ml
2504659	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DE CELULAS ROJAS PARA PRUEBAS CRUZADAS A1, A2, B. O. DE ORIGEN HUMANO 4 FRASCOS X 10ML	REACTIVO DE CELULAS ROJAS PARA PRUEBAS CRUZADAS A1, A2, B. O. DE ORIGEN HUMANO, EN MEDIO DE SUSPENSION TAMPONADO AL 0.8% (+/- 0.1 %). USO: REALIZAR PRUEBAS CRUZADAS EN BANCO DE SANGRE. PRESENTACION: 4 FRASCOS X 10ml.
2504660	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DE CELULAS ROJAS PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS P1, P2. PARA USO DE DIANOSTICO IN VITRO. PRESENTACION : 2 FRASCOS X 10ML	REACTIVO DE CELULAS ROJAS PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS P1, P2, SON ERITROCITOS DE ENSAYO CON ANTIGENOS POLIVALENTES, PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ERIROCITARIOS OBTENIDOS DE DOS DONANTES Y ENVASADOS EN DOS VIALES DIFERENTES. PARA USO DE DIANOSTICO IN VITRO, REALIZAR PRUEBAS CRUZADAS EN BANCO DE SANGRE PRESENTACION: 2 FRASCOS X 10ml.
2504234	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR (LECTINA) ANTI-A1 PARA EL METODO SALINO	REACTIVO HEMOCLASIFICADOR (LECTINA) ANTI-A1 PARA EL METODO SALINO. EXTRACTO ESTABILIZADO PREPARADO A PARTIR DE LAS SEMILLAS DE DOLIC HOS BIFLORUS. EL PRINCIPIO DEL ANALISIS ES LA TECNICA DE AGLUTINACION, QUE SE BASA EN LA REACCION DE LOS ANTIGENOS/ANTICUERPOS. PAR A USO DE DIAGNOSTICO IN VITRO
2504479	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO LECTINAS ANTI-H. INDICACION: DETECCION DE	REACTIVOS DE GRUPO SANGUINEO, REACTIVO LECTINAS ANTI-H. INDICACION: DETECCION DE LA SUSTANCIA H EN LOS ERITROCITOS.

							LA SUSTANCIA H EN LOS ERITROCITOS	
2504228	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	SOLUCION DE BAJA FUERZA IONICA PARA PREPARAR SOLUCIONES DE ERITROCITOS EN TECNICA DE GEL	SOLUCION DE BAJA FUERZA IONICA PARA PREPARAR SOLUCIONES DE ERITROCITOS EN TECNICA DE GEL
2502219	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	REACTIVO DE BAJA FUERZA IONICA, CONTIENE GLICINA, BUFFER FOSFATO Y ALBUMINA BOVINA, AZIDA DE SODIO AL 0.1% COMO PRESERVATIVO .	REACTIVO DE BAJA FUERZA IONICA, CONTIENE GLICINA, BUFFER FOSFATO Y ALBUMINA BOVINA, AZIDA DE SODIO AL 0.1% COMO PRESERVATIVO.
2504226	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	TECNICA GEL DETEC REACC AGLUTIN HEMATIES	TECNICA EN GEL PARA LA DETECCION DE LAS REACCIONES DE AGLUTINACION DE LOS HEMATIES. TECNICA PARA LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO E INDIRECTO
2503645	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	UNIDAD CRIOPRECIPITADOS	UNIDAD CRIOPRECIPITADOS, ES UN CONCENTRADO PREPARADO A PARTIR DEL PLASMA FRESCO CONGELADO
2503642	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS	UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS, LOS ERITROCITOS LEUCORREDUCIDOS O FILTRADOS, SE REFIERE A UNIDADES DE ERITROCITOS QUE CONTIENEN MENOS DE 1 X 106 LEUCOCITOS/UNIDAD Y MANTIENEN EL 85% DE LOS ERITROCITOS DEL PAQUETE ORIGINAL.

2503643	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	UNIDAD DE PLAQUETAS LEUCOREDUCIDAS	UNIDAD DE PLAQUETAS LEUCOREDUCIDAS
2503644	41116102	ZMQX	ZMQX-012	ZMQX-012-12	C/U	A.02.02.01.003.004	UNIDAD PLASMA FRESCO CONGELADO	EL PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC) ES UN PRODUCTO SANGUÍNEO HECHO DE LA PORCIÓN LÍQUIDA DE LA SANGRE ENTERA.1 SE UTILIZA PARA TRATAR AFECCIONES EN LAS QUE HAY NIVELES BAJOS DE LOS FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA (INR> 1,5) O NIVELES BAJOS DE OTRAS PROTEÍNAS SANGUÍNEAS.
INSTRUMENTAL QUIRURGICO CLAMPS								
Código genérico	**Código UNSPSC**	**Tipo de Material**	**Grupo de artículos**	**Subgrupo de artículos**	**Unidad de Medida**	**Rubro**	**Nombre**	**Especificación Técnica**
2580000	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP ANGULADO 45° PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-/L180-210mm	CLAMP ANGULADO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA LISA-DENTADA ANCHO DE AGARRE 2-5 mm -3-5 mm-9 mm -11 mm-MANDIBULAS CURVAS ANGULADAS 45° GRADOS HACIA LATERAL-MANGO RATCHETEN TERCIO MEDIO A MANERA DE BASTIDOR CON TUERCA TRANSVERSAL-LONGITUD 130 mm -160 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580001	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP ANGULADO PARA HUESO AGARRE 2-5-3-5mm-MANDIB CURV ANG 45°-MANGO RATCHETBASTIDORTUERCA AJUSTE TRANSVERSAL-LONG 130-160mm	CLAMP ANGULADO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA LISA-DENTADA ANCHO DE AGARRE 3-0 mm -4-0 mm X 10 mm -12 mm-MANDIBULAS CURVAS ANGULADAS 45° GRADOS HACIA LATERAL-MANGO RATCHETEN TERCIO MEDIO A MANERA DE BASTIDOR CON TUERCA DE AJUSTE TRANSVERSAL-LONGITUD 230 mm -260 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580002	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP ANGULADO PARA HUESO AGARRE 3-4mm X 10-11mm-MANDIB CURV ANG 45°-	CLAMP ANGULADO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA LISA-DENTADA ANCHO DE AGARRE 4-0 mm -5-0 mm X 11 CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 15 mm -25 mm-LONGITUD 75 mm -85 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100%-LONGITUD 270 mm -300 mm-

							MANGO RATCHETBASTIDORTUERCA AJUSTE TRANSVERLONG 230-260mm	ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580003	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP ANGULADO PARA HUESO AGARRE 4-5mm X 11-12mm-MANDIB CURV ANG 45°-MANGO RATCHETBASTIDORTUERCA AJUSTE TRANSV-LONG 270-300mm	CLAMP BULLDOG DE D'BAKEY CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO DELICADO)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 30 mm -40 mm-LONGITUD 95 mm -105 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROCION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580004	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP BULLDOG DE D'BAKEY CURVO PARA CIRUGIA VASCULARBOCA CREMALLERA-LARGO DE MORDIDA 15-25mm-LONGITUD 75-85mm-ACERO INOXIDA	CLAMP BULLDOG DE D'BAKEY CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO DELICADO)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 50 mm -55 mm-LONGITUD 110 mm -115 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORRSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580005	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP BULLDOG DE D'BAKEY CURVO PARA CIRUGIA VASCULARBOCA CREMALLERA-LARGO DE MORDIDA 30-40mm-LONGITUD 95-105mm-ACERO INOXIDABLE	CLAMP BULLDOG DE D'BAKEY CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO DELICADO)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 20 mm -30 mm-LONGITUD 80 mm -90 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSOSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580042	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP CURVO PARA HUESO BOCA DENTADA PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVAS ANGULADAS 45° GRADOS-LONG 120-150mm-ACERO INOXIDABLE	CLAMP CURVO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA DENTADA EN TODA SU LONGITUD-PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS FUERTES-CURVAS ANGULADAS 45° GRADOS-MANGO RATCHETEN TERCIO MEDIO A MANERA DE BASTIDORCON TUERCA DE AJUSTE TRANSVERSAL-LONGITUD 160 mm -190 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580043	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP CURVO PARA HUESO-BOCA DENTADA PUNTAS CONVERGENTES-MANGO RATCHETBASTIDORCON TUERCA DE AJUSTE TRANSVERSAL-LONG 160-190mm	CLAMP CURVO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA DENTADA EN TODA SU LONGITUD-PUNTAS CONVERGENTES-DIENTES-BOCA ESTRIADA LONGITUDINAL-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET3 -5 DIENTES-LONGITUD 150 mm-170 mm-ACERO QUIRURGICO-LONGITUD 220 mm -250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580045	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE ALLEN RECTO CON GARRA PARA CIRUGIA GENERAL Y PEDIATRICA-1 X 2 DIENTES BOCA ESTRIADA MANDIBULAS SUAVES-LONGITUD 150-170mm	CLAMP DE ASCH ANGULADO PARA HUESO CIRUGIA MAXILOFACIAL (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA FENESTRADA-MANDIBULA 3 DIENTES AGUDOS EN ANGULO RECTO-MANDIBULAS DE AGARRE FUERTE-MANGO ANILLADO CON RATCHET4 -6 DIENTES-LONGITUD 180 mm -210 mm RADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580051	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE BIRCHERGANSKE CURVO PARA HUESO-MENISCO Y CARTILAGO-BOCA CREMALLERA FUERTE-PUNTA 2X1 DIENTES	CLAMP DE BIRCHERGANSKE RECTO PARA HUESO (PINZA SOSTENEDORA-REPOSICIONADORA-APROXIMADORA)-BOCA DENTADA EN CREMALLERA DOBLE-LONGITUDINAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET5 -7 DIENTES-LONGITUD 240 mm-270 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-1O GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							AGUDOS-LONGITUD 180-210mm	
2580052	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE BIRCHERGANSKE RECTO PARA HUESO-BOCA DENTADA CREMALLERA DOBLE DESDE TERCIO MEDIO-MANDIBULAS FUERTES-LONGITUD 190-220mm	CLAMP DE BRUNNEREN BAYONETA PARA CIRUGIA GENERAL (COLON SIGMOIDE O ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRNAL-MANDIBULAS SUAVES-MANGO ANILLADO CON RATCHET3 -5 DIENTES-LONGITUD 150 mm-180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580054	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE CARMALT-ROCHESTERCURVO PARA CIRUGIA GENERAL-BOCA ESTRIADA LONGIT-MANDIBULAS SUAVES-LONGITUD 150-180mm-ACERO INOXIDABLE	CLAMP DE CARMALT-ROCHESTER CURVO PARA CIRUGIA GENERAL (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ESTRIADA LONGITUDINAL-MANDIBULAS SUAVES-MANGO ANILLADO CON RATCHET3 -5 DIENTES-LONGITUD 150 mm-180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580055	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE CARMALT-ROCHESTERCURVO PARA CIRUGIA GENERAL-BOCA ESTRIADA LONGIT-MANDIBULAS SUAVES-LONGITUD 190-220mm-ACERO INOXIDABLE	CLAMP DE CARMALT-ROCHESTER RECTO PARA CIRUGIA GENERAL (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ESTRIADA LONGITUDINAL-MANDIBULAS SUAVES-MANGO ANILLADO CON RATCHET3 -5 DIENTES-LONGITUD 190 mm-220 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580060	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE CASTAÑEDA ANGULADO PARA CIRUG VASC PEDIATRBOCA CREMALL	CLAMP DE CASTAÑEDA ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULAR PEDIATRICA -NEONATOS (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA ESTRIADA TRANSVERSAL-ANGULADA 90° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL-LARGO DE MORDIDA 25 mm -30 mm-MANDIBULAS SUAVES UAVES-MANGO

							CAPACID MORDIDA 30-35mm-MANDIB ANGUL 30°-45°-LONGITUD 110-130mm	CON RATCHET5 -8 DIENTES-PSEUDOCURVADO HACIA RETROGRADA-LONGITUD 110 mm-130 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO -100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580065	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN C PARA CIRUGIA VASCULARBOCA ANG C ABIERTA 45°X45° CAPACIDAD DE MORDIDA 30-40mm-LONG 190-220mm	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA DOBLE-ANGULADA EN "C" ABIERTA 45° X 45° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 55 mm -65 mm-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-PDEUDOCURVADO HACIA RETROGRADA-LONGITUD 250 mm-270 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580069	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN C PARA CIRUGIA VASCULARBOCA CREMALL ANG C 45°X70° CAPACIDAD DE MORDIDA 15-20mm-LONGITUD 160-180mm	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR PEDIÀTRICA (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA DOBLE-ANGULADA EN "C" ABIERTA 90° X 45° GRADOS PARA OCLUSION TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 20 mm -30 mm -MANDIBULAS SUAVES-ANGULADAS HACIA RETROGRADA-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-LONGITUD 160 mm-180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580070	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN C PARA CIRUGIA VASC PEDIÀTRBOCA ANG C ABIERTA 45°X45° CAPACIDAD DE MORDIDA 30-40mm-LONG 160-180mm	CLAMP DE COOLEY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR PEDIÀTRICA (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA AT-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA DOBLE-ANGULADA EN "C" 45° X 70° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 10 mm -15M -MANDIBULAS SUAVES-ANGULADAS HACIA RETROGRADA-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-LONGITUD 160 mm-180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580119	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE DARDIK ANGULADO PARA CIRUGIA	CLAMP DE DARDIK ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA DOBLE-LARGO DE

							VASCULARBOCA CREMALLERA DOBLE-MORDIDA 25-35mm-MANDIBULAS ANGULADAS 15°-30°-LONG 140-155mm	MORDIDA 25 mm -35 mm-MANDIBULAS SUAVES-ANGULADAS 90° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-LONGITUD 140 mm -155 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580120	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE DARDIK ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULARBOCA CREMALLERA DOBLE-MORDIDA 25-35mm-MANDIBULAS ANGULADAS 90°-LONGITUD 140-155mm	CLAMP DE DARDIK ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA DOBLE-LARGO DE MORDIDA 40 mm -50 mm-MANDIBULAS SUAVES-ANGULADAS 15° -30° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL-MANGO CON RATCHET DIENTES-LONGITUD 140 mm -155 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580127	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE D'BAKEY ANGULADO EN C PARA CIRUGIA VASCULARBOCA CREMALLERA ANGUL EN C ABIERTA 45°X70° MORDIDA 25-35mm-LONG 150-180mm	CLAMP DE D'BAKEY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-ANGULADA EN "C" ABIERTA 45° X 70° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 45 mm -55 mm-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-LONGITUD 200 mm-230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580310	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE POTTS ANGULADO PARA CIRUGIA VASC (TEJIDO REGULAR)-BOCA CREMALL SIMPLE-MORDIDA 25-35mm-MANDIB ANG 15°-25°-LONG 200-230mm	CLAMP DE POTTS ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 50 mm -60 mm-MANDIBULAS SUAVES-ANGULADAS 15° -25° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL-MANGO CON RATCHET520 0 mm -230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580311	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE POTTS ANGULADO PARA CIRUGIA VASC (TEJIDO REGULAR)-BOCA CREMALL SIMPLE-MORDIDA 25-35mm-MANGO ANG 15°-25°-LONG 200-230mm	CLAMP DE POTTS ANGULADO PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDO REGULAR)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-LARGO DE MORDIDA 50 mm -60 mm-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET5 -8 DIENTES-ANGULADO 15° -25° GRADOS-LONGITUD-8 DIENTES-LONGITUD 200 mm -230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580327	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN C PARA CIRVASC (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ANG C 45°X45°-CAPACIDAD MORDIDA 30-40mm-LONG 210-240mm	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA GRABADO ROMBO-PIRAMIDAL-ANGULADA EN "C" 45° X 45° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 25 mm -35 mm-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET8 -12 DIENTES-PSEUDOCURVADO HACIA RETROGRADA-LONGITUD 250 mm -280 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580328	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN C PARA CIRVASC (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ANG C 45°X45°-CAPACIDAD MORDIDA 45-55mm-LONG 250-280mm	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA GRABADO ROMBO-PIRAMIDAL-ANGULADA EN "C" 45° X 45° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 40 mm -50 mm-MANDIBULASSU AVES-MANGO CON RATCHET3 -5 DIENTES-PSEUDOCURVADO HACIA RETROGRADA-LONGITUD 250 mm -280 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580329	42291609	ZMQX	ZMQI-001	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN C PARA CIRVASC (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ANG C 45°X45°-	CLAMP DE SATINSKY ANGULADO EN "C" PARA CIRUGIA VASCULAR (ANASTOMOSIS-PRESION Y COMPRESION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA EN CREMALLERA SIMPLE-ANGULADA EN "C" 45° X 45° GRADOS PARA OCLUSIÒN TANGENCIAL-CAPACIDAD DE MORDIDA 60 mm -70 mm-MANDIBULAS SUAVES-MANGO CON RATCHET3 -5 DIENTES-PSEUDO CURVADO HACIA RETROGRADA-LONGITUD 250 mm -280 mm-ACERO

							CAPACIDAD MORDIDA 25-35mm-LONG 250-280mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
CURETAS Y CUCHARILLAS								
CODIGO GENERICO	**CODIGO UNSPSC**	**TIPO DE MATERIAL**	**GRUPO DE ARTICULOS**	**SUB-GRUPO DE ARTICULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RUBRO**	**NOMBRE GENERICO**	**ESPECIFICACION TECNICA**
2505603	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER CORTANTANTE-MALEABLE DE ANCHO 8mm-LONGITUD ENTRE 31 A 35 cm	CURETA UTERINA DE RECAMIER (SIMS) CORTANTE-MALEABLE-DE ANCHO 8mm-LONGITUD ENTRE 31 A 35 cm-DE MANGO HUECO EN ACERO QUIRUGICO DE ALTO GRADO 100%-RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580366	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA ASPIRADORA DE NOVAK-SCHOECKAERT PARA BIOP ENDOMETRIO-CONEXION LUER-LOCK-PUNTA ROMA-DENT- CAP AGARRE 8-12mm- LONG 230-260mm	CURETA ASPIRADORA DE NOVAK-SCHOECKAERT PARA BIOPSIA DE ENDOMETRIO- CONEXION LUER-LOCK- PUNTA ROMA-DENTADA CURVATURA ANATOMICA- BOCA 4 X 4 DIENTES RETROGRADOS-CAPACIDAD DE AGARRE 8.0 mm - 12 mm- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580368	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ASA DE BILLEAU PARA OTOLOGIA (CURETA DE CERUMEN)-ANILLO BORDE LISO- DIAM MAYOR 5.0mm-8.0mm X DIAM MENOR 2.0mm-5.0mm- LONG 150-1	ASA DE BILLEAU PARA OTOLOGIA (CURETA DE CERUMEN)- ANILLO ATRAUMATICO EN ASA BORDE LISO- OVALADO- DIAMETRO MAYOR 5.0 mm - 8.0 mm X D IAMETRO MENOR 2-0 mm - 5-0 mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE- LONGITUD TOTAL 150 mm - 170 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580369	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO-BOCA RECTA-	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA-DIAMETRO DE BOCA 2.0 mm - 3.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO CUADRANGULAR-

							EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO BOCA 2.3-5mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 210-240mm	LONGITUD 210 mm - 240 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580370	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA- DIAMET BOCA 3.6-5.5mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 210-240mm	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 3.6 mm - 5.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO CUADRANGULAR- LONGITUD 210 mm - 240 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ES TERILIZACION
2580371	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO BOCA 6.7-5mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 210-240mm	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 6.0 mm - 7.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO CUADRANGULAR- LONGITUD 210 mm - 240 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ES TERILIZACION
2580372	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAMET BOCA 2.5-4.5mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 150-180mm	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAMETRO DE BOCA 2.5 mm - 4.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- ACANALADO- CUADRANGULAR- LONGITUD 150 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580373	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO-BOCA RECTA-EN CUCHARILLA CORTANTE-REDONDA-DIAMETRO BOCA 5.7-5mm-VASTAGO RIGIDO- LONG 150-180mm	CURETA DE BRUNS RECTA PARA HUESO- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA-DIAMETRO DE BOCA 5.0 mm - 7.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- ACANALADO-CUADRANGULAR- LONGITUD 150 mm - 180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580401	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE HOUSE DOBLE EXTREMO RECTA PARA OTOLOGIA-BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA ROMA REDONDA-DIAMETRO DE LA BOCA 1.0 mm-1.1 mmX1.2 mm-1.3 mm	CURETA DE HOUSE DOBLE EXTREMO RECTA PARA OTOLOGIA- BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA ROMA- REDONDA- DIAMETROS DE BOCA 1.0 mm - 1.1 mm X1.-2 mm - 1.3 mm- VASTAGOS RIGIDOS-ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO-ANTIDESLIZANTE- LONGITUD 130 mm - 160 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580418	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA-CORTANTE-OVALAD-FENESTRAD-DIAM 4.9-5mm-VASTAGO RIGIDO- LONG 280-320mm	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA-FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 4.0 mm - 9.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580419	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECT-CORTANT-OVALAD-FENESTRAD-DIAM 21-25mm-	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA-FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 10 mm - 15 mm-VASTAGO MALEABLE- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESO S DE ESTERILIZACION

							VASTAGO MALEABLE- LONG 280-3	
2580420	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- ROMA- OVALADA- FENESTRADA- DIAM 4.0-9.5mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 280-3	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA- FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 10 mm - 15 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580422	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECT- CORTANT- OVALAD- FENESTRAD- DIAM 15.5-20mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 280-320mm	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA- FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 15-5 mm - 20 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580424	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECT- CORTANT- OVALADA- FENESTRADA- DIAM 21-25mm- VASTAGO RIGIDO- LONG 280-320mm	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA- FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 21 mm - 25 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580425	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECT-	CURETA DE RECAMIER RECTA PARA BIOPSIA UTERINA- BOCA RECTA- CORTANTE- OVALADA- FENESTRADA- DIAMETRO DE BOCA 26 mm - 30 mm- VASTAGOM ALEABLE- MANGO HUECO HEXAGONAL- LONGITUD 280 mm - 320 mm- ACERO

							CORTANT-OVALAD-FENESTRAD-DIAM 26-30mm-VASTAGO MALEABLE-LONG 280-320mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%- RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580447	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO-BOCA CUCHARILLA REC- CORTANT-OVALAD- DIAM BOCA 2.3-5mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO HEX- LONG 230-260mm	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA EN CUCHARILLA RECTA- CORTANTE- OVALADA-DIAMETRO DE BOCA 2.0 mm - 3.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- HEXAGONAL- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580448	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO-BOCA CUCHARILLA REC- CORTANT-OVALAD- DIAM BOCA 4.5-5mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO HEX- LONG 230-260mm	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA EN CUCHARILLA RECTA- CORTANTE- OVALADA-DIAMETRO DE BOCA 4.0 mm - 5.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- HEXAGONAL- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580449	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO-BOCA CUCHARILLA REC- CORTANT-OVALAD- DIAM BOCA 6.5-9mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO HEX- LONG 230-260mm	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA EN CUCHARILLA RECTA- CORTANTE- OVALADA-DIAMETRO DE BOCA 6.5 mm - 9.0 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- HEXAGONAL- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580450	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA CUCHARILLA REC- CORTANT- OVALAD- DIAM BOCA 9.5-12mm- VASTAGO RIGIDO- MANG HEX- LONG 230-260mm	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA EN CUCHARILLA RECTA- CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 9-5 mm - 12 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- HEXAGONAL- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION
2580451	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA CUCHARILLA REC- CORTANT- OVALAD- DIAM BOCA 13-15mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HEX- LONG 230-260mm	CURETA DE SIMON RECTA PARA HUESO- BOCA EN CUCHARILLA RECTA- CORTANTE- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 13 mm - 15 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO HUECO- HEXAGONAL- LONGITUD 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580475	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS CUCH CORT- OVALAD- REDOND- DIAM BOCAS 1.5-3.0mm X 2.5-4.5mm- LONG 120-150mm	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA-REDONDA- DIAMETROS DE BOCAS 1.5 mm- 3.0 mm X 2-5 mm - 4.5 mm- VASTAGOS RIGIDOS- MANGO PLANO ACANALADO- LONGITUD 120 mm - 150 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 10 0% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580476	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS CUCH CORT- OVALAD- REDOND- DIAM BOCAS 3.1-4.5mm X 4.6-	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADA-REDONDA- DIAMETROS DE BOCAS 3.1 mm- 4.5 mm X 4.6 mm - 65 mm- VASTAGOS RIGIDOS- MANGO PLANO ACANALADO- LONGITUD 155 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							6.5mm- LONG 155-180mm	
2580477	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS CUCHARILLA CORT-OVALADAS- DIAM BOCAS 1.5-3-0mm X 2.5-4.5mm- LONG 120-150mm	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADAS- DIAMETROS DE BOCAS 1.5 mm - 3.0 m m X 2.5 mm - 4.5 mm- VASTAGOS RIGIDOS- MANGO PLANO ACANALADO- LONGITUD 120 mm - 150 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580478	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS CUCHARILLA CORT-OVALADAS- DIAM BOCAS 3.1-4.5mm X 4.6-6.5mm- LONG 155-180mm	CURETA DE VOLKMANN DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO- BOCAS RECTAS EN CUCHARILLA CORTANTE- OVALADAS- DIAMETROS DE BOCAS 3.1 mm - 4.5 mm X 4.6 mm - 6-5 mm- VASTAGOS RIGIDOS- MANGO PLANO ACANALADO- LONGITUD 155 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581091	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA BECKMANN-BARNHILL TRAPEZO/13-16mm	CURETA DE BECKMANN-BARNHILL PARA ADENOIDES- BOCA CURVA- TRAPEZOIDAL-FENESTRADA- BORDE DISTAL INTERNO PSEUDOBISELADO- ANCHO 13 mm- 16 mm- MANGO CUADRANGULAR- ACANALADO- ANTIDESLIZANTE-LONGITUD 200 mm - 230 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581092	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE HURD DOBLE EXTREMO CURVO PARA AMIGDALAS-HOJAS CURVA-SILLA DE MONTAR-ANCHO 13-15mm X 10-12	CURETA DE BECKMANN-BARNHILL PARA ADENOIDES- BOCA CURVA- TRAPEZOIDAL-FENESTRADA- BORDE DISTAL INTERNO PSEUDOBISELADO- ANCHO 17 mm- 20 mm- MANGO CUADRANGULAR- ACANALADO- ANTIDESLIZANTE-LONGITUD 200 mm - 230 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTEA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							mm- LONG 210-24	
2581093	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE BECKMANN-BARNHILL (ADENOIDES)- BOCA CURVA- TRAPEZOIDA- FENESTRADA- BORDE DISTAL PSEUDOBISEL- ANCHO 21-24mm- LONG 200-230mm	CURETA DE BECKMANN-BARNHILL PARA ADENOIDES- BOCA CURVA- TRAPEZOIDAL- FENESTRADA- BORDE DISTAL INTERNO PSEUDOBISELADO- ANCHO 21 mm- 24 mm- MANGO CUADRANGULAR- ACANALADO- ANTIDESLIZANTE- LONGITUD 200 mm - 230 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583175	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAM 2.0-2.5mm- LONG 120-140mm	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAMETRO DE BOCA 1.0 mm - 1.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO- LISO- PLANO- LONGITUD TOTAL 120 mm - 140 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583176	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAM 2.0-2.5mm- LONG 120-140mm	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAMETRO DE BOCA 2.0 mm - 2.5 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO- LISO- PLANO- LONGITUD TOTAL 120 mm - 140 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583177	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAM 3.0-4.0mm-	CURETA DE MEYERHOEFER RECTA PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION)- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA CORTANTE- REDONDA- DIAMETRO DE BOCA 3.0 mm - 4.0- VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO- LISO- PLANO- LONGITUD TOTAL 120 mm - 140 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONG 120-140mm	
2583178	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE FOX RECTA PARA LUPUS- BOCA CUCHARILLA ROMA RECTA-OVALADA- DIAM BOCA 2.0-3.0mm X 4.0-5.0mm-VASTAGO RIGIDO- LONG 130-150mm	CURETA DE FOX RECTA PARA LUPUS- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA ROMA- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 2.0 mm - 3.0 mm X 4-0 mm - 5.0 mm - VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO LISO CUADRANGULAR- LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583179	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CURETA DE FOX RECTA PARA LUPUS- BOCA CUCHARILLA ROMA RECTA-OVALADA- DIAM BOCA 4.0-6.0mm X 6.0-8.0mm-VASTAGO RIGIDO- LONG 130-150mm	CURETA DE FOX RECTA PARA LUPUS- BOCA RECTA- EN CUCHARILLA ROMA- OVALADA- DIAMETRO DE BOCA 4.0 mm - 6.0 mm X 6-0 mm - 8.0 mm - VASTAGO RIGIDO- MANGO MACIZO LISO CUADRANGULAR- LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583221	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ASA DE LEWIS PARA OFTALMOLOGIA (LIO- ANSA DE LENTE)- ANILLO ASA ASERRADA- DIAM MAYOR 6.0-7.5mm X DIAM MENOR 3.5-4.5mm-LONG 130-145mm	ASA DE LEWIS PARA OFTALMOLOGIA (LIO- ANSA DE LENTE)- ANILLO ATRAUMATICO EN ASA ASERRADA- OVALADA- DIAMETRO MAYOR 6.0 mm - 7.5 mm X DIAMETRO MENOR 3.5 mm - 4.5 mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO LISO- PLANO-CUADRANGULAR- LONGITUD TOTAL 130 mm - 145 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583222	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ASA DE LEWIS PARA OFTALMOLOGIA (LIO- ANSA DE LENTE)- ANILLO ASA BORDE LISO- DIAM MAYOR 6.0-7.5mmXDIAM MENOR 3.5-	ASA DE LEWIS PARA OFTALMOLOGIA (LIO- ANSA DE LENTE)- ANILLO ATRAUMATICO EN ASA BORDE LISO- OVALADA- DIAMETRO MAYOR 6.0 mm - 7.5 mmX DIAMETRO MENOR 3.5 mm - 4.5 mm-VASTAGO RIGIDO- MANGO LISO- PLANO-CUADRANGULAR- LONGITUD TOTAL 130 mm - 145 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROS.ON Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							4.5mm- LONG 130-145mm	
2583223	42291611	ZMQX	ZMQI-002	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ASA DE NEW ORLEANS PARA OFTALMOLOGIA (ANSA DE LENTE)- ANILLO ASA BORDE LISO DIAM MAYOR 6.0-8.0mmXDIAM MENOR 3.5-5.0mm- LONG 130-145mm	ASA DE NEW ORLEANS PARA OFTALMOLOGIA (LIO-ANSA DE LENTE)- ANILLO ATRAUMATICO EN ASA BORDE LISO- OVALADA- DIAMETRO MAYOR 6.0 mm - 8.0 mm X DIAMETRO MENOR 3-5 mm - 5-0 mm- VASTAGO RIGIDO- MANGO LISO- PLANO-CUADRANGULAR- LONGITUD TOTAL 130 mm - 145 mm- ACEROQ UIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

ESPECULOS Y ANOSCOPIOS

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2580497	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE FARRIOR PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 5.5-6.5mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE FARRIORPARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 5.5 mm - 6.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO CROMADO NEGRO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580498	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE FARRIOR PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 7.5-8.5mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE FARRIORPARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 7.5 mm - 8.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO CROMADO NEGRO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580499	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE FARRIOR PARA DILATACION Y EXPOSICION	ESPECULO AURICULARDE FARRIORPARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 9.5 mm - 10.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm.

							TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 9.5-10.5mm. LONG 30-40mm	ACERO QUIRURGICO CROMADO NEGRO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580500	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE FARRIOR PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDA (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 11.5-12.5mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE FARRIORPARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 11.5 mm - 12.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO CROMADO NEGRO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580505	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 6.0-7.0mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 6.0 mm - 7.0 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580506	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO DIAM LUZ 7.5-8.5mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). CONO PUNTA REDONDA- ROMA- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 7.5 mm - 8.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580507	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO-PEDIAT)-CONO	ESPECULO AURICULARDE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO-PEDIATRICO). CONO PUNTA REDONDA- ROM A- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 3.0 mm - 4.0 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							DIAMETRO LUZ 3.0-4.0mm-LONG 30-40mm	
2580508	42182005	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO AURICULAR DE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION TEJIDOS EN PROF (OTORRINO-PEDIAT). CONO DIAM LUZ 4.5-5.5mm. LONG 30-40mm	ESPECULO AURICULARDE TOYNBEE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO-PEDIATRICO). CONO PUNTA REDONDA- ROM A- ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 4.5 mm - 5.5 mm. LONGITUD 30 mm - 40 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580514	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE COTTLE PARA OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA ATRAUMATICA- PROFUNDIDAD 30-40mm. LONG 120-140mm	ESPECULO NASAL DE COTTLE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO - PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 30 mm - 40 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 120 mm - 140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580515	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE COTTLE PARA OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA ATRAUMATICA- PROFUNDIDAD 45-55mm. LONG 120-140mm	ESPECULO NASAL DE COTTLE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO - PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 120 mm - 140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580518	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE HARTMANN-HALLE OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANG RECTO-PUNTA	ESPECULO NASAL DE HARTMANN-HALLE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 25 mm - 30 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO

							ATRAUMATICA- PROFUNDIDAD 25-30mm. LONG 150-170mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580519	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE HARTMANN-HALLE OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANG RECTO-PUNTA ATRAUMATICA-PROFUNDIDAD 31-35mm. LONG 150-170mm	ESPECULO NASAL DE HARTMANN-HALLE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 31 mm - 35 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580520	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE KILLIAN PARA OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANG RECTO-PUNTA ATRAUMATICA-PROFUNDIDAD 30-40mm. LONG 130-150mm	ESPECULO NASAL DE KILLIAN PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 30 mm - 40 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580521	42182012	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO NASAL DE KILLIAN PARA OTORRINO. RAMAS MEDIA CAÑA CONICA ANG RECTO-PUNTA ATRAUMATICA-PROFUNDIDAD 45-55mm. LONG 130-150mm	ESPECULO NASAL DE KILLIAN PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (OTORRINO). RAMAS EN MEDIACAÑA CONICA ANGULO RECTO- PUNTA PLANA ATRAUMATICA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580529	42182001	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO RECTAL DE ALAN PARKS COLOPROCTOL. TRES VALVAS REMOVIBL PROF 70-90mm X ANCHO 20-25mm. TORNILLO AJUSTE TRANSV. LONG 140-160mm	ESPECULO RECTAL DE ALAN PARKS PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (COLOPROCTOLOGIA). TRES VALVAS REMOVIBLES LEVE CURVATURA CONCAVA EN TERCIO MEDIAL Y PLANA ATRAUMATICA EN TERCIO DISTAL- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 90 mm X ANCHO 20 mm - 25 mm. TORNILLO MARIPOSA DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS- VALVA MEDIAL CON MANGO FENESTRADO PARA ADAPTARSE A ESPECULO. MANGO ANILLADO CON RATCHET. LONGITUD 140 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580543	42182013	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO PARA GINECOLOGIA-VIRGINAL. RAMAS DESMONTABLES- PROF 70-80mm X ANCHO 15-20mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVERSAL	ESPECULO VAGINAL DE CUSCO PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (GINECOLOGIA- VIRGINAL). RAMAS DESMONTABLES- EN MEDIACAÑA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 80 mm X ANCHO 15 mm - 20 mm. TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA DESMONTAJE- APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580547	42182013	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VAGINAL DE GRAVE PARA GINECOLOGIA-VIRGINAL. RAMAS DESMONTABLES- PROF 70-85mm X ANCHO 15-20mm. TORNILLOS AJUSTE TRANSVER	ESPECULO VAGINAL DE GRAVE PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (GINECOLOGIA- VIRGINAL). RAMAS DESMONTABLES- EN MEDIACAÑA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 85 mm X ANCHO 15 mm - 20 mm. TORNILLOS DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA DESMONTAJE- APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580548	42182013	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VAGINAL DE GRAVE PARA GINECOLOGIA. RAMAS DESMONTABLES-	ESPECULO VAGINAL DE GRAVE PARA GINECOLOGIA. RAMAS DESMONTABLES- PROFUNDIDAD 90-105mm X ANCHO 30-35mm. TORNILLOS AJUSTE TRANSVERSALES

							PROFUNDIDAD 90-105mm X ANCHO 30-35mm.	
2580549	42182013	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VAGINAL DE PEDERSON PARA GINECOLOG-VIRGINAL. RAMAS DESMONTABLES- PROF 70-85mm X ANCHO 10-15mm. TORNILLOS AJUSTE TRANSVERSAL	ESPECULO VAGINAL DE PEDERSON PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (GINECOLOGIA- VIRGINAL). RAMAS DESMONTABLES- EN MEDIACAÑA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 85 mm X ANCHO 10 mm - 15 mm. TORNILLOS DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA DESMONTAJE- APERTURAY FIJACION DE RAMAS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580550	42182013	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VAGINAL DE PEDERSON PARA GINECOLO-VIRGINAL. RAMAS DESMONTABLES- PROF 90-105mm X ANCHO 20-25mm. TORNILLOS AJUSTE TRANSVERSAL	ESPECULO VAGINAL DE PEDERSON PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (GINECOLOGIA- VIRGINAL). RAMAS DESMONTABLES- EN MEDIACAÑA- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 90 mm - 105 mm X ANCHO 20 mm - 25 mm. TORNILLOS DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA DESMONTAJE- APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580555	42182001	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO ANOSCOPIO DE IVES-FANSLER CON MANDRIL PARA COLOPROCTOLO. TUBO ANG 45°- DIAM LUZ 20-25mm- LARGO UTIL 80-90mm. LONG 130-160mm	ESPECULO ANOSCOPIO DE IVES-FANSLERCON MANDRIL PARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (COLOPROCTOLOGIA). TUBO ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- DIAMETRO DE LUZ 20 mm - 25 mm- LARGO UTIL 80 mm - 90 mm. MANDRIL PUNTA ROMA REDONDEADA ATRAUMATICA. MANGO PLANO FENESTRADO EN LAGRIMA. LONGITUD 130 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580573	42182003	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO VALVA/RETRACTOR DE KRISTELLER PARA GINECOLOGIA. VALVA MEDIA CAÑA ANG 90°-PROFUNDID 65-75mm X ANCHO 15-20mm. LONG 170-190mm	ESPECULO VALVA/RETRACTORDE KRISTELLERPARA DILATACION Y EXPOSICION DE TEJIDOS EN PROFUNDIDAD (GINECOLOGIA). VALVA EN MEDIACAÑA AN GULADA 90° GRADOS-ALCANCE DE PROFUNDIDAD 65 mm - 75 mm X ANCHO 15 mm - 20 mm. MANGO EN PSEUDO-MEDIA CAÑA LONGITUDINAL- CURVATURA ANATOMICA HACIA DISTAL. LONGITUD 170 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581638	42182014	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE ALM AUTOESTATICO. PUNTA 4X4 DIENTES AGUDOS CURVOS HACIA LATERAL-TORNILLO DE AJUSTE-APERTURA. LONG 70-100mm	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE ALM AUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA). PUNTA 4 X 4 DIENTES AGUDOS CURVOS HACIA LATERAL- TORNILLO DE AJUSTE ENTRE RAMAS PARA SU APERTURA. LONGITUD 70 mm - 100 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581639	42182014	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE ALM AUTOESTATICO. PUNTA 4X4 DIENTES ROMOS CURVOS HACIA LATERAL-TORNILLO DE AJUSTE-APERTURA. LONG 70-100mm	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE ALM AUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA). PUNTA 4 X 4 DIENTES ROMOS CURVOS HACIA LATERAL- TORNILLO DE AJUSTE ENTRE RAMAS PARA SU APERTURA. LONGITUD 70 mm - 100 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581642	42182014	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO/BLEFAROSTATO BARRAQUER AUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA ADULTOS). L40-50mm	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE BARRAQUER AUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA ADULTOS). VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA-- LONGITUD DE LA HOJA 15 mm O 14 mm-EN ACERO QUIRURGICODE ALTO GRADO 100% RESISTENTE A PROCESOS DE CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581653	42182014	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE LANCASTER AUTOESTATICO . VALVAS SILLA MONTAR- PROF 4-6mm X ANCHO 8-10mm. TORNILLO AJUST TRANSV. LONG 70-90mm	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE LANCASTER AUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA). VALVAS EN SILLA DE MONTARHACIA MEDIAL- PROFUNDIDAD 4.0 mm - 6.0 mm X ANCHO 8.0 mm - 10 mm. TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL ENTRE RAMAS PARA SU APERTURA Y FIJACION. LONGITUD TOT AL 70 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583209	42182014	ZMQX	ZMQI-003	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE BARRAQUER AUTOESTATICO (OFTALM PEDIATR). VALVA CANASTILLA FENESTRADA-RAMAS ALAMBRE RETRACTIL. LONG 25-35mm	ESPECULO/BLEFAROSTATO DE BARRAQUERAUTOESTATICO PARA TEJIDO DELICADO (OFTALMOLOGIA PEDIATRICA). VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA HACIA LATERAL-RAMAS EN ALAMBRE RETRACTIL PARA SU APERTURA. LONGITUD 25 mm - 35 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE ACORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

CORTE OSEO

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2505628	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE LAMBOTTE-MINI RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO-CRANEOFACIAL). VASTAGO RECTO-ANCHO 3.0 mm-LARGO UTIL 17cm/6(6/8")	CINCEL OSTEOTOMO DE LAMBOTTE-MINI RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO-CRANEOFACIAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 3.0mm- LARGO UTIL 17cm/6(6/8"). ZONA DE AGARRE- MACIZA- LISA-PLANA- ENSANCHADA HACIA DISTAL PARA FACILITARP ERCUSION. LONGITUD TOTAL 170mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2505629	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO ANGULADO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA ANGULADA 45° GRADOS-BORDE AGUDO-BISELADO-ANCHO 6mm-LONGITUD TOTAL 20cm / 7 (7/8")	PERIOSTOTOMO ANGULADO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA ANGULADA 45° GRADOS-BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 6mm. MANGO MACIZO SILICONIZADO- LISO- CUADRANGULAR. LONGITUD TOTAL 20cm / 7 (7/8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTEA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505774	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	OSTEOTOMO SEPTUM NASAL OBWEGES18.4cm.4mm	OSTEOTOMO SEPTUM NASAL OBWEGES18.4cm-4mm OSTEOTOMO/CINCELES SEPTUM NASAL OBWEGESER 18.4cm-4mm ACERO INOXIDABLE
2580588	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA-ORL- MAXILO). HOJA UNIBISEL-ANCHO 4.0-6.0MM- LARGO UTIL 65-75MM. LONG 140-170MM	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 4.0 MM - 6.0 MM- LARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO-MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL14 0 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580589	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA-ORL- MAXILO). HOJA UNIBISEL-ANCHO 8.0-10MM- LARGO UTIL 65-75MM. LONG 140-170MM	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 8.0 MM - 10 MM-L ARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO-MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 14 0 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580590	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA-ORL- MAXILO).	CINCEL DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 12 MM - 14 MM- LARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO-MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD

							HOJA UNIBISEL-ANCHO 12-14MM- LARGO UTIL 65-75MM. LONG 140-170MM	TOTAL 14 0 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580591	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE FREER CURVO PARA HUESO (ORL- TABIQUE NASAL). HOJA CURVA UNIBISEL-ANCHO 4.0-6.0MM- LARGO UTIL 8.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL DE FREER CURVO PARA HUESO (ORL-TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA CURVA-PERFIL DELGADO- UNIBISEL- ANCHO 4.0 MM - 6.0 MM- LARGO UTIL 8.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE TUBULAR- ANTIDESLIZANTE- MINI TOPE DE SUJECION Y REDONDEADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580592	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE FREER RECTO PARA HUESO (ORL- TABIQUE NASAL). HOJA RECTA UNIBISEL-ANCHO 4.0-6.0MM- LARGO UTIL 8.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL DE FREER RECTO PARA HUESO (ORL-TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO- UNIBISEL- ANCHO 4.0 MM - 6.0 MM- LARGO UTIL 8.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE TUBULAR- ANTIDESLIZANTE- MINI TOPE DE SUJECION Y REDONDEADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580597	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE GARDNER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL-ANCHO 3.0-5.0MM- LARGO UTIL 25-30MM. LONG 150-180MM	CINCEL DE GARDNER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 3.0 MM - 5.0 MM- L ARGO UTIL 25 MM - 30 MM. MANGO MACIZO TUBULAR. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE AC ORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580598	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE HIBBS CURVO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 5.0-9.0MM- LARGO UTIL 60-70MM. LONG 220-250MM	CINCEL DE HIBBS CURVO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO CURVO HACIA DISTAL. HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 5.0 MM - 9.0 MM- LARGO UTIL 60 MM - 70 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 220 MM - 250 MM.AC ERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580599	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE HIBBS CURVO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 10-14MM- LARGO UTIL 60-70MM. LONGITUD 220-250MM	CINCEL DE HIBBS CURVO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO CURVO HACIA DISTAL. HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 10 MM - 14 MM- LARGO UTIL 60 MM - 70 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 220 MM - 250 MM. ACER O QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580603	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE HIBBS RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 5.0-9.0MM- LARGO UTIL 60-70MM. LONGITUD 220-250MM	CINCEL DE HIBBS RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 5.0 MM - 9.0 MM- LARGO UTIL 60 MM- 70 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 220 MM - 250 MM. ACERO QUIRURGIC O DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580604	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE HIBBS RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 10-14MM- LARGO UTIL 60-70MM. LONGITUD 220-250MM	CINCEL DE HIBBS RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 10 MM - 14 MM- LARGO UTIL 60 MM -7 0 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 220 MM - 250 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580610	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE PARTSCH RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). HOJA UNIBISEL- ANCHO 2.0- 4.0MM- LARGO UTIL 30-40MM. LONG 140- 170MM	CINCEL DE PARTSCH RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 2.0 MM - 4.0 MM- L ARGO UTIL 30 MM - 40 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL1 40 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580611	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL DE PARTSCH RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). HOJA UNIBISEL- ANCHO 5.0- 7.0MM- LARGO UTIL 30-40MM. LONG 140- 170MM	CINCEL DE PARTSCH RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 5.0 MM - 7.0 MM- L ARGO UTIL 30 MM - 40 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL1 40 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580612	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL STILLE RECTO 10-14MM /L 190-220MM	CINCEL DE STILLE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL GRUESO-UNIBISEL- ANCHO 10 MM - 14 MM- LARGO UTIL 40 MM - 50 MM. MANGO HEXAGONAL- CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 190 MM - 220 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580618	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). HOJA PERFIL DELGADO- UNIBISEL- ANCHO 4.0- 5.5MM- LARGO UTIL 35-45MM. LONG 120- 150MM	CINCEL RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-UNIBISEL- ANCHO 4.0 MM - 5.5 MM- LARGO UTIL 3 5 MM - 45 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 120 MM - 15 0 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580623	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOP-ORL- MXF). HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 5.0-7.0MM- LARGO 65-75MM. LONG 150-180MM	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO-MEDIA CAÑA- HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 5.0 MM- 7.0 MM- LARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO- MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580624	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOP-ORL- MXF). HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 8.0-10MM- LARGO 65-75MM. LONG 150-180MM	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO-MEDIA CAÑA- HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 8.0 MM- 10 MM- LARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO- MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580625	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOP-ORL- MXF). HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 11-14MM- LARGO 65-75MM. LONG 150-180MM	CINCEL GUBIA DE ALEXANDER RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO-MEDIA CAÑA- HOJA CONCAVA-SEMIROMA-ANCHO 11 MM - 14 MM- LARGO UTIL 65 MM - 75 MM. MANGO PLANO- MACIZO- LISO CON TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580693	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE COTTLE RECTO PARA HUESO (ORL). GRAD EN CM. HOJA COLA DE PEZ- ANCHO 8.0-10MM- LARGO UTIL 60-70MM. LONG 170-200MM	CINCEL OSTEOTOMO DE COTTLE RECTO PARA HUESO (ORL- TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO GRADUADO EN CENTIMETROS DESDE TERCIO MEDIO. HOJA RECTA EN COLA DE PEZ- PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 8.0 MM - 10 MM- LARGO UTIL 60 MM - 70 MM. ZONA DE AGARRE MACIZA- LISA- PLANA-ENSANCHADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 170 MM - 200 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTEA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580702	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA IZQUIERD PARA HUESO. HOJA GUIA REDONDEADA-ANCHO 4.0-5.0MM- LARGO UTIL 7.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA PROLONGADA A LA IZQUIERDA PARA HUESO (TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL MEDIO-GUIA REDONDEADA- ANCHO 4.0 MM - 5.0 MM- LARGO UTIL 7.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE MACIZA- TUBULAR- SEMIABOTONADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580703	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA IZQUIERD PARA HUESO. HOJA GUIA REDONDEADA-ANCHO 6.0-7.0MM- LARGO UTIL 7.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA PROLONGADA A LA IZQUIERDA PARA HUESO (TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL MEDIO-GUIA REDONDEADA- ANCHO 6.0 MM - 7.0 MM- LARGO UTIL 7.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE MACIZA- TUBULAR- SEMIABOTONADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580716	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL DELGADO-SEMIRO-ANCHO 2.0-4.0-LARGO UTIL 25-35MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 2.0 MM - 4.0 MM- LARGO U TIL 25 MM - 35 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580717	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL DELGADO-SEMIRO-	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 5.0 MM - 7.0 MM- LARGO U TIL 25 MM - 35 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ANCHO 5.0-7.0-LARGO UTIL 25-35MM. LONG 150-180MM	
2580718	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROM-ANCHO 8.0-10-LARGO UTIL 25-35MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE HOKE RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 8.0 MM - 10 MM- LARGO UT IL 25 MM - 35 MM. MANGO MACIZO HEXAGONAL- REDONDEADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580719	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOT LAMBOTTE CURV5-9MM/230-260	CINCEL OSTEOTOMO DE LAMBOTTE CURVO PARA HUESO (ORTOPEDIA). VASTAGO CURVO HACIA DISTAL. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA-ANCHO 5.0 MM- 9.0 MM- LARGO UTIL 30 MM - 40 MM. ZONA DE AGARRE- MACIZA- LISA- PLANA-ENSANCHADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 230 MM - 260 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580804	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA-ORL- MXF). HOJA PERFIL DELGADO-ANCHO 4.0-5.5MM- LARGO UTIL 35-45MM. LONG 120-150MM	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 4.0 MM - 5.5 MM- LARGO UTIL 35 MM - 45 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL1 20 MM - 150 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580805	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA-ORL- MXF). HOJA PERFIL DELGADO-	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 6.0 MM - 8.0 MM- LARGO UTIL 35 MM - 45 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL1 20 MM - 150 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							ANCHO 6.0-8.0MM- LARGO UTIL 35-45MM. LONG 120-150MM	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580806	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MXF). HOJA PERFIL DELGADO-ANCHO 10-12MM- LARGO UTIL 35-45MM. LONG 120-150MM	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 10 MM - 12 MM- LARG O UTIL 35 MM - 45 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 120 MM - 150 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580807	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MXF). HOJA PERFIL DELGADO-ANCHO 14-16MM- LARGO UTIL 35-45MM. LONG 120-150MM	CINCEL OSTEOTOMO RECTO PARA HUESO (ORTOPEDIA- ORL- MAXILO). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL DELGADO-SEMIROMA- ANCHO 14 MM - 16 MM- LARGO UTIL 35 MM - 45 MM. MANGO PLANO- MACIZO- ACANALADO CON TOPE ENSANCHADO HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 120 MM - 150 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580809	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CIZALLA DE BÖHLER ANGULADA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES ANG 15°-25°- PROFUNDIDAD 10-20MM. LONG 130-160MM	CIZALLA DE BÖHLER ANGULADA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES ANGULADAS 15° - 25° GRADOS- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 10 MM - 20 MM. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 130 MM - 16 0 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580810	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CIZALLA DE BÖHLER RECTA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 10-20MM. LONGITUD 130-160MM	CIZALLA DE BÖHLER RECTA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 10 MM - 20 MM. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 130 MM - 160 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580818	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CIZALLA DE LISTON RECTA PARA HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES- ALCANCE PROFUNDIDAD 25-35MM. LONGITUD 140-170MM	CIZALLA DE LISTON RECTA PARA HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES - ALCANCE DE PROFUNDIDAD 25 MM - 35 MM. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 140 MM - 170 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580819	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CIZALLA DE LISTON RECTA PARA HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES- ALCANCE PROFUNDIDAD 25-35MM. LONGITUD 200-230MM	CIZALLA DE LISTON RECTA PARA HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA (ORTOPEDIA). HOJAS CORTANTES - ALCANCE DE PROFUNDIDAD 25 MM - 35 MM. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD 200 MM - 230 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580871	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	MARTILLO PARA IMPACTO MEDIO-BAJO (ORL- MXF). CABEZA DISCOS SUPERF SUAVE-RUG PERFIL PLAN DIAM 25-30MM.	MARTILLO PARA IMPACTO MEDIO-BAJO (ORL-MAXILO). CABEZA MACIZA EN BARRIL CON DISCOS SUPERFICIE SUAVE-RUGOSA- PERFIL PLANO-DIAMETRO2 5 MM - 30 MM. PESO 170 GR - 200 GR. MANGO MACIZO EN FORMA DE BATE- LISO. LONGITUD TOTAL 170 MM - 200 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALT O GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							PESO 170-200GR. LONG 170-200MM	
2580872	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	MARTILLO PARA IMPACTO MEDIO-BAJO (ORL). CABEZA DISCOS SINTËTIC INTERCAMB-PERFIL CONVX-DIAM 30-35MM. PESO 180-210GR. LONG 230-260MM	MARTILLO PARA IMPACTO MEDIO-BAJO (ORL-CRANEOFACIAL). CABEZA EN BARRIL- DISCOS SINTËTICOS INTERCAMBIABLES- ROSCA-AJUSTABLES- SUPERF ICIE SUAVE- PERFIL CONVEXO- DIAMETRO 30 MM - 35 MM. PESO 180 GR - 210 GR. MANGO SINTETICO- MACIZO-TORNEADO ANATOMICAMENTE. LONGITUD TOTAL 230 MM - 260 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2584545	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA DER PARA HUESO. HOJA GUIA REDONDEADA-ANCHO 4.0-5.0MM- LARGO UTIL 7.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA PROLONGADA A LA DERECHA PARA HUESO (TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL MEDIO-SEMIROMA - GUIA REDONDEADA- ANCHO 4.0 MM - 5.0 MM- LARGO UTIL 7.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE MACIZA- TUBULAR- SEMIABOTONADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION
2584546	42291606	ZMQX	ZMQI-004	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA DER PARA HUESO. HOJA GUIA REDONDEADA-ANCHO 6.0-7.0MM- LARGO UTIL 7.0-10MM. LONG 150-180MM	CINCEL OSTEOTOMO DE FOMON RECTO GUIA PROLONGADA A LA DERECHA PARA HUESO (TABIQUE NASAL). VASTAGO RECTO. HOJA PERFIL MEDIO-SEMIROMA - GUIA REDONDEADA- ANCHO 6.0 MM - 7.0 MM- LARGO UTIL 7.0 MM - 10 MM. ZONA DE AGARRE MACIZA- TUBULAR- SEMIABOTONADA HACIA DISTAL PARA FACILITAR PERCUSION. LONGITUD TOTAL 150 MM - 180 MM. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION

CORTE PUNCION								
CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2505147	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 23 cm / 9"	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 23 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505148	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 11.5 cm / 9"	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 11.5 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505149	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 18 cm	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 18 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505150	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 15.5 cm / 9"	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 15.5 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505151	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 20.5 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ROMA HOJAS CURVAS LONG 20.5 cm / 9"	
2505152	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 28.5 cm / 9"	TIJERA DE METZENBAUM ESTANDAR CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS PUNTA ROMA HOJAS CURVAS LONG 28.5 cm / 9"ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505153	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA NASAL COTTLR"CURVA "-MANGO ANGULADO-CUCHILLAS PLANAS-ASAS DE ANILLO ERGONOMICA-LONGITUD 16 cm – 6 1/4"	TIJERA NASAL COTTLR"CURVA"-MANGO ANGULADO-CUCHILLAS PLANAS-ASAS DE ANILLO ERGONOMICA-LONGITUD 16 cm – 6 1/4"-SE UTILIZA PARA LA DISECCION ROMA Y CORTE DE TEJIDOS BLANDOS ESPECIALMENTE EL CARTILAGO NASAL-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO 100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505154	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA FINA PARA IRIDECTOMIA-CURVA- AGUDA-LONGITUD 9 cm	TIJERA FINA PARA IRIDECTOMIA-CURVA- AGUDA-LONGITUD 9 cm-SE UTILIZA PARA CORTE Y DISECION EN CIRUGIA PLASTICA-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO 100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505626	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	MICRO CUCHILLO TABB-AURICULAR-PARA MUCOSA. LONGITUD DE 15-5 cm / 6 (1/8")	MICRO CUCHILLO TABB- AURICULAR- PARA MUCOSA. LONGITUD DE 15-5 cm / 6 (1/8"). EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE ACORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505627	42292603	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	MICROSONDA HOUSR AURICULAR-LONGITUD DE 15-5 cm/6 (1/8")	MICROSONDA HOUSR AURICULAR- LONGITUD DE 15-5 cm/6 (1/8"). EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505767	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA WESTCOTT CURVA PTA ROMA/L11 cm TIJERA DE WESTCOTT RECTA PARA CIRUGIA	TIJERA WESTCOTT CURVA PTA ROMA/L11 cm TIJERA DE WESTCOTT RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA -TIJERAS WESTCOTT DE TENOTOMIA CURVAS- PUNTA ROMA- LAMINAS 13mm- MANGO PLANO- TITANIO O ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. TIJERA DE WESTCOTT ROMA/ROMA. PARA TENOTOMIA-CURVA- HOJAS DE 13 mm- MANGO PLANO CON PIN.

							OFTALMOLOGICA	LONGITUD 11 cm. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
2580892	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE D'BAKEY ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJA ANGULADA 25° GRADOS. MANGO ANILLOS DORADOS. LONG 180mm-230mm	TIJERA DE D'BAKEY ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJA ANGULADA 25° GRADOS. MANGO ANILLOS DORADOS. LONGITUD TOTAL 1 80 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580893	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE D'BAKEY ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJA ANGULADA 45° - 60° GRADOS. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE D'BAKEY ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJA ANGULADA 45° - 60° GRADOS. LONGITUD TOTAL 150 mm - 170 mm. A CERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580897	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE CASTROVIEJO ANGULADA CIRUGIA OFTALMO (CORNEA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ANG 45° ARRIBA LONG 5.0 mm - 7.0 mm. LONG 90-110mm	TIJERA DE CASTROVIEJO ANGULADA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CORNEA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS DELICADAS- ANGULADAS 45° GRADOS HACIA ARRIBA LONGITUD 5.0 mm - 7.0 mm. MANGO DOBLE RAMA- ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580898	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE CASTROVIEJO CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CORNEA). PUNTA ROMA	TIJERA DE CASTROVIEJO CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CORNEA). PUNTA ROMA FINA. HOJAS DELICADAS CURVA PROLONGADA LONGITUD 13 mm- 15 mm. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE

							FINA. HOJAS CURVA PROLONGADA LONG 13-15mm. LONG 90-110mm	ALTO GRADO- 100% RESIS TENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580899	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE CASTROVIEJO CURVA-ANGULADA CIRUGIA OFTALMOLOG(CORNEA). PUNTA AGUDA. HOJAS CURVA-ANG 45° ARRIBA LONG 5mm-7mm. LONG 90-110mm	TIJERA DE CASTROVIEJO CURVA-ANGULADA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CORNEA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS DELICADAS CURVA-ANGULADAS 45° GRADOS HACIA ARRIBA LONGITUD 5.0 mm - 7.0 mm. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580901	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE COTLE ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. MANGO ANILLOS DORADOS ANGULAD 45° GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 140-170mm	TIJERA DE COTLE ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. MANGO ANILLOS DORADOS-ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 140M M - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580912	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE FOMON ANGULADA PARA RINOLOGIA-PUNTA ROMA. MANGO ANGULADO 45° GRADOS-LONGITUD 130 mm - 160 mm	TIJERA DE FOMON ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. MANGO ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 130 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580913	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE FOMON ANGULADA PARA	TIJERA DE FOMON ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. MANGO ANILLOS DORADOS ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 130 M M - 160 mm. ACERO QUIRURGICO

							RINOLOGIA. PUNTA ROMA. MANGO ANILLOS DORADOS ANG 45° GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 130-160mm	DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580914	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE HEYMANN (KNIFE) ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJAS ANG 45° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO. LONG 165-195mm	TIJERA DE HEYMANN (KNIFE) ANGULADA PARA RINOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJAS ANGULADAS 45° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO. LONGI TUD 165 mm - 195 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580921	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE LANDOLT CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGIC A (ENUCLEACION) . PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 95-125mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE LANDOLT CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (ENUCLEACION). PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 95 mm - 125 mm. ACERO QUIRU RGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580923	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL. PUNTA AGUDA. HOJA CURVA. LONG 140-170mm. ACERO QUIRURGICO ALTO GRADO 100%	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL. PUNTA AGUDA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RE SISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							RESISTENTE A CORROSION	
2580924	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL-PUNTA ROMA-HOJAS CURVAS-LONGITUD 140 mm - 170 mm	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580925	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE MALTZ RECTA PARA ORTOP-MXLF- ORL. HOJA TALLADO ESCALONADO-AGUDA-CORTANTE A EMPUJR ANCHO 7.0-10mm. LONG 170-200mm	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 180 mm - 215 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580928	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL. PUNTA AGUDA. HOJA RECTA. LONG 140-170mm. ACERO QUIRURGICO ALTO GRADO 100% RESISTENTE A CORROSION	TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL. PUNTA AGUDA. HOJAS RECTAS. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RE SISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580929	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL-PUNTA ROMA-HOJAS RECTAS-LONGITUD 140 mm - 170 mm	TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL-PUNTA ROMA-HOJAS RECTAS-LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580935	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS., I	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 110 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE AL TO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							kj'+'PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 110 mm - 160 mm	
2580936	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONG 165-215mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 165 mm - 215 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580937	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. MANGO ANILLO DORAD. LONG 110-160mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE METZENBAUM CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. MANGO ANILLOS DORADOS. LONGITUD 110 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580943	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE METZENBAUM-BABY CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONG 115-155mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO	TIJERA DE METZENBAUM-BABY CURVA PARA DISECCION DE TEJIDOS. PUNTA ROMA. HOJAS CURVAS. LONGITUD 115 mm - 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2580969	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE OLIVECRONA ANGULADA PARA NEURORINOLOGIA (NERVIO TRIGEMINO). PUNTA ROMA. HOJAS DENTADAS. MANDIB ANG 75°-90°. LONG 200-230mm	TIJERA DE OLIVECRONA ANGULADA PARA NEUROCIRUGIA Y RINOLOGIA (NERVIO TRIGEMINO). PUNTA ROMA. HOJAS RECTAS DENTADAS. MANDIBULAS ANGULADAS 75° - 90°GRADOS DESDE TERCIO MEDIO. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580974	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE POTTS-D'MARTEL ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJAS ANG 25° HACIA LATERAL. LONG 170-195mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE POTTS-D'MARTEL ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJAS ANGULADAS 25° GRADOS HACIA LATERAL. LONGITUD 170 mm - 195 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580975	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE POTTS-D'MARTEL ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJAS ANG 45°-60° LATERAL. LONG 170-195mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE POTTS-D'MARTEL ANGULADA PARA CIRUGIA VASCULAR. PUNTA AGUDA. HOJAS ANGULADAS 45°- 60° GRADOS HACIA LATERAL. LONGITUD 170 mm - 195 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580980	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE RAGNELL CURVA PARA FACELIFT (CIR PLASTICA-RINOLOGIA). PUNTA ROMA. HOJA CURVA-TOPE GUIA. LONG 130-	TIJERA DE RAGNELL CURVA PARA FACELIFT (CIRUGIA PLASTICA- RINOLOGIA). PUNTA ROMA. HOJA CURVA- FINA CON TOPE GUIA. LONGITUD 130 mm- 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							155mm. ACERO QUIRURGICO	
2580982	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE REYNOLDS CURVA PARA CIRUG PLASTICA-RINOLOGIA-OFTALMOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJA FINA-CURVA. LONG 95-120mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE REYNOLDS CURVA PARA CIRUGIA PLASTICA- RINOLOGIA- OFTALMOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJA FINA- CURVA. LONGITUD 95 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580983	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE REYNOLDS RECTA PARA CIRUG PLASTICA-RINOLOGIA-OFTALMOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJA FINA-RECTA. LONG 95-120mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE REYNOLDS RECTA PARA CIRUGIA PLASTICA RINOLOGIA- OFTALMOLOGIA. PUNTA ROMA. HOJA FINA- RECTA. LONGITUD 95 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580992	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE STEVENS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA FINA. HOJA ULTRA DELICADA-CURVA. LONGITUD 95 mm - 115 mm	TIJERA DE STEVENS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA FINA. HOJA ULTRA DELICADA- CURVA. LONGITUD 95 mm - 115 mm. ACERO ESTERILIZACION
2580993	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE STEVENS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA ROMA FINA. HOJA ULTRA	TIJERA DE STEVENS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA ROMA FINA. HOJA ULTRA DELICADA- CURVA. LONGITUD 95 mm - 115 mm. ACEROQ UIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							DELICADA-CURVA. LONG 95-115mm. ACERO QUIRURGICO	
2580995	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE STEVENS RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA FINA. HOJA ULTRA DELICADA-RECTA. LONGITUD 95 mm - 115 mm	TIJERA DE STEVENS RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA FINA. HOJA ULTRA DELICADA- RECTA. LONGITUD 95 mm - 115 mm. ACERO ESTERILIZACION
2580996	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE STEVENS RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA ROMA FINA. HOJA ULTRA DELICADA-RECTA. LONG 95-115mm. ACERO QUIRURGICO	TIJERA DE STEVENS RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA ROMA FINA. HOJA ULTRA DELICADA- RECTA. LONGITUD 95 mm - 115 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581001	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE VANNAS ANGULADA OFTALMOLOGIA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS-ANG 45° ARRIBA LONG 6-8mm. LONG 80-90	TIJERA DE VANNAS ANGULADA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS-ANGULADAS 45° GRADOS HACIA ARRIBA LONGITUD 6.0 mm - 8.0 mm. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581002	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE VANNAS ANGULADA OFTALMOLOGIA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS-ANG 45° LATERAL LONG 6-8mm. LONG 80-9	TIJERA DE VANNAS ANGULADA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS-ANGULADAS 45° GRADOS HACIA LATERAL LONGITUD 6.0 mm - 8.0 mm. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIR URGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581004	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE VANNAS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS-CURVAS LONG 5-7mm. LONG 8	TIJERA DE VANNAS CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA (CAPSULOTOMIA). PUNTA AGUDA FINA. HOJAS ULTRA DELICADAS- CURVAS LONGITUD 5.0 mm- 7.0 mm. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFIL PLANO. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581014	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE WESTCOTT CURVA PUNTA AGUDA-LONGITUD 95-120 mm-HOJA DELICADA-CURVA. MANGO DOBLE RAMA	TIJERA DE WESTCOTT CURVA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA-LONGITUD 95-120mm-HOJA DELICADA- CURVA. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTREN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO 100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A PROSESOS DE ESTERILIZACION
2581015	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA DE WESTCOTT RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGIC. PUNTA AGUDA. HOJA DELICADA-RECTA. MANGO DOBLE RAMA-PERFIL PLANO. LONG 95-120mm	TIJERA DE WESTCOTT RECTA PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. PUNTA AGUDA. HOJA DELICADA- RECTA. MANGO DOBLE RAMA-ANTIDESLIZANTR PERFILP LANO. LONGITUD 95 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581071	42291614	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	TIJERA UNIVERSAL PARA ALAMBRES BLANDOS. PUNTA ROMA. HOJA ANG 30°-45°- FILO LISO-DENTADO. LONG 110-140mm. ACERO QUIRURGICO ALTO GRADO	TIJERA UNIVERSAL PARA ALAMBRES BLANDOS. PUNTA ROMA. HOJAS ANGULADAS 30° - 45° GRADOS- FILO LISO - DENTADO. LONGITUD 110 mm - 140M M. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581074	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI ABOTONADO DE JOSEPH PARA RINOLOGIA. HOJA UNIBISEL-PUNTA ABOTONADA. MANGO PLANO. LONGITUD 150 mm - 160 mm. ACERO INOXIDABLE	BISTURI ABOTONADO DE JOSEPH PARA RINOLOGIA. HOJA UNIBISEL- PUNTA ABOTONADA. MANGO PLANO. LONGITUD 150 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581076	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI DE OLIVECRONA PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA DOBLE BISEL EN HOZ. MANGO MACIZO. LONGITUD 180 mm-220 mm. ACERO INOXIDABLE	BISTURI DE OLIVECRONA PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA DOBLE BISEL EN HOZ. MANGO MACIZO. LONGITUD 180 mm - 220 mm. ACERO QUIRU RGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581077	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI DE POLITZER PARA OTORRINO. HOJA DOBLE BISEL EN LANZETA. MANGO MACIZO OCTAGONAL. LONGITUD 165mm-185mm.	BISTURI DE POLITZER PARA OTORRINO. HOJA DOBLE BISEL EN LANZETA. MANGO MACIZO OCTAGONAL. LONGITUD 165 mm - 185 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ACERO INOXIDABLE	
2581078	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI DE ROSEN ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA REDONDA-DIAMETRO 1.0 mm - 2.0 mm- ANGULADA 45° GRADOS	BISTURI DE ROSEN ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA REDONDA-DIAMETRO 1.0 mm - 2.0 mm- ANGULADA 45° GRADOS. MANGO MACIZO OCTAGONAL. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581079	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI DE ROSEN ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA REDONDA-DIAMETRO 2.1 mm - 3.1 mm- ANGULADA 45° GRADOS	BISTURI DE ROSEN ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA Y OTORRINO. HOJA REDONDA-DIAMETRO 2.1 mm - 3.1 mm- ANGULADA 45° GRADOS. MANGO MACIZO OCTAGONAL. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581083	42291613	ZMQX	ZMQI-005	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	BISTURI No. 3 LARGO PARA HOJAS No.10 - 15. MANGO MACIZO. LONG 200-220mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORRO	BISTURI No. 3 LARGO PARA HOJAS No.10 - 15. MANGO MACIZO. LONGITUD 200 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
DISECCION OSEA								
CODIGO GENERICO	**CODIGO UNSPSC**	**TIPO DE MATERIAL**	**GRUPO DE ARTICULOS**	**SUB-GRUPO DE ARTICULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RUBRO**	**NOMBRE GENERICO**	**ESPECIFICACION TECNICA**

2505532	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESCOFINA NASAL /FOMON TUNGSTENO 40x7mm - DOBLE EXTREMO CON INSERTOS DE TUNGSTENO- TERMINAL GRUESO- RECTA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO)	ESCOFINA NASAL /FOMON TUNGSTENO 40x7mm - DOBLE EXTREMO CON INSERTOS DE TUNGSTENO- TERMINAL GRUESO- RECTA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJAS RECTAS- TALLADO PUNTEADO-ROMBOIDAL- SUPERFICIE ABRASIVA-CORTANTE A EMPUJE Y TRACCION. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- PLANA- LISA. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505533	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESCOFINA HUESO/PUTTI DOBLE 30cm/11(6/8") ESCOFINA HUESO DE PUTTI DOBLE EXTREMO PLANA PARA ORTOPEDIA (HUESO). HOJAS CURVA-RECTA- TALLADO PUNTEADO- SUPERFICIE ABRASIVA- CORTANTE A EMPUJE Y TRACCION	ESCOFINA HUESO/PUTTI DOBLE 30cm/11(6/8") DOBLE EXTREMO PLANA PARA ORTOPEDIA (HUESO). HOJAS CURVA-RECTA- TALLADO PUNTEADO- SUPERFICIE ABRASIVA-CORTANTE AEMPUJE Y TRACCION- 30cm/11(6/8") ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- LISA- PLANA. LONGITUD TOTAL 300mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505534	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ELEVADOR HOHMANN/MINI 8mm L16cm/6 (2/8") ELEVADOR HOHMANN/MINI 8mm L16cm/6 (2/8") EN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA)	ELEVADOR HOHMANN/MINI 8mm L16cm/6 (2/8") EN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVA EN "S"- SEMIRECTANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 8-0mmmm X ANCHO DISTAL. MANGO PLANO- LISO. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2505535	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ELEVADOR HOHMANN/MINI 6mm L16cm/6 (2/8") EN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVA EN "S"	ELEVADOR HOHMANN/MINI 6mm L16cm/6 (2/8") EN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVA EN "S"- SEMIRECTANGULAR HACIA TERCIOMEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 8-0mmmm X ANCHO DISTAL. MANGO PLANO- LISO. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581136	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ELEVADOR/DISECTOR DE LANGENBECK CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-BORDE CURVO-PSEUDOBICE-ANCHO 8.0-10mm. LONG 180-210mm	ELEVADOR/DISECTOR DE LANGENBECK CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-BORDE CURVO-PSEUDOBISELADO- ANCHO 8.0 mm - 10 mm. MANGO CUADRANGULAR- MACIZO- LISO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581137	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ELEVADOR/DISECTOR DE LANGENBECK CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-BORDE CURVO-ROMO- ANCHO 10-13mm. LONG 220-250mm	ELEVADOR/DISECTOR DE LANGENBECK CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-BORDE CURVO-ROMO- ANCHO 10 mm - 13 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581142	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE AUFRICHT CURVA PARA ORTOP- MXLF-ORL (HUESO). HOJA TALLADO ESCALONADO-CORTANTE A EMPUJE-ANCHO 7-10mm. LONG 200-230mm	LIMA/RASPA DE AUFRICHT CURVA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJA CURVA- TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO- SUPERFICIE AGUDA-CORTANTE A EMPUJE- ANCHO 7.0 mm - 10 mm. MANGO HUECO-CUADRANGULAR- ACANALADO. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581143	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE AUFRICHT CURVA PARA ORTOP- MXLF-ORL (HUESO). HOJA TALLADO ESCALONA-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 7-10mm. LONG 200-230mm	LIMA/RASPA DE AUFRICHT CURVA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJA CURVA- TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO- SUPERFICIE AGUDA-CORTANTE A TRACCION- ANCHO 7.0 mm - 10 mm. MANGO HUECO- CUADRANGULAR- ACANALADO. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581144	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE COTTLE RECTA PARA ORTOP-MXLF- ORL (HUESO). HOJA TALLADO ESCALONADO-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 7-10mm. LONG 190-220mm	LIMA/RASPA DE COTTLE RECTA PARA ORTOPEDIA-MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJA RECTA-TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO- SUPERFICIE AGUDA-CORTANTE A TRACCION- ANCHO 7.0 mm - 10 mm. MANGO HUECO- CUADRANGULAR- ACANALADO. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581145	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE FOMON DOBLE EXTREMO RECTA PARA ORT- MXLF-ORL. HOJAS TALL ABRASIVA A EMPUJE Y TRACCION-ANCHO 7.0-10mm. LONG 190-220mm	LIMA/RASPA DE FOMON DOBLE EXTREMO RECTA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJAS RECTAS- TALLADO PUNTEADO-ROMBOIDAL- SUPERFICIE ABRASIVA-CORTANTE A EMPUJE Y TRACCION- ANCHO 7.0 mm - 10 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- PLANA- LISA. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581148	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE JOSEPH RECTA PARA ORTOP-MXLF- ORL. HOJA TALLADO ROMBOIDAL-ABRASIVA A EMPUJE Y TRACCION-ANCHO 7-10mm. LONG 150-180mm	LIMA/RASPA DE JOSEPH RECTA PARA ORTOPEDIA-MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJA RECTA-TALLADO ROMBOIDAL FINO- SUPERFICIE ABRASIVA- CORTANTE A EMPUJE Y TRACCION-ANCHO 7.0 mm - 10 mm. MANGO MACIZO- PLANO. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581149	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE LEWIS RECTA PARA ORTOP-MXLF- ORL. HOJA TALLADO ESCALONADO-AGUDA-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 7.0-10mm. LONG 160-190mm	LIMA/RASPA DE LEWIS RECTA PARA ORTOPEDIA-MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJA RECTA-TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO- SUPE RFICIE AGUDA-CORTANTE A TRACCION- ANCHO 7.0 mm - 10 mm. MANGO HUECO- CUADRANGULAR- ACANALADO. LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581152	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE MILLER DOBLE EXTREMO CURVA PARA HUESO. HOJAS CURVA-RECTA-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 5-8mm X 3.5-5.5mm. LONG 170-200mm	LIMA/RASPA DE MILLER DOBLE EXTREMO CURVA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJAS CURVA-RECTA- TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO-SUPERFICIE AGUDA-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 5.0 mm - 8.0 mm X 3.5 mm - 5.5 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION
2581153	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	LIMA/RASPA DE MILLER DOBLE EXTREMO RECTA PARA HUESO. HOJAS TALL ESCALONAD-CORTANTE A TRACCION-ANCHO 7-10mm X 4-6mm. LONG 170-200mm	LIMA/RASPA DE MILLER DOBLE EXTREMO RECTA PARA ORTOPEDIA- MAXILOFACIAL- OTORRINO (HUESO). HOJAS RECTAS- TALLADO ESTRIADO TRANSVERSAL ESCALONADO- SUPERFICIE AGUDA-CORTANTE A TRACCION- ANCHO 7.0 mm - 10 mm X 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581158	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-RECTANGULAR-ANCHO 3.0-6.0mm. MANGO MACIZO SINTETIC. LONG 170-200mm	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-RECTANGULAR- BORDE AGUDO-BISELADO-ANCHO 3.0 mm - 6.0 mm. MANGO MACIZO CUADRANGULAR- SINTETICO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581159	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-RECTANGULAR- ANCHO 10-15mm. MANGO MACIZO SINTETICO. LONG 170-200mm	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-RECTANGULAR- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 10 mm - 15 mm. MANGO MACIZO CUADRANGULAR- SINTETICO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581160	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-REDONDEADA- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 5.0 mm - 7.0 mm. MANGO MACIZO CUADRANGULAR	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-REDONDEADA- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 5.0 mm - 7.0 mm. MANGO MACIZO CUADRANGULAR- SINTETICO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581161	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-REDONDEADA- ANCHO 10-15mm. MANGO MACIZO SINTETICO. LONG 170-200mm	PERIOSTOTOMO/RUGINA CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-REDONDEADA- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 10 mm - 15 mm. MANGO MACIZO CUADRANGULAR- SINTETICO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581175	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA DE FARABEUF-COLLIN CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA-	PERIOSTOTOMO/RUGINA DE FARABEUF-COLLIN CURVO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA CURVA- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 10 mm - 13 mm. MANGO HUECO- LISO- CUADRANGULAR. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							BORDE AGUD-BISEL- ANCHO 10-13mm. LONG 150-180mm	
2581176	42291611	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PERIOSTOTOMO/RUGINA DE FARABEUF-COLLIN RECTO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA RECTA-BORDE AGUD-BISEL- ANCHO 10-13mm. LONG 150-180mm	PERIOSTOTOMO/RUGINA DE FARABEUF-COLLIN RECTO PARA ORTOPEDIA (PERIOSTIO). HOJA RECTA- BORDE AGUDO-BISELADO- ANCHO 10 mm - 13 mm. MANGO HUECO- LISO- CUADRANGULAR. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581208	9167	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE ALDERDYCE DOBLE EXTREMO CURVO PARA ORL- MXLF. HOJAS CURVAS-ROMAS- ANCHO 4.0-6.0 X 5.0-7.0mm. LONG 190-220mm	DISECTOR/ELEVADOR DE ALDERDYCE DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (PERIOSTIO). HOJAS CURVAS-BORDES CURVOS-ROMOS- ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm X 5.0 mm - 7.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- MACIZA- LISA- PLANA. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581209	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE BALLENGER-HAJEK DOBLE EXTREMO RECTO PARA ORL MXLF (TABIQU NASAL). BORDES AG-ROM- ANCH 5.0-7.0mm. LONG 180-210mm	DISECTOR/ELEVADOR DE BALLENGER-HAJEK DOBLE EXTREMO RECTO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS RECTAS-BORDES AGUDO-ROMO- ANCHO 5.0 mm - 7.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581211	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE COTTLE CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL	DISECTOR/ELEVADOR DE COTTLE CURVO PARA OTORRINO- MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA-ROMA- ANCHO 7.0 mm - 9.0 mm. MANGO CUADR ANGULAR MACIZO-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							(TABIQUE NASAL). HOJA CURVA-ROMA-ANCHO 7.0-9.0mm. LONG 180-210mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581212	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE COTTLE DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA ANGULADA 45° GRADOS-CURVA-BORDES ROMOS- ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm	DISECTOR/ELEVADOR DE COTTLE DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA ANGULADA 45° GRADOS-CURVA-BORDES ROMOS-ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- PLANA- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581214	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FISCH MICRO ANGULADO A LA DERECHA PARA OTOLOGIA. HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA LATERAL DERECHA-BORDE ROMO- L ARGO UTIL 4.0 mm - 6.0 mm	DISECTOR/ELEVADOR DE FISCH MICRO ANGULADO A LA DERECHA PARA OTOLOGIA. HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA LATERAL DERECHA- BORDE ROMO- L ARGO UTIL 4.0 mm - 6.0 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581215	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FISCH MICRO ANGULADO A LA IZQUIERDA PARA OTOLOGIA. HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA LATERAL IZQUIERDA-	DISECTOR/ELEVADOR DE FISCH MICRO ANGULADO A LA IZQUIERDA PARA OTOLOGIA. HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA LATERAL IZQUIERDA- BORDE ROMO- LARGO UTIL 4.0 mm - 6.0 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOG RADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							BORDE ROM O-LARGO UTIL 4.0 mm - 6.0 mm	
2581217	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA TABIQUE NASAL. HOJAS CORTANTE-ABOTON-ANCHO 4.0-6.0mm. LONG 180-210mm	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA CORTANTE-ABOTONADA- ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581218	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA TABIQUE NASAL. HOJAS ROMA-ABOTON-ANCHO 4.0-6.0mm. LONG 180-210mm	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA ROMA-ABOTONADA- ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581219	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ANGULADO PARA TABIQUE NASAL. HOJAS CURVA-ANG 45°- ANCHO 4-5mm X 6-7mm. LONG 180-210mm	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-ANGULADO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA-CURVA ANGULADA 45° GRADOS- BORDES ROMO-AGUDO- ANCHO 4.0 mm - 5.0 mm X 6.0 mm - 7.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581220	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-RECTO PARA TABIQUE NASAL. HOJAS	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER DOBLE EXTREMO CURVO-RECTO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA-RECTA- BORDES ROMO-BISELADO- ANCHO 4.5 mm - 5.5 mm X 3.0 mm - 4.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm -2 10 mm. ACERO

							CURV-RECT-ANCH 4.5-5.5mm X 3.0-4.0mm. LONG 180-210mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581221	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER-YASARGIL DOBLE EXTREMO CURVO PARA TABIQUE NASAL. HOJAS CURVAS-AGUDAS- ANCHO 3.0-4.0mm. LONG 180-210mm	DISECTOR/ELEVADOR DE FREER-YASARGIL DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVAS-AGUDAS- ANCHO 3.0 mm - 4.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581222	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE HALLE CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA-ROMA-ANCHO 3.0-4.0mm. LONG 150-180mm	DISECTOR/ELEVADOR DE HALLE CURVO PARA OTORRINO- MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA- BORDE CURVO-ROMO- ANCHO 3.0 mm - 4.0 mm. MANGO PLANO MACIZO- LISO. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581225	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE JOSEPH CURVO PARA ORL-MXLF (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA- BORDE ROMO-BISELADO- ANCHO 6.0-8.0mm. LONG 170-200mm	DISECTOR/ELEVADOR DE JOSEPH CURVO PARA OTORRINO- MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA- BORDE ROMO-BISELADO- ANCHO 6.0 mm - 8.0 MM-MANGO HUECO- CUADRANGULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581226	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE JOSEPH-MASING EN BAYONETA PARA ORL-MXLF. HOJA RECTA-ROMA-ANCHO 3.5-4.5mm. VASTAGO EN BAYONETA. LONG 200-230mm	DISECTOR/ELEVADOR DE JOSEPH-MASING EN BAYONETA PARA OTORRINO- MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA RECTA- BORDE PSEUDOBISELADO-ROMO- ANCHO 3.5 mm - 4.5 mm. VASTAGO EN BAYONETA. MANGO HEXAGONAL MACIZO. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581227	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE KILLIAN DOBLE EXTREMO CURVO PARA ORL- MXLF (TABIQUE NASAL). HOJAS BORDES AGUDO-ROMO-ANCH 3-5mm. LONG 170-200mm	DISECTOR/ELEVADOR DE KILLIAN DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVAS-BORDES AGUDO-ROMO- ANCHO 3.0 mm - 5.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581228	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE KILLIAN DOBLE EXTREMO RECTO PARA ORL- MXLF (TABIQUE NASAL). HOJAS BORDES ROMO-BISEL- ANCH 4-6mm. LONG 220-250mm	DISECTOR/ELEVADOR DE KILLIAN DOBLE EXTREMO RECTO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS RECTAS-BORDES ROMO-BISELADO- ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581242	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE MCKENTY DOBLE EXTREMO RECTO PARA ORL- MXLF (TABIQUE NASAL). HOJAS	DISECTOR/ELEVADOR DE MCKENTY DOBLE EXTREMO RECTO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS RECTAS-BORDES ROMOS- ANCHO 4.0 mm - 5.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- PLANA-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							RECTAS-ROMAS- ANCHO 4.0-5.0mm. LONG 190-220mm	
2581243	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE MOLT DOBLE EXTREMO RECTO PARA MXLF (PERIOSTIO). HOJAS PUNTA CURVADA-ANCH 2.0-4.0mm X 5.0-7.0mm. LONG 160-190mm	DISECTOR/ELEVADOR DE MOLT DOBLE EXTREMO RECTO PARA MAXILOFACIAL (PERIOSTIO). HOJAS RECTAS LIGERAMENTE CURVADAS EN LA PUNTA-BORDESA GUDOS- ANCHO 2.0 mm - 4.0 mm X 5.0 mm - 7.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO-TUBULAR- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 160 mm -19 0 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581248	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE OBWERGESER DOBLE EXTREMO CURVO-ANGULADO PARA ORL MXLF. HOJAS CURV-CURV ANG 90°-ANCHO 4.0-6.0mm. LONG 190-220mm	DISECTOR/ELEVADOR DE OBWERGESER DOBLE EXTREMO CURVO-ANGULADO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJAS CURVA-CURVA ANGULAD A 90° GRADOS- BORDES ROMOS-ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 190 mm- 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581249	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE OBWERGESER DOBLE EXTREMO CURVO PARA ORL- MXLF (BORDE MANDIBULAR). HOJAS CURVA-RECTA- ANCH 5-7mm. LONG 190-220mm	DISECTOR/ELEVADOR DE OBWERGESER DOBLE EXTREMO CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL- BORDE MANDIBULAR). HOJAS CURVA-RECTA- BORDES AGUDO-ROMO- ANCHO 5.0 mm - 7.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- TUBULAR-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581250	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE O'CONNELL	DISECTOR/ELEVADOR DE O'CONNELL DOBLE EXTREMO RECTO-ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA (DURAMADRE). HOJAS RECTA-

							DOBLE EXTREMO RECTO-ANGULADO PARA NCX (DURAMADR). HOJAS RECT-ANG 90° ANCH 5-7mmX3-5mm. LONG 200-230mm	ANGULADA 90° GRADOS- BORDES ROMOS- ANCHO 5.0 mm - 7.0 mm X 3.0 mm - 5.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- HEXAGONAL. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581252	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE PENFIELD CURVO-ANGULADO PARA NCX (DURAMADRE). HOJA CURVA ANG 30°-45° BISELADO-ANCHO 3.0-4.0mm. LONG 190-220mm	DISECTOR/ELEVADOR DE PENFIELD CURVO-ANGULADO PARA NEUROCIRUGIA (DURAMADRE). HOJA CURVA ANGULADA 30° - 45° GRADOS- BORDE ROMO-BISELADO- ANCHO 3.0 mm - 4.0 mm. MANGO MACIZO- TUBULAR. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581254	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE PENFIELD DOBLE EXTREMO CURVO PARA NCX (DURAMADRE). HOJAS LIGERAME CURVAD-ROMAS- ANCHO 6.0-8.0mm. LONG 270-300mm	DISECTOR/ELEVADOR DE PENFIELD DOBLE EXTREMO CURVO PARA NEUROCIRUGIA (DURAMADRE). HOJAS LIGERAMENTE CURVADAS- BORDES ROMOS- ANCHO 6. 0 mm - 8.0 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- LISA- PLANA. LONGITUD TOTAL 270 mm - 300 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581261	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE SELDIN DOBLE EXTREMO CURVO PARA MXLF (PERIOSTIO). HOJAS LIGERAMENTE	DISECTOR/ELEVADOR DE SELDIN DOBLE EXTREMO CURVO PARA MAXILOFACIAL (PERIOSTIO). HOJAS LIGERAMENTE CURVADAS- BORDES AGUDO-ROMO- ANCHO 9.0 mm - 12 mm. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO- LISA- PLANA. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							CURVADAS-ANCHO 9.0-12mm. LONG 180-210mm	
2581263	42292703	ZMQX	ZMQI-006	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DISECTOR/ELEVADOR DE STEINHAUSER CURVO PARA OTORRINO-MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA-ROMA-ANCHO 6.0-8.0mm. LONG 170-200mm	DISECTOR/ELEVADOR DE STEINHAUSER CURVO PARA OTORRINO- MAXILOFACIAL (TABIQUE NASAL). HOJA CURVA-ROMA- ANCHO 6.0 mm - 8.0 mm. ZONA D E AGARRE ANTIDESLIZANTE- TOPE SEMIABOTONADO HACIA DISTAL. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

ESPACIADORES-SEPARADORES

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2505536	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR RICHARDSON 20 mm LONGITUD 27.5 cm10-7-8" RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR- VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO	SEPARADOR RICHARDSON 20 mm LONGITUD 27.5 cm10-7-8" RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO- MANGO EN MEDIACAÑA ANILLADO HACIA MEDIAL Y ERGONOMICO HACIA DISTAL. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505537	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR RICHARDSON 38mm LONGITUD 27.5cm10-7-8" RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR.	SEPARADOR RICHARDSON 38mm LONGITUD 27.5cm10-7-8" RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO- MANGO EN MEDIACAÑA ANILLADO HACIA MEDIAL Y ERGONOMICO HACIA DISTAL. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO	
2505630	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO AURICULAR LUCAE-PUNTA 1.0mm-LONGITUD 14cm-5-1-2"-INSTRUMENTO EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-ROMO-PARA EXTRAER CUERPOS EXTRAÑOS	GANCHO AURICULAR LUCAE-PUNTA 1.0mm-LONGITUD 14cm-5-1-2"-INSTRUMENTO EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-ROMO-PARA EXTRAER CUERPOS EXTRAÑOS Y MANIPULAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN PROCEDIMIENTOS DE OIDO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505631	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO AURICULAR LUCAE-PUNTA 0.8 mm-LONGITUD 14cm-5-1-2"-INSTRUMENTO EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-ROMO-PARA EXTRAER CUERPOS EXTRAÑOS	GANCHO AURICULAR LUCAE-PUNTA 0.8 mm-LONGITUD 14cm-5-1-2"-INSTRUMENTO EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-ROMO-PARA EXTRAER CUERPOS EXTRAÑOS Y MANIPULAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN PROCEDIMIENTOS DE OIDO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505632	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO RETRACTOR KAYE SENCILLO LONGITUD DE 13 cm-BORDE INTERIOR HUECO-CON UN ARO LONGITUDINAL SEMIABIERTO UNIDO AL MANGO-LA HOJA TERMINA CON DOS GANCHOS AFILADOS	GANCHO RETRACTOR KAYE SENCILLO LONGITUD DE 13 cm-BORDE INTERIOR HUECO-CON UN ARO LONGITUDINAL SEMIABIERTO UNIDO AL MANGO-LA HOJA TERMINA CON DOS GANCHOS AFILADOS LATERALES Y CURVOS-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-SE UTILIZA PARA RETRACCIONES PRECISAS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LATERALES Y CURVOS	
2581296	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS - BORDE ROMO- ANCHO 25 mm - 35 mm. LONGITUD 300 mm - 330 mm.	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS- BORDE ROMO- ANCHO 25 mm - 35 mm. LONGITUD 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581297	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS . ANCHO 35-45 mm. LONG 300-330 mm	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS- BORDE ROMO- ANCHO 35 mm - 45 mm. LONGITUD 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581298	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS . ANCHO 45-55-mm. LONG 300-330 mm	ESPATULA-RETRACTOR MALEABLE PARA CIRUGIA GENERAL (TEJIDO REGULAR). ATRAUMATICA-ARISTAS REDONDEADAS- BORDE ROMO- ANCHO 45 mm - 55 mm. LONGITUD 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581299	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANG 15°. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 15° GRADOS. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION
2581300	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 25°- PROF 3-0-6-0mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 25° GRADOS X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTEACORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581301	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 25°- PROF 7-0-10mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 25° GRADOS X PROFUNDIDAD 7-0 mm - 10 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581302	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 45° GRADOS X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO

							DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 45°- PROF 3-0-6-0mm. LONG 150-170mm	GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581303	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 45°- PROF 10-12mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 45° GRADOS X PROFUNDIDAD 10 mm - 12 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581306	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 90°- PROF 3-0-6-0mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581307	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 90°- PROF 10-12mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS X PROFUNDIDAD 10 mm - 12 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581308	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 90°- PROF 15-20mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS X PROFUNDIDAD 15 mm - 20 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581309	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). PUNTA AGUD ANG 90°- PROF 21-25mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS X PROFUNDIDAD 21 mm - 25 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581310	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS ULTRA DELICADOS. PUNTA ULTRAFINA ANG 90°- PROF 3-6mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS ULTRA DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS-PUNTA AGUDAU LTRA FINA ANGULADA 90° GRADOS X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581311	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS ULTRA	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS ULTRA DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS-PUNTA AGUDA ULTRAFINA CURVA PROLONGADA. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							DELICADOS. VASTAGO ANG 45°- PUNTA ULTRAFINA. LONG 150-170mm	
2581312	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA CURVO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA MEDIO CIRCULO- PROF 5-0-10mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA CURVO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO X PROFUNDIDAD 5-0 mm - 10 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581313	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA CURVO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAG RECT. PUNTA AGUD CURVA PROLONG. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA CURVO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA CURVA PROLONGADA. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZ ACION
2581314	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA RECTO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA RECTA. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE BARBARA RECTO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA RECTA. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581315	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°- PUNTA ULTRAFINA ANG 90° DER- PROF 3-6mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA ANGULADA 90° GRADOS HACIA LA DERECHA X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581316	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°- PUNTA ULTRAFINA ANG 90° DER- PROF 7-10mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA ANGULADA 90° GRADOS HACIA LA DERECHA X PROFUNDIDAD 7-0 mm - 10 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581317	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°- PUNTA ULTRAFINA ANG 90° IZQ- PROF 3-6mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA ANGULADA 90° GRADOS HACIA LA IZQUIERDA X PROFUNDIDAD 3-0 mm - 6-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581318	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°- PUNTA	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA ANGULADA 90° GRADOS HACIA LA IZQUIERDA X PROFUNDIDAD 7-0 mm - 10 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-

							ULTRA FINA ANG 90° IZQ-PROF 7-10mm. LONG 150-170mm	100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581319	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°. PUNTA ULTRAFINA CURVA DER-PROF 5-0-8-0mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA CURVA EN MEDIO CIRCULO HACIA LA DERECHA X PROFUNDIDAD 5-0 mm - 8-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 15 0 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581320	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°. PUNTA ULTRAFINA CURVA DER-PROF 9-0-12mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA CURVA EN MEDIO CIRCULO HACIA LA DERECHA X PROFUNDIDAD 9-0 mm - 12 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581321	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°. PUNTA ULTRAFINA CURVA IZQ-PROF 5-0-8-0mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA CURVA EN MEDIO CIRCULO HACIA LA IZQUIERDA X PROFUNDIDAD 5-0 mm - 8-0 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD15 0 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581322	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO ANG 45°. PUNTA ULTRAFINA CURVA IZQ-PROF 9-0-12mm. LONG 150-170mm	GANCHO-AGUJA AURICULAR DE McGEE ANGULADO PARA OTOLOGIA (TEJIDOS ULTRA DELICADOS- PLATINA DEL ESTRIBO). VASTAGO ANGULADO 45° GRADOS- PUNTA AGUDA ULTRAFINA CURVA EN MEDIO CIRCULO HACIA LA IZQUIERDA X PROFUNDIDAD 9-0 mm - 12 mm. MANGO MACIZO HEXAGONAL. LONGITUD15 0 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581323	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA DE AUSTIN MICRO ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANG 90°-LARGO UTIL 2.5-3.5mm. LONG 140-170mm	GANCHO-AGUJA DE AUSTIN MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS- LARGO UTIL 2.5 mm - 3.5 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581324	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA DE ROSEN MICRO CURVO PARA OTOLOGIA. VASTAGO RECTO- HOJA AGUDA CURVA PROLONGADA-LARGO UTIL 10-15mm. LONG 140-170mm	GANCHO-AGUJA DE ROSEN MICRO CURVO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO- HOJA AGUDA CURVA PROLONGADA-LARGO UTIL 10M M - 15 mm. MANGO MACIZO-HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTEN TE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581325	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA DE SHAMBAUGH MICRO ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANG 25°-	GANCHO-AGUJA DE SHAMBAUGH MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANGULADA 25° GRADOS- LARGO UTIL 0.5 mm - 1.0 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LARGO UTIL 0.5-1.0mm. LONG 140-170mm	
2581326	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA DE SHAMBAUGH MICRO ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANG 45°-LARGO UTIL 0.5-1.0mm. LONG 140-170mm	GANCHO-AGUJA DE SHAMBAUGH MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANGULADA 45° GRADOS- LARGO UTIL 0.5 mm - 1.0 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581327	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-AGUJA DE SHEA MICRO ANGULADO PARA OTOLOGIA. VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANGULADA 45°-LARGO UTIL 1.5-2.5mm. LONG 140-170mm	GANCHO-AGUJA DE SHEA MICRO ANGULADO PARA TEJIDOS MUY DELICADOS (OTOLOGIA). VASTAGO RECTO- PUNTA AGUDA ANGULADA 45° GRADOS- LARGO UTIL 1.5 mm - 2.5 mm. MANGO MACIZO- HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581328	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO CURVO PARA CIRUGIA VASC PERIF (FLEBODISECC-EXTRACC). PUNTAS ROMA-GANCHO ROMO. LONG 160-190mm	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA (FLEBODISECCION-EXTRACCION). PUNTAS ROMA-GANCHO ROMO. HOJAS CURVA-CONTRALATERAL. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO HEXAGONAL-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581329	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO CURVO PARA CIR VASC PERIF (FLEBODISEC-EXTRACC). PUNTAS ROMA-GANCHO ABOTONADA. LONG 160-190mm	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA (FLEBODISECCION-EXTRACCION). PUNTAS ROMA-GANCHO ABOTONADA. HOJAS CURVA-CONTRALATERAL. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581330	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO MICRO CURVO PARA CIR VASC PERIF (FLEBODISEC-EXTRAC). PUNTAS ROMA-GANCHO ROMO. LONG 160-190mm	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO MICRO CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA (FLEBODISECCION-EXTRACCION). PUNTAS ROMA-GANCH O ROMO. HOJAS CURVA-CONTRALATERAL. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581331	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO MINI CURVO PARA CIR VASC PERIF (FLEBODISEC-EXTRAC). PUNTAS ROMA-GANCHO ROMO. LONG 160-190mm	GANCHO-DISECTOR DE VARADY DOBLE EXTREMO MINI CURVO PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA (FLEBODISECCION-EXTRACCION). PUNTAS ROMA-GANCHO ROMO. HOJAS CURVA-CONTRALATERAL. ZONA DE AGARRE EN TERCIO MEDIO HEXAGONAL- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581332	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE ADSON SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA AGUDA	GANCHO-RETRACTOR DE ADSON SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ANGULADA 90°. LONG 180-210mm	
2581333	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE BROM SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS)- PUNTA ROMA ANGULADA 90°. LONGITUD 170-200mm	GANCHO-RETRACTOR DE BROM SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ROMA ANGULADA 90° GRADOS-MANGO PLANO. LONGITUD 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581334	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE CAIRNS SENCILLO ANGULADO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULAD 90°. LONG 120-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE CAIRNS SENCILLO ANGULADO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581335	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE CASPAR SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ABOTONADA ANGULADA 90°. LONG 230-250mm	GANCHO-RETRACTOR DE CASPAR SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ABOTONADA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 230 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581336	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE-NEIVERT DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA ALA NASAL. DOS DIENTS PROF 4-6mmXANCHO 10-12mm. LONG 180-200mm	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE-NEIVERT DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (ALA NASAL). PUNTAS ROMA CURVA-ABOTONADA DOS DIENTES PROFUNDIDAD 4-0 mm - 6-0 mm X ANCHO 10 mm - 12 mm. MANGO PLANO- ACANALADO TRANSVERSAL HACIA DISTAL. LONGITUD 180 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581337	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE PARA TEJIDOS DELICADOS (ALA NASAL). CUATRO DIENTES PROFUNDIDAD 4-0-6-0mm X ANCHO 6-0-10mm. LONG 130-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE PARA TEJIDOS DELICADOS (ALA NASAL). VASTAGO RECTO. PUNTA AGUDA CURVA- CUATRO DIENTES PROFUNDIDAD 4-0 mm - 6-0 mm X ANCHO 6-0 mm - 10 mm. MANGO PLANO- ACANALADO LONGITUDINAL. LONGITUD 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-10 0% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581338	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90°. LONG 150-180mm	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO PLANO. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581339	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE SENCILLO CURVO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA	GANCHO-RETRACTOR DE COTTLE SENCILLO CURVO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA. MANGO PLANO. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							AGUDA CURVA. MANGO PLANO. LONG 150-180mm	
2581340	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE CRILE SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS. VASOS). PUNT ROMA ANG 90°. MANGO REDOND. LONG 180-210M	GANCHO-RETRACTOR DE CRILE SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ROMA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDOND O ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581341	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE CUSHING SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA APLANADA ROMA ANG 90°. LONG 180-210mm	GANCHO-RETRACTOR DE CUSHING SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA APLANADA ROMA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO PLANO. LONGITUD 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581343	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE FISCH SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90°. LONG 170-200mm. ACERO	GANCHO-RETRACTOR DE FISCH SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581344	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE FOMON CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (NARIZ). DOS DIENTES PROF 3-0-4-0mm X ANCHO 7-0-9-5mm. LONG 140-155mm	GANCHO-RETRACTOR DE FOMON CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (NARIZ). PUNTA ROMA ATRAUMATICA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 3-0 m m - 4-0 mm X ANCHO 7-0 mm - 9-5 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 140 mm - 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581345	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE FOMON CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (NARIZ). DOS DIENTES PROF 3-0-4-0mm X ANCHO 7-0-9-5mm. LONG 150-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE FOMON CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (NARIZ). PUNTA ROMA ATRAUMATICA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 3-0 m m - 4-0 mm X ANCHO 7-0 mm - 9-5 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581346	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE FRAZIER SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA AGUDA CURVA MEDIO CIRCUL. LONG 120-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE FRAZIER SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581347	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE FREER CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. DOS DIENTES AGUDOS PROF 2-0-2-5mm X ANCHO 2-5-3-5mm. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE FREER CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA AGUDA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 2-0 mm - 2-5 mm X AN CHO 2-5 mm - 3-5 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581348	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE GILLIES SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA AGUDA CURVA MEDIO CIRCUL. LONG 170-190mm	GANCHO-RETRACTOR DE GILLIES SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 170 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581349	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA AGUDA MEDIO CIRCULO. LONG 120-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581350	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA ROMA MEDIO CIRCULO. LONG 120-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA ROMA CURVA EN MEDIO CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581351	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ROMA CURVA 3-8 DE CIRCULO.	GANCHO-RETRACTOR DE GRAEFE SENCILLO CURVO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ROMA CURVA EN 3-8 DE CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONG 120-150mm	
2581352	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE GUTHRIE CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. DOS DIENTES AGUDOS PROF 1-2-1-7mm X ANCHO 2-0-3-0mm. LONG 120-150mm	GANCHO-RETRACTOR DE GUTHRIE CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA AGUDA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 1-2 mm - 1-7 mm XA NCHO 2-0 mm - 3-0 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581353	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 2-0 mm - 4-0 mm. MANGO REDOND O ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm.	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 2-0 mm - 4-0 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581354	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 5-0 mm - 6-0 mm. MANGO REDOND O ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm.	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 5-0 mm - 6-0 mm. MANGO REDOND O ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581355	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 7-0 mm - 8-0 mm. LONG 150-180mm	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 7-0 mm - 8-0 mm. MANGO REDOND O ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581356	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 9-0 mm - 10 mm. LONG 150-180mm	GANCHO-RETRACTOR DE JOSEPH CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 9-0 mm - 10 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581358	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE KILNER SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA AGUDA CURVA MEDIO CIRCULO. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE KILNER SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581359	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE KOCHER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA. MANGO PLANO FENESTRADO.	GANCHO-RETRACTOR DE KOCHER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONG 200-230mm	
2581360	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE KOCHER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA CURVA. MANGO PLANO FENESTRADO. LONG 200-230mm	GANCHO-RETRACTOR DE KOCHER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA CURVA. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581361	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE KRAYENBÜHL SENCILLO ABOTONADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS. VASOS). PUNTA ABOTONADA ANG 90°. LONG 180-210mm	GANCHO-RETRACTOR DE KRAYENBÜHL SENCILLO ABOTONADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA ABOTONADA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO CON BOTON GUIA TERCIO MEDIO. LONGITUD 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION YA PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581362	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE KRAYENBÜHL SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA ROMA ANGUL 90°. LONG 180-210mm	GANCHO-RETRACTOR DE KRAYENBÜHL SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA ROMA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO CON BOTON GUIA TERCIO MEDIO. LONGITUD 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION YA PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581363	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA TEJIDO REGULAR	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). PUNTA AGUDA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 5.0 mm - 7.0 mm X ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO

							(TRAQUEA). DOS DIENTES AGUDOS PROF 5-7mmXANCHO 4-6mm. LONG 140-170mm	DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581364	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). TRES DIENTES AGUDO PROF 5-7mmXANCHO 7-9mm. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). PUNTA AGUDA CURVA- TRES DIENTES PROFUNDIDAD 5 .0 mm - 7.0 mm X ANCHO 7.0 mm - 9.0 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-1 00% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581365	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). DOS DIENTES ROMOS PROF 5-7mmXANCHO 4-6mm. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). PUNTA ROMA CURVA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 5.0 mm - 7.0 mm X ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581366	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). TRES DIENTES ROMOS PROF 5-7mmXANCHO 7-9mm. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (TRAQUEA). PUNTA ROMA CURVA- TRES DIENTES PROFUNDIDAD 5. 0 mm - 7.0 mm X ANCHO 7.0 mm - 9.0 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581367	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. DOBLE EXTREMO CURVO-	GANCHO-RETRACTOR DE MANNERFELT MODIF. DOBLE EXTREMO CURVO-ABOTONADO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (TENDON). PUNTA ROMA CURVA-ABOTONADA. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							ABOTONADO PARA TEJIDO REGULAR (TENDON). PNTA ROM CURV-ABOT. LONG 140-170mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581368	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MC INDOE CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA AGUDA- DOS DIENTES ANCHO 9.0 mm-10 mm. LONG 140-170 mm	GANCHO-RETRACTOR DE MC INDOE CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA AGUDA CURVA- DOS DIENTES ANCHO 9.0 mm - 10 mm. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581369	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MÜLLER ABOTONADO PARA TEJIDOS DELICADOS. DOS DIENTES PUNTA AGUDA-ABOT- PROF 2-3mm X ANCHO 3-5mm. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE MÜLLER ABOTONADO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE-NARIZ). PUNTA FINA AGUDA CURVA Y ABOTONADA- DOS DIENTES PROFUNDIDAD 2-0 mm - 3-0 mm X ANCHO 3-0 mm - 5-0 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581370	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE MÜLLER SENCILLO ABOTONADO PARA TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE-QUEMADOR). PUNTA AGUDA-ABOTONADA. LONG 140-170mm	GANCHO-RETRACTOR DE MÜLLER SENCILLO ABOTONADO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE- QUEMADOR). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN MEDIO CIRCULO Y ABOTONADA. MANGO PLANO. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581374	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE ST. BARTS SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA ROMA ANGUL 90°. LONG 150-180mm	GANCHO-RETRACTOR DE ST. BARTS SENCILLO ANGULADO PARA TEJIDOS DELICADOS (NERVIOS Y VASOS). PUNTA FINA ROMA ANGULADA 90° GRADOS. MANGO REDONDO ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581375	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE TÖNNIS SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA AGUDA CURVA 3-8 CIRCULO. LONG 130-160mm	GANCHO-RETRACTOR DE TÖNNIS SENCILLO CURVO PARA PIEL Y TEJIDOS DELICADOS (DURAMADRE). PUNTA FINA AGUDA CURVA EN 3-8 DE CIRCULO. MANGO PLANO. LONGITUD 130 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581376	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA. MANGO EN ARO Y LAGRIMA. LONG 220-250mm	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581377	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA. MANGO	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA. MANGO PLANO. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							PLANO. LONG 220-250mm. ACERO QUIR	
2581378	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA. MANGO EN ARO Y LAGRIMA. LONG 220-250mm	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA CURVA. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581379	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA CURVA. MANGO PLANO. LONG 220-250mm. ACERO QUIR	GANCHO-RETRACTOR DE VOLKMANN CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA ROMA CURVA. MANGO PLANO. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581381	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA CIR GRAL (TEJIDOS PROFUNDID). VALVA ANG 90°-PROF 35-40mm X ANCHO 60-70mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 35 mm - 40 mm X ANCHO 60 mm - 70 mm. MANGO PLANO FENESTRADO EN TODA SU EXTENSION ADAPTADO PARA SUJETAR EN SEPARADOR ABDOMINAL Y EN ANCLA HACIA DISTAL. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581382	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA CIR GRAL (TEJIDOS PROFUNDID).	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm X ANCHO 75 mm - 85 mm. MANGO PLANO FENESTRADO EN TODA SU EXTENSION ADAPTADO PARA SUJETAR EN SEPARADOR

							VALVA ANG 90°- PROF 45-55mm X ANCHO 75-85mm. LONG 240-270mm	ABDOMINAL Y EN ANCLA HACIA DISTAL. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581383	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA CIR GRAL (TEJIDOS PROFUNDID). VALVA ANG 90°- PROF 60-70mm X ANCHO 80-90mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR CENTRAL DE BALFOUR ANGULADO PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 60 mm - 70 mm X ANCHO 80 mm - 90 mm. MANGO PLANO FENESTRADO EN TODA SU EXTENSION ADAPTADO PARA SUJETAR ENSE PARADOR ABDOMINAL Y EN ANCLA HACIA DISTAL. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581390	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANG 90° Y CURVA DISTAL- PROF 160-180mm X ANCHO 25-30mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANGULADA 90° GRADOS Y CURVA HACIA DISTAL- PROFUNDIDAD 160 mm - 180 mm X ANCHO 25 mm - 30 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 240 mm-270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581391	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANG 90°- PROFUND 80 mm - 100 mm X ANCHO 20 mm - 25 mm. LONG 250-280mm	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANGULADA 90° GRADOS- PROFUNDIDAD 80 mm - 100 mm X ANCHO 20 mm - 25 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581392	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANG 90°- PROFUND 120 mm - 140 mm	RETRACTOR DE BRUNNER ANGULADO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO. VALVA LISA ANGULADA 90° GRADOS- PROFUNDIDAD 120 mm - 140 mm X ANCHO 25M M - 30 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-

							X ANCHO 25 mm - 30 mm. LONG 250-280mm	100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581400	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIR CARD. RAMA 20°-30° DER. VALVA CANASTILL BORDE DENT-PROF 45-50mmXANCHO 45-50mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR (GRANDES VASOS). RAMA ANGULADA 20° - 30° GRADOS A LA DERECHA. VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA CON BORDE DISTAL FINAMENTE DENTADO- PROFUNDIDAD 45 mm - 50 mm X ANCHO 45 mm - 50 mm. MANGO TUBULAR ACANALADO-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581401	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIR CARD. RAMA 20°-30° DER CANAST BORDE LISO PROF 45-50mmXANCHO 45-50mm MANGO SINT. LONG 250-280mm	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR (GRANDES VASOS). RAMA ANGULADA 20° - 30° GRADOS A LA DERECHA. VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA CON BORDE DISTAL LISO- PROFUNDIDAD 45 mm - 50 mm X ANCHO 45 mm - 50 mm. MANGO MACIZO-ANTIDESLIZANTE EN MATERIAL SINTETICO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. LONGITUD 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581402	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIR CARD. RAMA 20°-30° DER. VALVA CANASTILL BORDE LISO-PROF 45-50mmXANCHO 45-50mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR (GRANDES VASOS). RAMA ANGULADA 20° - 30° GRADOS A LA DERECHA. VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA CON BORDE DISTAL LISO- PROFUNDIDAD 45 mm - 50 mm X ANCHO 45 mm - 50 mm. MANGO TUBULAR ACANALADO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581403	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIR CARD. RAMA 20°-30° IZQ CANAST BORDE LISO PROF 25-30mmXANCHO 45-50mm MANGO SINT. LONG 250-280mm	RETRACTOR DE COOLEY ANGULADO PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR (GRANDES VASOS). RAMA ANGULADA 20° - 30° GRADOS A LA IZQUIERDA. VALVA EN CANASTILLA FENESTRADA CON BORDE DISTAL LISO- PROFUNDIDAD 25 mm - 30 mm X ANCHO 45 mm - 50 mm. MANGO MACIZO-ANTIDESLIZANTE EN MATERIAL SINTETICO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. LONGITUD 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581416	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA CIR GRAL (TEJIDO GRUESO). VALVA LISA CURVATURA EN C ANCHO 18-22mm. MANGO PLANO LISO. LONG 180-220mm	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA LISA CURVATURA EN "C" ANCHO 18 mm - 22 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD 180 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581417	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA LISA CURVATURA EN "C" ANCHO 20 mm - 23 mm. MANGO P LANO LISO Y CURVADO HACIA DIISTAL. LONGITUD 200 mm	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA LISA CURVATURA EN "C" ANCHO 20 mm - 23 mm. MANGO PLANO LISO Y CURVADO HACIA DIISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581418	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA CIR GRAL (TEJIDO GRUESO). VALVA LISA	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA LISA CURVATURA EN "C" ANCHO 25 mm - 30 mm. MANGO ANATOMICO TUBULAR DESDE TERCIO MEDIO Y CURVADO HACIA DISTAL. LONGITUD 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							CURVATURA EN C ANCHO 25-30mm. MANGO TUBULAR. LONG 300-330mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581419	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA CIR GRAL (TEJIDO GRUESO). VALVA LISA CURVATURA EN C ANCHO 25-30mm. MANGO PLANO LISO. LONG 300-350mm	RETRACTOR DE DEAVER CURVO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA LISA CURVATURA EN "C" ANCHO 25 mm - 30 mm. MANGO PLANO LISO Y CURVADO HACIA DIISTAL. LONGITUD 300 mm - 350 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581428	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DESMARRES RECTO PARA TEJIDO REGULAR (CIR VASC-OFTALMO). VALVA SILLA MONTAR- PROF 11-13mm X ANCHO 14-18mm. LONG 140-170	RETRACTOR DE DESMARRES RECTO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (CIRUGIA VASCULAR Y OFTALMOLOGIA). VASTAGO RECTO. VALVA EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 11 mm - 13 mm X ANCHO 14 mm - 18 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581429	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE DOYEN RECTO PARA TEJIDO REGULAR (CIRUG GRAL). VALVA SILLA MONTAR ANG 90°- PROF 45-55mm X ANCHO 90-105mm. LONG 270-300mm	RETRACTOR DE DOYEN RECTO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (CIRUGIA GENERAL). VASTAGO RECTO. VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULADA 90° GRADOS- PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm X ANCHO 90 mm - 105 mm. MANGO PLANO ACANALADO TERCIO MEDIO Y EN ANCLA HACIA DISTAL. LONGITUD 270 mm - 300 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581432	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE FARABEUF DOBLE EXTREMO PARA TEJIDO REGULAR. VALVAS C ANG 90°- PROFUND 20-23mm-24-26mm X ANCHO 14-16mm. LONG 140-160mm	RETRACTOR DE FARABEUF DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVAS CURVATURA EN "C" ANGULO DE 90° GRADOS PROFUNDIDADES 20 mm - 23 mm Y 24 mm - 26 mm X ANCHO 14 mm - 16 mm. ZONA DE AGARRE LISA-PLANA. LONGITUD 140 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GR ADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581433	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE FARABEUF DOBLE EXTREMO PARA TEJIDO REGULAR. VALVASCANG 90° PROF 22-26mm-28-30mmXANCHO 10-12mm-12-14mm. LONG 110-130mm	RETRACTOR DE FARABEUF DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVAS CURVATURA EN "C" ANGULO DE 90° GRADOS PROFUNDIDADES 22 mm - 26 mm Y 28 mm - 30 mm X ANCHO 10 mm - 12 mm Y 12 mm - 14 mm. ZONA DE AGARRE LISA- PLANA. LONGITUD 110 mm - 130 mm. ACERO QUIRU RGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581436	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE FRITSCH RECTO PARA TEJIDO GRUESO (CIR GENER). VALVA SILLA MONTAR ANG 90°- PROF 30-40mm X ANCHO 40-50mm. LONG 230-270mm	RETRACTOR DE FRITSCH RECTO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULADA 90° GRADOS-PROFUNDIDA D 30 mm - 40 mm X ANCHO 40 mm - 50 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 23 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581437	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE FRITSCH RECTO PARA TEJIDO GRUESO (CIR GENER). VALVA SILLA MONTAR ANG 90°- PROF 41-50mm X ANCHO 60-	RETRACTOR DE FRITSCH RECTO PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (CIRUGIA GENERAL). VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULADA 90° GRADOS-PROFUNDIDA D 41 mm - 50 mm X ANCHO 60 mm - 75 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 23 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							75mm. LONG 230-270mm	
2581513	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ABAJO- PROF 25-35mm X ANCHO 5-0-10mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ABAJO- PROFUNDIDAD 25 mm - 35 mm X ANCHO 5-0 mm - 10 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581514	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ABAJO- PROF 40-50mm X ANCHO 10-15mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ABAJO- PROFUNDIDAD 40 mm - 50 mm X ANCHO 10 mm - 15 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581515	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ABAJO- PROF 55-65mm X ANCHO 10-15mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ABAJO- PROFUNDIDAD 55 mm - 65 mm X ANCHO 10 mm - 15 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581516	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ABAJO- PROF 70-80mm X ANCHO 10-20mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ABAJO- PROFUNDIDAD 70 mm - 80 mm X ANCHO 10 mm - 20 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581517	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ARRIBA-PROF 25-35mm X ANCHO 5-0-10mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ARRIBA- PROFUNDIDAD 25 mm - 35 mm X ANCHO 5-0 mm - 10 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581518	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL) . VALVA CURVA HACIA ARRIBA-PROF 40-50mm X ANCHO 10-15mm. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE OBWEGESER PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR (MAXILOFACIAL). VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO Y DISTAL CURVA HACIA ARRIBA- PROFUNDIDAD 40 mm - 50 mm X ANCHO 10 mm - 15 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581530	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE RICHARDSON PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA SILLA DE MONTAR ANG RECTO- PROF 20-25mm X ANCHO 20-25mm. LONG 230-250mm	RETRACTOR DE RICHARDSON PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO- PROFUNDIDAD 20 mm - 25 mm X ANCHO 20M M - 25 mm. MANGO EN MEDIACAÑA ANILLADO HACIA MEDIAL Y ERGONOMICO HACIA DISTAL. LONGITUD 230 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581531	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE RICHARDSON PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA SILLA DE MONTAR ANG RECTO- PROF 30-34mm X ANCHO 25-30mm. LONG 230-250mm	RETRACTOR DE RICHARDSON PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVA EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO- PROFUNDIDAD 30 mm - 34 mm X ANCHO 25M M - 30 mm. MANGO EN MEDIACAÑA ANILLADO HACIA MEDIAL Y ERGONOMICO HACIA DISTAL. LONGITUD 230 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALT O GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581535	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN DOBLE EXTREMO PARA TEJIDO REGUL. PROF 28-38mmXANCH 25-35mm-PROF 20-30mmXANCH 20-25mm. LONG 250-2	RETRACTOR DE RICHARDSON-EASTMAN DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. VALVAS EN SILLA DE MONTAR ANGULO RECTO-PROFUNDIDAD 28 mm - 38 mm X ANCHO 25 mm - 35 mm Y PROFUNDIDAD 20 mm - 30 mm X ANCHO 20 mm - 25 mm. ZONA DE AGARRE EN MEDIACAÑA ANILLADO HACIA MEDIAL. LONGITUD 250 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581543	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE SENN-MILLER DOBLE EXTR. TRES DNTES AGUD PROF 7-9mmXANCH 6-8mm Y VALVA ANG RECTO PROF 17-20mmXANCH 6-8mm. LONG 150-170mm	RETRACTOR DE SENN-MILLER DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. TRES DIENTES PUNTA AGUDA CURVA- PROFUNDIDAD 7-0 mm - 9-0 mm X ANCHO 6-0 mm - 8-0 mm Y VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO CURVA HACIA DISTAL- PROFUNDIDAD 17 mm - 20 mm X ANCHO 6-0 mm - 8-0 mm. ZONA DE AGARRE PLANA Y TRANSVERSA A LAS PUNTAS. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581544	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE SENN-MILLER DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. TRES DIENTES PUNTA ROMA CURVA-PROFUNDIDAD 7-0 mm - 9-0 mm XA NCHO 6-0 mm - 8-0 mm Y VALVA LISA-ROMA EN ANGULO RECTO CURVA HACIA DISTAL-PROFUNDIDAD 17 mm - 20 mm X ANCHO 6-0 mm - 8-0 mm	RETRACTOR DE SENN-MILLER DOBLE EXTREMO PARA HERIDAS Y TEJIDO REGULAR. TRES DIENTES PUNTA ROMA CURVA- PROFUNDIDAD 7-0 mm - 9-0 mm XA NCHO 6-0 mm - 8-0 mm Y VALVA LISA ROMA EN ANGULO RECTO CURVA HACIA DISTAL-PROFUNDIDAD 17 mm - 20 mm X ANCHO 6-0 mm - 8-0 mm. ZONA DE AGARRE PLANA Y TRANSVERSA A LAS PUNTAS. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581555	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE VOLKMANN PARA TEJIDO GRUESO (HUESO). DOS DIENTS AGUD PROF 8.0-9.0mm X ANCHO 7.0-9.0mm. MANGO FENESTRADO. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE VOLKMANN PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA-DOS DIENTES PROFUNDIDAD 8.0 mm - 9.0 mm X ANCHO 7.0M M - 9.0 mm. MANGO PLANO CON FENESTRACION EN ARO TERCIO MEDIO Y EN LAGRIMA EN TERCIO DISTAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581556	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR DE VOLKMANN PARA TEJIDO GRUESO (HUESO). DOS DIENTES AGUDOS PROF 8.0-9.0mm X ANCHO 7.0-9.0mm. MANGO PLANO. LONG 200-230mm	RETRACTOR DE VOLKMANN PARA HERIDAS Y TEJIDO GRUESO (HUESO). PUNTA AGUDA CURVA-DOS DIENTES PROFUNDIDAD 8.0 mm - 9.0 mm X ANCHO 7.0M M - 9.0 mm. MANGO PLANO. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ES TERILIZACION
2581586	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR-ELEVADOR DE BENNETT ANGULADO. VALVA ANG 45°-ANCH PROX 40-45mm X ANCH DISTAL 25-30mm. MANGO TOPE SUJECION. LONG 220-250mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE BENNETT ANGULADO PARA TEJIDO OSEO (ORTOPEDIA)- RAMA LISA ENSANCHADA HACIA TERCIO MEDIO-ADELGAZANDOSE HACIA DISTAL Y VALVA ANGULADA 45° GRADOS- ANCHO PROXIMAL 40 mm - 45 mm X ANCHO DISTAL - 25 mm - 30 mm. MANGO ANATOMICO CON TOPE DE SUJECION - TUBULAR DESDE TERCIO MEDIO Y CURVADO HACIA DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581590	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA LEVE CURVATURA ANATOMICA-SEMIRECTANG	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA LEVE CURVATURA ANATOMICA-SEMIRECTANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO 15 mm - 20 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ULAR HACIAT ERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA- ROMA- ANCHO 15 mm - 20 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250 mm	
2581591	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR- ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR. VALVA LEVE CURVATURA- PUNTA ESTRECHA- ANCHO 40- 45mm. LONG 220-250mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA LEVE CURVATURA ANATOMICA- CUADRANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO 40 mm - 45 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 220 mm - 250M M. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581592	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR- ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO- MUSCULAR. VALVA CURVAT ACENTUADA- PUNTA ESTRECHA- ANCHO 65- 70mm. LONG 240-270mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVATURA ANATOMICA ACENTUADA- CUADRANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-SEMIAGUADA- ANCHO 65 mm - 70 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581593	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR- ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO- MUSCULAR. VALVA LEVE CURV- RECTANG- PUNTA ANCHA-	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA LEVE CURVATURA ANATOMICA- RECTANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ANCHA-ROMA- ANCHO 20 mm - 25 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							ANCHO 20-25mm. LONG 250-280mm	
2581594	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR. VALVA LEVE CURVATURA-PUNTA ANCHA-ANCHO 22-26mm. LONG 260-290mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN CURVO PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA LEVE CURVATURA ANATOMICA-ENSANCHADA HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ANCHA-REDONDEADA- ANCHO 22 mm - 26 mm. MANGO PLANO- FENESTRACION EN ARO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD 260 mm - 290 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581598	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN-MINIEN S. VALVA PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 6-8mm X ANCHO DISTAL 2-3mm. LONG 150-170mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN-MINIEN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVA EN "S"- SEMIRECTANGULAR HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 6-0 mm - 8-0 mm X ANCHO DISTAL 2.0 mm - 3.0 mm. MANGO PLANO- LISO. LONGITUD 150 mm -17 0 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581599	42293107	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN-MINIEN S. VALVA PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 12-14mm X ANCHO DISTAL 2-3mm. LONG 150-170mm	RETRACTOR-ELEVADOR DE HOHMANN-MINIEN "S" PARA TEJIDO OSEO Y MUSCULAR (ORTOPEDIA). VALVA CURVA EN "S"- ENSANCHADA HACIA TERCIO MEDIO- PUNTA ESTRECHA-ROMA- ANCHO PROXIMAL 12 mm - 14 mm X ANCHO DISTAL 2.0 - 3.0 mm. MANGO PLANO- LISO. LONGITUD 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581614	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). CON TORNILLO	SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). CON TORNILLO DE SUJECION EN MARIPOSA PARA FIJAR RETRACTOR CENTRAL REMOVIBLE DE VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm X ANCHO 75 mm - 85 mm. VALVAS LATERALES FIJAS EN ALAMBRE PROFUNDIDAD 60 mm - 70 mm X ANCHO 30 mm - 40 mm. APERTURA ENTRE

							DE SUJECION EN MARIPOSA PARA F IJAR RETRACTOR CENTRAL REMOVIBLE DE VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 45 mm - 55 mm X ANCHO 75 mm - 85 mm.	VALVAS 150 mm - 200 mm. LONGITUD TOTAL 150 mm - 200 mm X 190 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILI ZACION
2581617	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR-BABY. VALVAS LAT FIJAS PROF 25-28mm X ANCHO 27-30mm. APERT VALVAS 90-95mm. LONG 110-125mm X 120-135mm	SEPARADOR ABDOMINAL DE BALFOUR-BABY PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA PEDIATRICA). CON TORNILLO DE SUJECION EN MARIPOS A PARA FIJAR RETRACTOR CENTRAL REMOVIBLE DE VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR PROFUNDIDAD 20 mm - 22 mm X ANCHO 23 mm- 25 mm. VALVAS LATERALES FIJAS EN ALAMBRE PROFUNDIDAD 25 mm - 28 mm X ANCHO 27 mm - 30 mm. APERTURA ENTRE VALVAS 90 mm - 95 mm. LONGITUD TOTAL 110 mm - 125 mm X 120 mm - 135 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581618	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR ABDOMINAL DE GOSSET. VALVAS LAT FIJAS PROF 55-65mm X ANCHO 25-35mm. APERTURA VALVAS 150-190mm. LONG 180-200mm X 160-180mm	SEPARADOR ABDOMINAL DE GOSSET PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA PEDIATRICA). CON TORNILLO DE SUJECION EN MARIPOSA PARA FIJAR RETRACTOR CENTRAL REMOVIBLE DE VALVA ANGULADA 90° GRADOS Y EN SILLA DE MONTAR- PROFUNDIDAD 55 mm - 65 mm X ANCHO 50 mm - 60mm. VALVAS LATERALES FIJAS EN ALAMBRE PROFUNDIDAD 55 mm - 65 mm X ANCHO 25 mm - 35 mm. APERTURA ENTRE VALVAS 150 mm - 190 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm - 200 mm X 160 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581621	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR DE ADSON AUTOESTATICO ARTICULADO (ORTOPEDIA). RAMAS ARTICULADAS-	SEPARADOR DE ADSON AUTOESTATICO ARTICULADO PARA TEJIDO GRUESO (ORTOPEDIA-COLUMNA). RAMAS ARTICULADAS DESDE TERCIO DISTAL- PUNTA 4X 5 DIENTES SEMIAGUDOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO CON RATCHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIO MEDIAL. LONGITUD 300

							PUNTA 4X5 DIENTES SEMIAGUD. MANGO RATCHET. LONG 300-330mm	mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581633	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR DE ADSON-BECKMANN AUTOESTATICO (ORTOPEDIA). RAMAS ARTICULADAS- PUNTA 4 X 4 DIENTES AGUDOS. MANGO RATCHET. LONG 300-330mm	SEPARADOR DE ADSON-BECKMANN AUTOESTATICO ARTICULADO PARA TEJIDO GRUESO (ORTOPEDIA- COLUMNA). RAMAS ARTICULADAS DESDE TERCIO DISTAL- PUNTA 4 X 4 DIENTES CORTOS AGUDOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO CON RATCHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIOMEDIAL. LONGITUD 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581647	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR DE GELPI AUTOESTATICO PARA TEJIDO REGULAR. RAMAS CURVO-ANG 45°- PUNTAS AGUDAS HACIA LATERAL. MANGO RATCHET. LONG 170-190mm	SEPARADOR DE GELPI AUTOESTATICO PARA TEJIDO REGULAR. RAMAS CURVADAS DESDE TERCIO MEDIO Y ANGULADAS 45° GRADOS HACIA DISTAL- PUNTAS AGUDAS HACIA LATERAL. MANGO CON RATCHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIO MEDIAL. LONGITUD 170 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581660	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR DE TRAVERS AUTOESTATICO . RAMAS RECTAS- PUNTA 4 X 5 DIENTES ROMOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO CON RATCHET. LONG 200-230mm	SEPARADOR DE TRAVERS AUTOESTATICO PARA TEJIDO REGULAR. RAMAS RECTAS- PUNTA 4 X 5 DIENTES ROMOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO CON RAT CHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIO MEDIAL. LONGITUD 200 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581661	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR DE WEITLANER AUTOESTATICO . PUNTA 2X3 DIENTS AGUDOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO RATCHET Y TOPE DE SEGURIDAD. LONG 100-120mm	SEPARADOR DE WEITLANER AUTOESTATICO PARA TEJIDO SUAVE. PUNTA 2 X 3 DIENTES AGUDOS CURVOS HACIA LATERAL. MANGO CON RATCHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIO MEDIAL. LONGITUD 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581690	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR TORACICO DE D'BAKEY. BASTIDOR MOVIL. VALVAS INTERCAMBIABLES- APERTURA ENTRE VALVAS 140-160mm. LONG 200-230mm X 170-190mm	SEPARADOR TORACICO DE D'BAKEY PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (COSTILLAS- ESTERNON). CON TORNILLO PARA FIJACION DE BASTIDOR MOVIL A MANGO RECTO-PLANO CON RATCHET EN CREMALLERA HACIA LATERAL. BASTIDORES RECTOS ADAPTADOS PARA VALVAS INTERCAMBIABLES- APERTURA ENTRE VALVAS 140 mm - 160 mm. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm X 170 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581691	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR TORACICO DE D'BAKEY. BASTIDOR MOVIL- VALVAS INTERCAMBIABLES- APERTURA ENTRE VALVAS 180-220mm. LONG 270-300mm X 215-235mm	SEPARADOR TORACICO DE D'BAKEY PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (COSTILLAS- ESTERNON). CON TORNILLO PARA FIJACION DE BASTIDOR MOVIL A MANGO RECTO-PLANO CON RATCHET EN CREMALLERA HACIA LATERAL. BASTIDORES RECTOS ADAPTADOS PARA VALVAS INTERCAMBIABLES- APERTURA ENTRE VALVAS 180 mm - 220 mm. LONGITUD TOTAL 270 mm - 300 mm X 215 mm - 235 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581692	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR TORACICO DE FINOCHIETTO(NEONATOS). VALVAS FIJAS-PROF 12-15mmXANCH 12-15mm- APERT 70-80mm. LONG 90-110mmX60-	SEPARADOR TORACICO DE FINOCHIETTO PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA PEDIATRICA-NEONATOS). CON TORNILLO PARA FIJACION DE BASTIDOR MOVIL A MANGO RECTO-PLANO CON RATCHET EN CREMALLERA HACIA LATERAL. BASTIDORES RECTOS CON VALVAS FIJAS- FENESTRADAS- Y ANGULADAS 90° GRADOS HACIA MEDIAL- PROFUNDIDAD 12 mm - 15 mm X ANCHO 12 mm - 15 mm- APERTURA ENTRE VALVAS 70 mm - 80 mm. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm X

							80mm. ALUMINIO	60 mm - 80 mm. ALUMINIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION A VAPOR
2581693	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR TORACICO DE FINOCHIETTO(PEDIAT). VALVS FIJAS- PROF 28-32mmXANCH 28-32mm- APERT 90-110mm. LONG 135-145mmX90-110mm. ALUMINIO	SEPARADOR TORACICO DE FINOCHIETTO PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA PEDIATRICA). CON TORNILLO PARA FIJACION DE BASTIDOR MOVIL A MANGO RECTO- PLANO CON RATCHET EN CREMALLERA HACIA LATERAL. BASTIDORES RECTOS CON VALVAS FIJAS-FENESTRADAS- Y ANGULADAS9 0° GRADOS HACIA MEDIAL- PROFUNDIDAD 28 mm - 32 mm X ANCHO 28 mm - 32 mm- APERTURA ENTRE VALVAS 90 mm - 110 mm. LONGITUD TOTAL 135M M - 145 mm X 90 mm - 110 mm. ALUMINIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION A VAPOR
2581709	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	VALVA-BAJALENGUA INTERCAMBIABLE PARA SEPARADOR Mc IVOR. RAMA ANG 90°. VALVA ENSANCHADA PROF 95-110mm X ANCHO 26-27mm. LONG 130-1	SEPARADOR-ABREBOCAS DE Mc IVOR PARA BOCA. ANILLO EN SEMITRIANGULO CUBIERTO CON PROTECTOR TEFLONADO CON BASE 90 mm - 100 mm X ALTURA 60 mm - 80 mm UNIDO A BASTIDOR RECTO CON BOTON-PALANCA MUESCADO PARA FIJACION DE VALVA INTERCAMBIABLE. LONGITUD 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581767	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 2.0-2.5mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 180-2	VALVA-BAJALENGUA INTERCAMBIABLE PARA SEPARADOR DE Mc IVOR. RAMA LISA- ANGULADA 90° GRADOS. VALVA ENSANCHADA HACIA DISTAL CON LEVE CURVATURA CONVEXA PROFUNDIDAD 80 mm - 90 mm X ANCHO 24 mm - 25.5 mm. MANGO PLANO- MUESCADO EN TERCIO MEDIAL PARA ADAPTARSE A BASTIDOR DEL SEPARADOR Y CURVATURA ANATOMICA HACIA DISTAL. LONGITUD 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581768	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	VALVA-BAJALENGUA INTERCAMBIABLE PARA SEPARADOR DE Mc IVOR. RAMA LISA- ANGULADA 90° GRADOS. VALVA	VALVA-BAJALENGUA INTERCAMBIABLE PARA SEPARADOR DE Mc IVOR. RAMA LISA- ANGULADA 90° GRADOS. VALVA ENSANCHADA HACIA DISTAL CON LEVE CURVATURA CONVEXA PROFUNDIDAD 95 mm - 110 mm X ANCHO 26 mm - 27 mm. MANGO PLANO- MUESCADO EN TERCIO MEDIAL PARA ADAPTARSE A BASTIDOR DEL SEPARADOR Y CURVATURA ANATOMICA HACIA DISTAL. LONGITUD 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO

							ENSANCHADA HACIA DISTAL CON LEVEC URVATURA CONVEXA PROFUNDIDAD 95 mm - 110 mm X ANCHO 26 mm - 27 mm.	DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583219	42291802	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	GANCHO-MANIPULADOR DE DRYSDALE ANGULADO (LENTE INTRAOCULAR). VASTAGO ANG 45°-60°- PUNTA PALO DE GOLF- UTIL 0.5-0.75mm. LONG 100-120mm	GANCHO-MANIPULADOR DE DRYSDALE ANGULADO (MANIPULAR LENTE INTRAOCULAR). VASTAGO ANGULADO 45° - 60° GRADOS Y PUNTA EN PALO DE GOLF HACIA RETROGRADA- ROMA-ATRAUMATICA- LARGO UTIL 0.5 mm - 0.75 mm. MANGO MACIZO- REDONDO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583220	42293302	ZMQX	ZMQI-007	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SEPARADOR ABDOMINAL DE O'SULLIVAN-O'CONNOR PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). BASTIDOR EN ANILLO PLANO CON TO RNILLOS DE SUJECION EN MARIPOSA PARA FIJAR TRES RETRACTORES REMOVIBLES DE VALVAS ANGULADAS 90° GRADOS- DOS DE 80 mm - 90 mm X 40 mm- 45 mm Y UNO DE 100 mm - 110 mm X 70 mm - 75 mm.	SEPARADOR ABDOMINAL DE O'SULLIVAN-O'CONNOR PARA TEJIDOS GRUESOS Y EN PROFUNDIDAD (CIRUGIA GENERAL). BASTIDOR EN ANILLO PLANO CON TORNILLOS DE SUJECION EN MARIPOSA PARA FIJAR TRES RETRACTORES REMOVIBLES DE VALVAS ANGULADAS 90° GRADOS- DOS DE 80 mm - 90 mm X 40 mm- 45 mm Y UNO DE 100 mm - 110 mm X 70 mm - 75 mm. MANGOS PLANOS FENESTRADOS ADAPTADOS PARA SUJETAR EN SEPARADOR. VALVAS LATERALES FIJAS EN "C" INVERTIDA- PROFUNDIDAD 60 mm - 70 mm X ANCHO 30 mm - 40 mm. MANGO CON RATCHET TRANSVERSAL MULTIDENTADO Y TOPE DE SEGURIDAD EN TERCIO MEDIAL. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

INSTRUMENTOS DE MEDICION

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2581770	42292802	ZMQX	ZMQI-008	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	COMPAS-CALIBRADOR-MARCDOR CASTRO VIEJO EN ANGULO DE 45°-RAMAS RECTAS PLANAS-TORNILO DE AJUSTE TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO-BASTIDOR-	COMPAS-CALIBRADOR-MARCADOR DE CASTROVIEJO ANGULADO MULTIPROPOSITO (OFTALMOLOGIA-CIRUGIA PLASTICA-OCULOPLASTIA)-PUNTAS AGUDAS ANGULADAS 45° GRADOS EN TERCIO DISTAL-RAMAS RECTAS PLANAS-TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO PARA FIJACION DE RAMA MOVIL INDICADORA-BASTIDOR-REGLETA GRADUADO EN MILIMETROS HASTA 40 mm-ESCALA BILATERAL-LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							REGLETA GRADUADO EN MILIMETROS HASTA 40 mm-LONGITUD 80-90mm	
2581771	42292802	ZMQX	ZMQI-008	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	COMPAS-CALIBRADOR-MARCADOR DE CASTROVIEJO CURVO-RAMAS Y PUNTAS AGUDAS CURVAS-BASTIDOR-REGLETA GRADUADO HASTA 20 mm-LONG 80-90 mm	COMPAS-CALIBRADOR-MARCADOR DE CASTROVIEJO CURVO MULTIPROPOSITO (OFTALMOLOGIA-CIRUGIA PLASTICA-OCULOPLASTIA)-PUNTAS AGUDAS CURVAS-RAMAS CURVAS DESDE TERCIO MEDIO-TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO PARA FIJACION DE RAMA MOVIL INDICADORA-BASTIDOR-REGLETA GRADUADO EN MILIMETROS HASTA 20 mm-ESCALA BILATERAL-LONGITUD TOTAL 80 mm- 90 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581772	42292802	ZMQX	ZMQI-008	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	COMPAS-CALIBRADOR-MARCADOR DE CASTROVIEJO RECTO-RAMAS Y PUNTAS AGUDAS RECTAS-BASTIDOR-REGLETA GRADUADO HASTA 20 mm-LONG 80-90 mm	COMPAS-CALIBRADOR-MARCADOR DE CASTROVIEJO RECTO MULTIPROPOSITO (OFTALMOLOGIA-CIRUGIA PLASTICA-OCULOPLASTIA)-PUNTAS AGUDAS RECTAS-RAMAS RECTAS PLANAS-TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO PARA FIJACION DE RAMA MOVIL INDICADORA-BASTIDOR-REGLETA GRADUADO EN MILIMETROS HASTA 20 mm-ESCALA BILATERAL-LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

SUCCION-IRRIGACION-EXPANSIÓN								
CODIGO GENERICO	**CODIGO UNSPSC**	**TIPO DE MATERIAL**	**GRUPO DE ARTICULOS**	**SUB-GRUPO DE ARTICULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RUBRO**	**NOMBRE GENERICO**	**ESPECIFICACION TECNICA**
2581828	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE ADSON CON MANDRIL. DIAM LUZ 3-4mm. LARG UTIL 120-140mm. VALV CONTROL	CANULA DE SUCCION DE ADSON CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO RECTO- PUNTA ROMA- CORTE OBLICUO-ATRAUMATICA - DIAMETRO DE LUZ 3.0 mm - 4.0 mm ^ 9 - 12 FRENCH- LARGO UTIL 120 mm - 140 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB DIAMETRO 8.0 mm - 9.0 mm.

							FLUJO. LUER-HUB DIAM 8-9mm. LONG 160-190mm	LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581830	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE BELLUCCI MICRO CON MANDRIL. ANG45°- DIAM LUZ 2.5-3.5mm-LARG UTIL 80-100mm. LUER-HUB DIAM 6-9mm. LONG 150-170mm	CANULA DE SUCCION DE BELLUCCI MICRO CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (OTOLOGIA). TUBO ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 2.5 mm - 3.5 mm ^ 7 - 10 FRENCH- LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 150 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581842	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 2.0-2.5mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 100-140mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 2.0 mm - 2.5 mm ^ 6 - 7 FRENCH- LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 100 mm - 140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581843	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 2.0-2.5 mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9 mm. LONG 180-210 mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 2.0 mm - 2.5 mm ^ 6 - 7 FRENCH- LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581844	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 2.6-3.0mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 100-140mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DE LUZ 2.6 mm - 3.0 mm ^ 8 - 9 FRENCH-LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 100 mm - 140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581845	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 2.6-3.0mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 180-210mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DE LUZ 2.6 mm - 3.0 mm ^ 8 - 9 FRENCH-LARGO UTIL 90 mm - 110 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581846	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 3.0-3.5mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 100-140mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DE LUZ 3.0 mm - 3.5 mm ^ 9 - 10 FRENCH-LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 100 mm-140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581847	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAM LUZ 3.0-3.5mm. CONEX LUER-HUB-DIAM 6-9mm. LONG 180-210mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DE LUZ 3.0 mm - 3.5 mm ^ 9 - 10 FRENCH-LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm-210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581848	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO ANG 25°-45°-DIAMETRO LUZ 3.6-4.0mm. CONEXION LUER-HUB-DIAMETRO 6-9mm. LONG 100-140mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DE LUZ 3.6 mm - 4.0 mm ^ 11 - 12 FRENCH- LARGO UTIL 80 mm - 100 mm. CON VALVULA DE CONTROLD E FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 100 mm-1 40 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581849	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA SUCCION FRAZIER CON MANDRIL PARA ASPIRACION DE FLUIDOS DIAMETRO 3.6-4mm-LONGITUD 180-210mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm-210 mm ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581850	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA SUCCION FRAZIER DIAMETRO 4.6-5mm-LONGITUD 180-210 mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO ANGULADO 25° - 45° GRADOS DESDE TERCIO PROXIMAL-CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm-210 mm-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PRECESOS DE ESTERILIZACION
2581851	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL (USO GRAL). TUBO RECTO- DIAM LUZ 3.0-3.5mm. CONEXI LUER-HUB- DIAM 6.0-9.0mm. LONG 230-250mm	CANULA DE SUCCION DE FRAZIER CON MANDRIL PARA A SPIRACION DE FLUIDOS (USO GENERAL). TUBO RECTO- PUNTA ROMA ATRAUMATICA-DIAMETRO DEL UZ 3.0 mm - 3.5 mm - 9 - 10 FRENCH-LARGO UTIL 165 mm - 190 mm. CON VALVULA DE CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 230 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581853	42293501	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	CANULA DE SUCCION DE PLESTER MICRO CON MANDRIL(NEURO-OTOLOG).	CANULA DE SUCCION DE PLESTER MICRO CON MANDRIL PARA A S PIRACION DE FLUIDOS (NEURO-OTOLOGIA). TUBO ANGULADO 45° GRADOS DESDE TERCIO D ISTAL- PUNTA ROMA ATRAUMATICA- DIAMETRO DE LUZ 1.5 mm - 2.0 mm ^ 5 - 6 FRENCH- LARGO UTIL 150 mm - 170 mm. CON

							TUBO ANG 45°-DIAM LUZ 1.5-2.0mm. LUER-HUB- DIAM 6-9mm. LONG 180-210mm	VALVULA DE CONTROLD E FLUJO DE FLUIDOS O GA SES PARA OCLUIR CON PULGAR. SISTEMA DE CONEXION LUER-HUB- DIAMETRO 6.0 mm - 9.0 mm. LONGITUD TOTAL 180 mm-2 10 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581880	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PUNTA ROMA-CURVATURA 45°- CALIBRE 8-10FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA-CURVATURA DE 45° GRADOS- CALIBRE 8 - 10 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581881	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PNTA ROMA-CURVATURA 45°- CALIBRE 11-13FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA-CURVATURA DE 45° GRADOS-CALIBRE 11 - 13 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581882	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PNTA ROMA-CURVATURA 45°- CALIBRE 14-16FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA-CURVATURA DE 45° GRADOS- CALIBRE 14 - 16 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581883	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PNTA ROMA-	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA-CURVATURA DE 45° GRADOS- CALIBRE 17 - 19 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm.

							CURVATURA 45°- CALIBRE 17-19FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581884	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PNTA ROMA-CURVATURA 45°- CALIBRE 20-22FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- CURVATURA DE 45° GRADOS-CALIBRE 20 - 22 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581885	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOG Y GINECOBSTE. PNTA ROMA-CURVATURA 45°- CALIBRE 23-25FR. LARGO UTIL 250-280mm. LONG 330-360mm	DILATADOR RIGIDO DE DITTEL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (VIA S URINARIA S- CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- CURVATURA DE 45° GRADOS- CALIBRE 23 - 25 FRENCH. LARGO UTIL 250 mm - 280 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 330 mm - 360 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581888	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 1-3mm X 2-4mm. LARGO C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 1.0 mm - 3.0 mm X 2.0 mm - 4.0 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581889	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST).	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 5.0 mm - 7.0 mm X 6.0 mm - 8.0 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO

							CURVAS- DIAMS 5-7mm X 6-8mm. LARGO C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581890	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 9-11mmX10-12mm. LARGO C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 9.0 mm - 11 mm X 10 mm - 12 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581891	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 13-15mmX14-16mm. LARG C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 13 mm - 15 mm X 14 mm - 16 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581892	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 17-19mmX18-20mm. LARG C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA AN ATOMICA EN "S"- DIAMETROS 17 mm - 19 mm X 18 mm - 20 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECIONEN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION

2581893	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 21-23mmX22-24mm. LARG C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 21 mm - 23 mm X 22 mm - 24 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION
2581894	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION (GINECOBST). CURVAS- DIAMS 25-27mmX26-28mm. LARG C/EXTREM 70-85mm. LONG 180-210mm	DILATADOR RIGIDO FEMENINO DE HEGAR DOBLE FUNCION PARA GINECOBSTETRICIA (CUELLO UTERINO). PUNTA ROMA- ATRAUMATICA- LEVE CURVATURA ANATOMICA EN "S"- DIAMETROS 25 mm - 27 mm X 26 mm - 28 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 70 mm - 85 mm. SEGMENTO TUBULAR PARA SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION
2581915	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PNTA ROMA-CURVA 90°-CALIB 6.0-8.0FR. LARG UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIAS GENITO-URINARIA S. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 6.0 - 8.0 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581916	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°-CALIB 10-12FR. LARGO UTIL 200-240mm.	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIAS GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 10 -1 2 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONG 240-270mm	
2581917	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°-CALIB 14-16FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIAS GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 14 -1 6 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RES ISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581918	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°-CALIB 18-20FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIA S GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 18 -2 0 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581919	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°-CALIB 22-24FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIA S GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 22 -2 4 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581920	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIA S GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 26 -2 8 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO

							CURVA 90°- CALIB 26-28FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581921	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°- CALIB 30-32FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIAS GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 30 -3 2 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581922	42292601	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN (VIAS URINARIAS). PUNTA ROMA-CURVA 90°- CALIB 34-36FR. LARGO UTIL 200-240mm. LONG 240-270mm	DILATADOR RIGIDO MASCULINO DE VAN-BUREN PARA VIA S GENITO-URINARIAS. PUNTA ROMA-ATRAUMATICA- CURVATURA DE 90° GRADOS-CALIBRE 34 -3 6 FRENCH. LARGO UTIL 200 mm - 240 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581922	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-EVACUADOR RIGIDO FEMENINO CON MANDRIL(UROL OG-GINECOBST). PTA ROM-SEMICONIC-CALIB 10-12FR. LARGO UTIL 115-135mm. LONG 145-165mm	SONDA-EVACUADOR RIGIDO FEMENINO CON MANDRIL PARA UROLOGIA Y GINECOBSTETRICIA (USO GENERAL). PUNTA ROMA-SEMICONICA-ATRAUMATICA- CAL IBRE 10 - 12 FRENCH-ORIFICIOS OVALADOS PARA EVACUACION EN TERCIO DISTAL DE ARBOL- LARGO UTIL 115 mm - 135 mm- SEGMENTO ANILLADO PARA SUJECION HACIA EXTREMO PROXIMAL. LONGITUD TOTAL 145 mm - 165 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581949	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-EVACUADOR RIGIDO MASCULINO CON MANDRIL(UROLOG). PUNTA CURVA 45°-SEMICONIC CALIB 8.0-10FR. LARGO UTIL 115-135mm. LONG 145-165mm	SONDA-EVACUADOR RIGIDO MASCULINO CON MANDRIL PARA UROLOGIA (USO GENERAL). PUNTA CURVATURA DE 45° GRADOS- ROMA-SEMICONICA- ATRAUMATI CA- CALIBRE 8.0 - 10 FRENCH- ORIFICIOS OVALADOS PARA EVACUACION EN TERCIO DISTAL DE ARBOL. LARGO UTIL 115 mm - 135 mm. SEGMENTO ANILLADO PARA SUJECION HACIA EXTREMO PROXIMAL. LONGITUD TOTAL 145 mm - 165 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581950	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-EVACUADOR RIGIDO MASCULINO CON MANDRIL(UROLOG). PUNTA CURVA 45°-SEMICONIC CALIBR 12-14FR. LARGO UTIL 115-135mm. LONG 145-165mm	SONDA-EVACUADOR RIGIDO MASCULINO CON MANDRIL PARA UROLOGIA (USO GENERAL). PUNTA CURVATURA DE 45° GRADOS- ROMA-SEMICONICA- ATRAUMATI CA- CALIBRE 12 - 14 FRENCH- ORIFICIOS OVALADOS PARA EVACUACION EN TERCIO DISTAL DE ARBOL. LARGO UTIL 115 mm - 135 mm. SEGMENTO ANILLADO PARA SUJECION HACIA EXTREMO PROXIMAL. LONGITUD TOTAL 145 mm - 165 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581953	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA (TEJIDOS GRUESOS). PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONASUJECION PLANA-ACANALADA. LONG 100-1	SONDA-PALPADOR-HISTEROMETRO DE GALABINS MALEABLE PARA GINECOBSTETRICIA. PUNTA CURVATURA DE 45° GRADOS- ABOTONADA DIAMETRO 3.0 mm -4 .0 mm. ARBOL GRADUADO EN cm. LARGO UTIL 210 mm - 230 mm. MANGO PLANO LISO. LONGITUD TOTAL 280 mm - 320 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581956	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-PALPADOR-HISTEROMETRO DE SIMPSON PLATEADO MALEABLE. PUNTA ABOT	SONDA-PALPADOR-HISTEROMETRO DE SIMPSON PLATEADO MALEABLE PARA GINECOBSTETRICIA. PUNTA CURVATURA LEVE- ABOTONADA DIAMETRO 3.5 mm - 4 .5 mm. ARBOL GRADUADO. LARGO UTIL 210 mm - 240 mm. MANGO PLANO ACANALADO. LONGITUD TOTAL 300 mm - 330 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							DIAM 3.5-4.5mm. ARBOL GRAD LARGO UTIL 210-240mm. LONG 300-330mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581960	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-PROBADOR ACANALADA PARA FISTULA (USO GENERAL). PNTA ABOT DIAM 3.0-3.5mm. LARG UTIL 115-135mm- CANALETA CENTRAL. LONG 145-165mm	SONDA-PROBADOR ACANALADA PARA FISTULA (USO GENERAL). PUNTA ABOTONADA DIAMETRO 3.0 mm - 3.5 mm. LARGO UTIL 115 mm - 135 mm CON CANALETA CENTRAL LONGITUDINAL. SEGMENTO APLANADO PARA SUJECION EN EXTREMO PROXIMAL. LONGITUD TOTAL 145 mm - 165 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581961	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	SONDA-PROBADOR ACANALADA PARA FISTULA (USO GENERAL). PUNTA ROMA. LARGO UTIL 95-110mm- CANALETA CENTRAL LONGITUDINAL. LONG 120-140 mm	SONDA-PROBADOR ACANALADA PARA FISTULA (USO GENERAL). PUNTA ROMA ATRAUMATICA. LARGO UTIL 95 mm - 110 mm CON CANALETA CENTRAL LONGITUDINAL. SEGMENTO APLANADO PARA SUJECION EN EXTREMO PROXIMAL. LONGITUD TOTAL 120 mm - 140 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583322	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR LACRIMAL DE CASTROVIEJO DOBLE FUNCION RIGIDO(OCULOPL). DIAM PNTS 0.7-1.5mm X 1.0-2.0mm. LARGO UTIL 10-15mm. LONG 120-150mm	DILATADOR LACRIMAL DE CASTRO VIEJO DOBLE FUNCION RIGIDO PARA CONDUCTO (CIRUGIA PLASTICA- OCULOPLASTIA). PUNTAS FINAS ROMAS ATRAUMATICAS- DIAMETROS 0.7 mm - 1.5 mm X 1.0 mm - 2.0 mm. LARGO UTIL DE CADA EXTREMO 10 mm - 15 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO REDONDA ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583323	42292603	ZMQX	ZMQI-009	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	DILATADOR LACRIMAL DE WILDER RIGIDO CONDUCTO (OCULOPL). PUNTA FINA ROMA ATRAUMATICA- DIAM 0.7-1.1mm- LARGO UTIL 10 mm. LONG 90-110mm	DILATADOR LACRIMAL DE WILDER RIGIDO PARA CONDUCTO (CIRUGIA PLA STICA- OCULOPLA STIA). PUNTA FINA ROMA ATRAUMATICA- DIAMETRO 0.7 mm -1 .1 mm- LARGO UTIL 10 mm. ZONA DE SUJECION REDONDA ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
PARA SUTURAS								
CODIGO GENERICO	**CODIGO UNSPSC**	**TIPO DE MATERIAL**	**GRUPO DE ARTICULOS**	**SUB-GRUPO DE ARTICULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RUBRO**	**NOMBRE GENERICO**	**ESPECIFICACION TECNICA**
2505529	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS - PORTA ALAMBRE- MODELO FUERTE. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO.LONG 20CM - 7 (7-8")	PINZA PORTA ALAMBRE LONG 20cm - 7 (7-8") PORTA ALAMBRE- MODELO FUERTE PARA MATERIAL DE SUTURA TIPO ALAMBRE. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA TRAPEZOIDAL. MANDIBULAS FUERTES. MANGO ANILLOS DORADOS- CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 200mm (20cm - 7 (7-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581980	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER (SUTURA CALIBRE 8-0-12-0 EN MICROCIRUG). PUNTA CURVA-FINA. MANGO DORAD REDONDO CON RATCHET. LONG 125-135mm	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 8-0 -12-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA-FINA- MANDIBULAS DELICADAS. MANGO REDONDO CON RATCHET HACIA TERCIO MEDIAL Y DORADO HACIA TERCIO DISTAL. LONGITUD TOTAL 125 mm - 135 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2581981	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 8-0 - 12-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA-FINA-LONGOTID TOTAL 125 mm-135 mm	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 8-0 - 12-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA-FINA- MANDIBULAS DELICADAS-MANGO REDONDO CON RATCHET HACIA TERCIO MEDIAL Y DORADO HACIA TERCIO DISTAL-LONGITUD TOTAL 125 mm -135 mm 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100%RESISTENTE A CORROSIONY A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581982	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER (SUTURA CALIBRE 9-0-11-0 EN MICROCIR). PUNTA CURVA-ULTRADELICADA. MANG REDOND CON RATCHET. LONG 115-125mm	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 9-0 - 11-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA. MANDIBULAS ULTRADELICADAS. MANGO REDONDO CON RATCHET HACIA TERCIO MEDIAL. LONGITUD TOTAL 115 mm - 125 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2581983	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER (SUTURA CALIBRE 9-0-11-0 EN MICROCIR). PUNTA CURVA-ULTRADELICADA. MANG REDOND SIN RATCHET. LONG 115-125mm	PORTA AGUJAS DE BARRAQUER PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 9-0 - 11-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA. MANDIBULAS ULTRADELICADAS. MANGO REDONDO SIN RATCHET. LONGITUD TOTAL 115 mm - 125 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582006	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO-FINO (SUT CALIB 9-0-11-0 EN MICROCIR). PUNTA ULTRADELICADA CURVA. MANG PLANO SIN	PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO-FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 9-0 - 11-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA CURVA. MANDIBULAS UL TRADELICADAS. MANGO PLANO-ACANALADO SIN RATCHET. LONGITUD TOTAL 125 mm - 135 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							RATCHET. LONG 125-135mm	
2582008	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO-FINO (SUT CALIB 9-0-11-0 EN MICROCIR). PUNTA ULTRADELICADA RECTA. MANG PLANO SIN RATCHET. LONG 125-135mm	PORTA AGUJAS DE CASTROVIEJO-FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 9-0 - 11-0 EN MICROCIRUGIA. BOCA LISA- PUNTA RECTA. MANDIBULAS ULTRADELICADAS. MANGO PLANO-ACANALADO SIN RATCHET. LONGITUD TOTAL 125 mm - 135 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582010	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582012	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO (SUT CALIB 4-0 - 6-0). BOCA CARBURO TUGSTENO. ANILL DORAD RATCHET 3-5 DIENTES. LONG 270-310mm	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CAR BURO DE TUGSTENO. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 270 mm - 310 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582013	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA FENESTRACION CENTRAL. MANGO RATCHET 3-5 DIENTES. LONG 120-150mm	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANDIBULAS SUAVES. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582014	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FUERTE PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA FENESTRACION CENTRAL. MANG RATCHET 3-5 DIENTS. LONG 140-170mm	PORTA AGUJAS DE CRILE-WOOD MODELO FUERTE PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANDIBULAS FUERTES. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 140 mm - 170 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582016	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO (SUT CALIB 4-0-6-0). BOCA CARBURO TUGSTENO-PUNTA FINA LARGA. RATCHET 3-5 DIENTS. LONG 150-180mm	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA FINA LARGA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180M M. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582017	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO (SUT CALIB 4-0-6-0). BOCA CARBURO TUGSTENO-PUNTA FINA LARGA. RATCHET 3-5 DIENTS. LONG 200-2	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA FINA LARGA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 200 mm - 230M M. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582020	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO (SUT CALIB 4-0-6-0). BOCA CARBURO TUGSTENO-PNTA ULTRAF CORTA. RATCHT 3-5 DIENTS. LONG 165-210mm	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA ULTRAFINA CORTA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 165 mm- 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582021	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO (SUT CALIBR 4-0-6-0). BOCA CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS RATCHET 3-5 DIENTES. LONG 165-210mm	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 165 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582022	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO ULTRADELICADO (SUT CALIB4-0-6-0). BOCA CARB-TUGST-PTA ULTRAFIN LARG. RATCHT 3-5 DNTS. LONG 180-200mm	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO ULTRADELICADO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA ULTRAFINA LARGA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 1 80 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582023	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO ULTRADELICADO (SUT CALIB4-0-6-0). BOCA CARB-TUGST-PTA ULTRAFIN LARG. RATCHT 3-5 DNTS. LONG 210-230mm	PORTA AGUJAS DE D'BAKEY MODELO ULTRADELICADO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 4-0 - 6-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA ULTRAFINA LARGA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL2 10 mm - 230 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582034	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE HEGAR	PORTA AGUJAS DE HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO

							MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAV ROMBOID FENESTRAC CENTRAL. RATCHET 3-5 DNTS. LONG 145-175mm	ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANDIBULAS FUERTES. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 145 mm - 175 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582035	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA-LONG 180-210mm	PORTA AGUJAS DE HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANDIBULAS FUERTES Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582036	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE HEGAR-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO (SUT CALIB 5-0-8-0). CARBUR TUGST- PUNTA ULTRAFINA. ANILL DORADS. LONG 140-185mm	PORTA AGUJAS DE HEGAR-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 5-0 - 8-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA ULTRAFINA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 140 mm - 185 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582037	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE HEGAR-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO (SUT CALIB 5-0-8-0). CARBUR TUGST- PUNTA ULTRAFINA. ANILL DORADS. LONG 200-235mm	PORTA AGUJAS DE HEGAR-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 5-0 - 8-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA ULTRAFINA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 200 mm - 235 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582044	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR (SUTURA CALIBR 0-6-4-0). BOCA PLAQUITAS CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS. LONG 150-1	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 0-6 - 4-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 150 mm - 185 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582045	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR (SUTURA CALIBR 0-6-4-0). BOCA PLAQUITAS CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS. LONG 200-235mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 0-6 - 4-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 200 mm - 235 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582046	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR (SUTURA CALIBRE 0-6-4-0mm. BOCA PLAQUITAS CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS. LONG 240-275 mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 0-6 - 4-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 240 mm - 275 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582047	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR (SUTURA CALIBR 0-6-4-0). BOCA PLAQUITAS CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS. LONG 280-310mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 0-6 - 4-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 280 mm - 310 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582048	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR (SUTURA CALIBR 0-6-4-0). BOCA PLAQUITAS CARBURO TUGSTENO. ANILLOS DORADOS. LONG 165-205 mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 0-6 - 4-0. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL. MANDIBULAS FUERTES. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 165 mm - 205 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERI LIZACION
2582050	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm.	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582051	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm.	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582052	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA FENESTRACION CENTRAL. RATCHET 3-5 DIENTES. LONGIT 280-310mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO ESTANDAR PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 280 mm - 310 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582053	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAV ROMBOID FENESTRAC CENTRAL. RATCHT 3-5 DNTS. LONG 150-185mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 150 mm - 185 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582055	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAV ROMBOID FENESTRAC CENTRAL. RATCHT 3-5 DNTS. LONG 240-270mm	PORTA AGUJAS DE MAYO-HEGAR MODELO FINO PARA MATERIAL DE SUTURA. BOCA GRAVADO ROMBOIDAL CON FENESTRACION CENTRAL. MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582061	42312207	ZMQX	ZMQI-010	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PORTA AGUJAS DE RYDER-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO (SUTURA CALIBRE 5-0-8-0). CARBURO TUGSTENO-PUNTA AFINADA CORTA. LONG 125-155 mm	PORTA AGUJAS DE RYDER-VASCULAR MODELO ULTRADELICADO PARA MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 5-0 - 8-0. BOCA GRAVADO ROMBO-PIRAMIDAL CON PLAQUITAS DE CARBURO DE TUGSTENO- PUNTA AFINADA CORTA. MANDIBULAS SUAVES. MANGO ANILLOS DORADOS CON RATCHET 3 - 5 DIENTES. LONGITUDT OTAL 125 mm - 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

MISCELANEA Y VARIOS

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2582100	42292303	ZMQX	ZMQI-011	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ALICATE-TENAZA PLANO PARA ALAMBRE DENSIDAD MEDIA. PICO PLANO-UNICANALETA. MANDIBUL ACCION PARALELA. MANGO DOBLE RAMA. LONG 170-200mm	ALICATE-TENAZA PLANO PARA ALAMBRE DENSIDAD MEDIA (MULTIPROPOSITO: SUJETAR-REMOVER- TORCER- DOBLAR). PICO ESTRIADO TRANSVERSAL-UNICANALETA CENTRAL- PUNTA PLANA. MANDIBULAS FUERTES DE ACCION PARALELA. MANGO DOBLE RAMA ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582101	42292303	ZMQX	ZMQI-011	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ALICATE-TENAZA COMBINADO PARA ALAMBRE Y CLAVOS DENSIDAD MEDIA (MULTIPROPOSITO: SUJETAR-REMOVER-TORCER-DOBLAR) LONGITUD 190 mm. 220 mm	ALICATE-TENAZA COMBINADO PARA ALAMBRE Y CLAVOS DENSIDAD MEDIA (MULTIPROPOSITO: SUJETAR- REMOVER- TORCER- DOBLAR). PICO ESTRIADO TRA NSVERSAL- PUNTA PLANA. MANDIBULAS FUERTES DE ACCION FIJA Y MOVIL ARTICULADA A BASTIDOR. MANGO DOBLE RAMA: UNA FIJA CON TORNILLO-TUERCA DE AJUSTE TRANSVERSAL HACIA DISTAL PARA APERTURA-FIJACION Y GRADUACION DE CAPACIDAD DE AGARRE DE MANDIBULAS Y OTRA RAMA MOVIL ARTICULADA A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582104	42292303	ZMQX	ZMQI-011	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ALICATE-TENAZA AGUDO BIARTICULADO PARA ALAMBRE DENSIDAD BAJA. PICO AGUDO. MANDIBULAS BIARTICULADAS ACCION PARALELA. LONG 150-180mm	ALICATE-TENAZA AGUDO BIARTICULADO PARA ALAMBRE DENSIDAD BAJA (MULTIPROPOSITO: SUJETAR- REMOVER- TORCER- DOBLAR). PICO ASERRADO- PUN TA AGUDA. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS DE ACCION PARALELA. MANGO DOBLE RAMA ANTIDESLIZANTE-ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582111	42292303	ZMQX	ZMQI-011	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	ALICATE-CORTAFRIO ACCION FRONTAL (ALAMBRE DENSID MEDIA). HOJAS CORTE FRONTAL ALAMBR DURO 2.0-3.0mm-BLANDO HASTA 3.0mm. LONG 190-220mm	ALICATE-CORTAFRIO ACCION FRONTAL PARA ALAMBRE DENSIDAD MEDIA. HOJAS ACCION CORTE FRONTAL PARA ALAMBRES DUROS DE 2.0 mm - 3.0 mm Y BLANDOS HASTA 3.0 mm DIAMETRO. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS DE ACCION PARALELA. MANGO DOBLE RAMA ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO ABASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

PINZAS DISECCION								
CODIGO GENERICO	**CODIGO UNSPSC**	**TIPO DE MATERIAL**	**GRUPO DE ARTICULOS**	**SUB-GRUPO DE ARTICULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RUBRO**	**NOMBRE GENERICO**	**ESPECIFICACION TECNICA**

2505615	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR- 1X2 DIENTES- LONGITUD TOTAL .14-5 cm	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 14-5 cm -5 (6-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION
2505616	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR- 1X2 DIENTES- LONGITUD TOTAL 13 cm-5 (1- 8").	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 13 cm - 5 (1- 8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION
2505617	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. LONGITUD TOTAL 14-5 cm - 5 (6-8")	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 14-5 cm-5 (6-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505619	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIOMEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 18 cm-7 (1-8")	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 18 cm-7 (1-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505621	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 16 cm - 6 (2-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. LONGITUD TOTAL 16cm-6 (2-8")	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505622	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. LONGITUD TOTAL 20cm-7(7-8").	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 20 cm - 7 (7-8"). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505766	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA RELOJERO N° 5 ATAR RECTA LONGITUD 11 cm - ELABORADA EN TITANIO O ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - PLATAFORMA DE ATAR	PINZA RELOJERO N° 5 ATAR RECTA LONGITUD 11 cm - PLATAFORMA DE ATAR- PINZA DE RELOJERO RECTA NUMERO 5. PARA MICROCIRUGIA. LONGITUD 11 cm-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505768	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZAZ BISHOP-HARMO ASERRADA-SINGARRA LONGITUD 8.5 cm PINZAS DE SUTURA - PLATAFORMAS ASERRADAS- PARA SUTURA-RECTA- ESTRIADA O ASERRADA- SIN GARRA DE 0.5 mm	PINZAZ BISHOP-HARMO ASERRADA-SINGARRA LONGITUD 8.5 cm PINZAS DE SUTURA - PLATAFORMAS ASERRADAS- PARA SUTURA-RECTA- ESTRIADA O ASERRADA- SIN GARRA DE 0.5 mm- MANGO CON TRES CIRCULOS FENESTRADOS. LONGITUD 8.5 cm-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO.100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2505769	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA BISHOP-HARMON RECTA-CON GARRA LONGITUD 8.5cm PINZAS DE SUTURA - DIENTES DE 3 mm 1X2- PLATAFORMAS DE ATADO DE 3.0 mm- PARA SUTURA- RECTA	PINZA BISHOP-HARMON RECTA-CON GARRA LONGITUD 8.5cm PINZAS DE SUTURA - DIENTES DE 3 mm 1X2- PLATAFORMAS DE ATADO DE 3.0 mm- PARA SUTURA- RECTA- CON GARRA 1X2 DIENTES DE 0.5 mm- MANGO CON TRES CIRCULOS FENESTRADOS. LONGITUD 8.5 cm. FABRICADO EN ACERO EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO.100% RESISTENTE A CORROSION YA PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582879	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON CON GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA	PINZA DE DISECCION DE ADSON CON GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582880	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON CON GARRA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA ROMA 1X2 DIENTES. ZONA DE SUJECION PLANA- ACANALADA. LONG 160-180mm	PINZA DE DISECCION DE ADSON CON GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 160 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582881	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON EN BAYONETA SIN GARRA NCX. PUNTA FINA-ROMA- ESTRIADA.	PINZA DE DISECCION DE ADSON EN BAYONETA SIN GARRA PARA NEUROCIRUGIA. PUNTA FINA-ROMA- ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIOP LANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 175 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTER ILIZACION

							ZONA DE SUJECION PLANA-ACANALADA. LONG 175-200mm	
2582882	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON MICRO CON GARRA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA FINA 1X2 DNTS. ZONA SUJECION PLANA-ACANALADA. LONG 120-150mm	PINZA DE DISECCION DE ADSON MICRO CON GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582883	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON MICRO SIN GARRA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA FINA ESTRIADA. ZONA SUJECION PLANA-ACANALADA. LONG 120-150mm	PINZA DE DISECCION DE ADSON MICRO SIN GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582884	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON SIN GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA	PINZA DE DISECCION DE ADSON SIN GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA- ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA- EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO - 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582885	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ADSON SIN GARRA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION PLANA-ACANALADA. LONGIT 160-180mm	PINZA DE DISECCION DE ADSON SIN GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA- ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA. LONGITUD TOTAL 160 mm - 180 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582887	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE BISHOP-HARMON MICRO CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA . PUNTA FINA-RECTA-AHUSADA-CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm	PINZA DE DISECCION DE BISHOP-HARMON MICRO CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA-RECTA- AHUSADA- CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm - 1.0 ELABORADA EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582888	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE BISHOP-HARMON MICRO SIN GARRA PARA OFTALMOLOGIA . PUNTA FINA-RECTA- PLANA-AHUSADA CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm	PINZA DE DISECCION DE BISHOP-HARMON MICRO SIN GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA-RECTA- PLANA- AHUSADA CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm EN ACERO QUIRURGICO ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582889	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE BROWN CON GARRA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA ROMA DENTADA. ZONA DE SUJECION	PINZA DE DISECCION DE BROWN CON GARRA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA ROMA DENTADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALAD A. LONGITUD TOTAL 150 mm - 200 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							PLANA-ACANALADA. LONG 150 mm-200 mm	
2582890	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE CASTROVIEJO MICRO CON GARRA (OFT). PUNTA FINA-RECTA- AHUSD CAPACIDAD AGARRE 0.5-1.0mm 1X2 DNTS. LONG 90-100mm	PINZA DE DISECCION DE CASTROVIEJO MICRO CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA-RECTA- AHUSADA CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm - 1.0 mm - 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 90 mm - 100 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO - 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582891	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE CASTROVIEJO MICRO SIN GARRA (OFTALMOLOGIA). PUNTA FINA RECTA-AHUSAD CAPACIDAD AGARRE 0.5-1.0mm. LONG 90-100mm	PINZA DE DISECCION DE CASTROVIEJO MICRO SIN GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA RECTA- AHUSADA CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm - 1.0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 90 mm - 100 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582892	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE COOLEY (TEJIDOS ULTRADELICADOS). PUNTA FINA- GRAVADO EN MALLA-CAPACIDAD DE AGARRE 1.3-1.8mm. LONGIT 150-195mm	PINZA DE DISECCION DE COOLEY PARA TEJIDOS ULTRADELICADOS. PUNTA FINA- ATRAUMATICA-CON CANALETA CENTRAL- GRAVADO EN MALLA-CAPACIDA D DE AGARRE 1.3 mm - 1.8 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 150 mm - 195 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582893	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE COOLEY (TEJIDOS ULTRADELICADOS). PUNTA FINA- GRAVADO	PINZA DE DISECCION DE COOLEY PARA TEJIDOS ULTRADELICADOS. PUNTA FINA- ATRAUMATICA-CON CANALETA CENTRAL- GRAVADO EN MALLA-CAPACIDA D DE AGARRE 2.0 mm - 2.3 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 195 mm - 240 mm. ACERO

							EN MALLA-CAPACIDAD DE AGARRE 2.0-2.3mm. LONGIT 195-240mm	QUIRURGICOD E ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582894	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE COOLEY SIN GARRA (TEJIDOS ULTRADELICAD) . PUNTA FINA-ROMA- GRAVAD ROMBOID. ZONA SUJECION PLANA. LONG 180-210mm	PINZA DE DISECCION DE COOLEY SIN GARRA PARA TEJIDOS ULTRADELICADOS. PUNTA FINA-ROMA- GRAVADO ROMBOIDAL. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582895	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE COTTLE (COLUMELA). BOCA CAPACIDAD AGARRE 10-12mm. TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL ENTRE RAMAS. LONGIT 100-130mm	PINZA DE DISECCION DE COTTLE PARA OTORRINO (COLUMELA). BOCA CUADRANGULAR FENESTRADA- BORDE DISTAL MINIRODILLO ESCALONADO- CAPACIDAD DE AGARRE 10 mm - 12 mm. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 100 mm - 130 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION.
2582896	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE D'BAKEY ANGULADA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA FINA ANG 40°- GRAV MALLA-CAPACID AGARRE 1.6-2.0mm. LONG 150-195mm	PINZA DE DISECCION DE D'BAKEY ANGULADA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA-ANGULADA 40° GRADOS- ATRAUMATICA- CON CANALETA CENTRAL-GRAVADO EN MALLA-CAPACIDAD DE AGARRE 1-6 mm - 2-0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 150 mm -19 5 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582897	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE D'BAKEY ANGULADA (TEJIDOS DELICADOS). PUNTA FINA ANG 40°- GRAV MALLA- CAPACID AGARRE 1.6-2.0mm. LONG 200-245mm	PINZA DE DISECCION DE D'BAKEY ANGULADA PARA TEJIDOS DELICADOS. PUNTA FINA-ANGULADA 40° GRADOS- ATRAUMATICA- CON CANALETA CENTRAL-GRAVADO EN MALLA-CAPACIDAD DE AGARRE 1-6 mm - 2-0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 200 mm -24 5 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582919	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE LUCAE EN BAYONETA CON GARRA (ORL-NCX). PUNTA ROMA- 1X2 DIENTES. ZONA SUJECION PLANA-ACANALDA. LONG 130-155mm	PINZA DE DISECCION DE LUCAE EN BAYONETA CON GARRA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA. PUNTA ROMA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 130 mm - 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582920	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE LUCAE EN BAYONETA SIN GARRA (ORL-NCX). PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION PLANA-ACANALDA. LONG 130-155mm	PINZA DE DISECCION DE LUCAE EN BAYONETA SIN GARRA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA. PUNTA ROMA- ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 130 mm - 155 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582928	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ST. MARTIN MICRO CON GARRA (OFTALM). PUNTA FINA-RECTA-	PINZA DE DISECCION DE ST. MARTIN MICRO CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA-RECTA- AHUSADA CON MESETA- CAPACIDAD DE AGARRE 0.5M M - 1.0 mm- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- LISA. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGR ADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							AHUSAD-CAPAC AGARRE 0.5-1.0mm- 1X2 DNTS. LONG 80-90mm	
2582929	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE ST. MARTIN MICRO SIN GARRA (OFTALMOL). PUNTA FINA-RECTA-AHUSADA-CAPACIDAD DE AGARRE 0.5-1.0mm. LONG 80-90mm	PINZA DE DISECCION DE ST. MARTIN MICRO SIN GARRA PARA OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA-RECTA- AHUSADA CON MESETA- CAPACIDAD DE AGARRE 0.5M M - 1.0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- LISA. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582971	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA (TEJ GRUESOS). PUNTA ROMA-ESTRIADA 1X2 DIENTES. ZONA DE SUJECION PLANA. LONG 300-350mm	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR CON GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 300 mm - 350 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582972	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA. LONGITUD TOTAL 100 mm - 145 mm	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 100 mm - 145 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582973	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA-ACANALADA. LONGITUD TOTAL 150 mm - 195 mm.	PINZA DE DISECCION MODELO ESTANDAR SIN GARRA PARA TEJIDOS GRUESOS. PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 150 mm - 195 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582978	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION RELOJERO DE BONNER MODELL MICRO CON GARRA PARA MICROCIRUGIA Y OFTALMOLOGIA. PUNTA ULTRAFINA RECTA- CON MESETA	PINZA DE DISECCION RELOJERO DE BONNER MODELL MICRO CON GARRA PARA MICROCIRUGIA Y OFTALMOLOGIA. PUNTA ULTRAFINA RECTA- CON MESETA- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582979	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION RELOJERO DE LAZAR MICRO SIN GARRA (OFTALMOLOG). PUNTA FINA RECTA- LISA-AHUSADA- AGARRE 0.5-0.6mm. LONG 145-160mm	PINZA DE DISECCION RELOJERO DE LAZAR MICRO SIN GARRA PARA MICROCIRUGIA Y OFTALMOLOGIA. PUNTA FINA- RECTA- LISA-AHUSADA- CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm - 0.6 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 145 mm - 160 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582988	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION RELOJERO MICRO SIN GARRA (OFTALMOLOGIA). PUNTA ULTRAFINA- RECTA- LISA- CAPACIDAD AGARRE 0.3-0.4mm. LONG 125-135mm	PINZA DE DISECCION RELOJERO MICRO SIN GARRA PARA MICROCIRUGIA Y OFTALMOLOGIA. PUNTA ULTRAFINA- RECTA- LISA- CAPACIDAD DE AGARRE 0.3 mm - 0.4 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- LISA. LONGITUD TOTAL 125 mm - 135 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583159	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE GRUENWALD EN BAYONETA SIN GARRA (MULTIPROPO). PUNTA ROMA-ESTRIAD. ZONA SUJECION PLANA-ACANALDA. LONG 190-220mm	PINZA DE DISECCION DE GRUENWALD EN BAYONETA SIN GARRA (NEUROCIRUGIA-OTORRINO- MAXILOFACIAL). PUNTA ROMA-ESTRIADA. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO PLANA- ACANALADA. LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583229	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE TROUTMAN-BARRAQUER TIPO COLIBRI 0.12 CON GARRA(CORNEA). PUNTA PLATAFORMA-1X2 DIENTS LONG 0.12mm. LONG 70-80mm	PINZA DE DISECCION DE TROUTMAN-BARRAQUER TIPO COLIBRI 0.12 CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA (CORNEA). PUNTA PLATAFORMA FINA- RECTA- 1 X2 DIENTES ANGULADOS 45° - 60° GRADOS HACIA RETROGRADA- LONGITUD 0.12 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO-ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 70 mm - 80 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583230	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE AYER (CHALAZION). BOCAS REDONDAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 8.0-10mm.	PINZA DE FIJACION DE AYER PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS REDONDA-PLANA Y REDONDA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE AGARRE 8.0 mm - 10 mm DE DIAMETRO. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							TORNILLO AJUSTE TRANSVERSAL. LONG 90-110mm	
2583231	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE BAIRD (CHALAZION). BOCAS OVALADAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 12-14mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVERSAL. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE BAIRD PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS OVALADA-PLANA Y OVALADA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE AGARR E 12 mm - 14 mm DE DIAMETRO MAYOR. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DER AMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583232	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES (CHALAZION). BOCAS OVALADAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 20-25mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVER. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS OVALADA-PLANA Y OVALADA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE A GARRE 20 mm - 25 mm DE DIAMETRO MAYOR. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583233	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES (CHALAZION). BOCAS OVALADAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 26-30mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVER. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS OVALADA-PLANA Y OVALADA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE A GARRE 26 mm - 30 mm DE DIAMETRO MAYOR. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583234	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES (CHALAZION). BOCAS OVALADAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 31-36mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVER. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE DESMARRES PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS OVALADA-PLANA Y OVALADA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE A GARRE 31 mm - 36 mm DE DIAMETRO MAYOR. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583235	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE FRANCIS(CHALAZION). BOCAS REDONDAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 15-18mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVERSAL. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE FRANCIS PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS REDONDA-PLANA Y REDONDA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE AGARRE 15 mm - 18 mm DE DIAMETRO. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACION DE RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583237	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FIJACION DE LAMBERT (CHALAZION). BOCAS OVALADAS-PLANA-FENESTRADA-AGARRE 13-16mm. TORNILLO AJUSTE TRANSVERS. LONG 90-110mm	PINZA DE FIJACION DE LAMBERT PARA OCULOPLASTIA (CHALAZION). BOCAS ATRAUMATICAS OVALADA-PLANA Y OVALADA-FENESTRADA- CAPACIDAD DE AGARRE 13 mm - 16 mm DE DIAMETRO MAYOR. ZONA SE SUJECION PLANA ACANALADA CON TORNILLO DE AJUSTE TRANSVERSAL PARA APERTURA Y FIJACIOND E RAMAS. LONGITUD TOTAL 90 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583239	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON ANGULADA CON GARRA (CORNEA). PTA ANG 45°-60°-	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON ANGULADA CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA (CORNEA). PUNTA ANGULADA 45° - 60° GRADOS-PLATAFORMA FINA LONGITUD 5.0 mm - 6.0 mm- 1 X 2 DIENTES LONGITUD 0.40 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 80 mm -9 0 mm. ACERO QUIRURGICO DE

							PLATAFORMA 5-6mm- 1 X 2 DIENTES 0.40 mm. LONG 80-90mm	ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583240	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON RECTA CON GARRA (CORNEA). PTA RECTA 1 X 2 DIENTES LONG 0.40 mm- PLATAFORMA 5.0-6.0mm. LONG 80-90mm	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON RECTA CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA (CORNEA). PUNTA RECTA 1 X 2 DIENTES LONGITUD 0.40 mm- PLATAFORM A FINA LONGITUD 5.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583241	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE KELMAN-MC PHERSON ANGULADA CON GARRA(CORNEA). PTA ANG45-60°- PLTAFORM 7-8mm- 1X2DNTS LONG 0.12mm. LONG 80-90mm	PINZA DE DISECCION DE KELMAN-MC PHERSON ANGULADA CON GARRA PARA OFTALMOLOGIA (CORNEA). PUNTA ULTRAFINA ANGULADA 45° - 60° GRADOS- PLATAFORMA LONGITUD 7.0 mm - 8.0 mm- 1 X 2 DIENTES LONGITUD 0.12 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583242	42291609	ZMQX	ZMQI-012	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON ANGULADA (SUT 8-0 - 12-0). PUNTA ANG 45-60° AGARRE 0.30-0.40mm- PLATAFORMA LONG 5-6mm. LONG 80-90mm	PINZA DE DISECCION DE MC PHERSON ANGULADA PARA OFTALMOLOGIA (MATERIAL DE SUTURA CALIBRE 8-0 - 12-0). PUNTA ANGULADA 45° - 60° GRADOS CAPACIDAD DE AGARRE 0.30 mm - 0.40 mm- PLATAFORMA FINA ATRAUMATICA LONGITUD 5.0 mm - 6.0 mm. ZONA DE SUJECION EN TERCIO MEDIO- ANTIDESLIZANTE. LONGITUD TOTAL 80 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

PINZAS HEMOSTATICAS								
CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2505604	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ADSON (KELLY) CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA DESDE TERCIO DISTAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL PINZA KELLY CURVA-LONG 22 cm-8 (5- 8")	PINZA DE ADSON (KELLY) CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA DESDE TERCIO DISTAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL PINZA KELLY CURVA-LONG 22 cm-8 (5- 8")-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOSDE ESTERILIZACION-
2505606	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA REPOSICION OSEA DE PUNTASAGUDAS-ROMAS- CON CREMALLERA LARGA-LONGITUD 15cm-5 (7-8")- PARA HUESO-	PINZA REPOSICION OSEA DE PUNTASAGUDAS-ROMAS- CON CREMALLERA LARGA-LONGITUD 15cm-5 (7-8")- PARA HUESO-FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO (AQ) DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y PROCESOS DE ESTERILIZACION-
2505607	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA REDUCTORA DE PUNTAS LONGITUD 13-5CM-5(3- 8")-FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO (AQ) DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION	PINZA REDUCTORA DE PUNTASAGUDAS-ROMAS-CON CREMALLERA LARGA-LONGITUD 13-5cm-5(3-8")- PARA HUESO- FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO (AQ) DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y PROCESOS DE ESTERILIZACION-

2505608	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SCHNIDT LIGERAMENTE (SEMI) CURVA-LONGITUD 19cm-7 (4- 8")- PARA AMIGDALAS-	PINZA SCHNIDT LIGERAMENTE (SEMI) CURVA-LONGITUD 19cm-7 (4- 8")- PARA AMIGDALAS-FABRICADO EN ACERO QUIRURGICO (AQ) DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505614	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA PEQUEÑA REPOSICION OSEA PEQEÑA LONGITUD 9 CM-3(4-8")	PINZA DE REPOSICION -REDUCTORA PEQUEÑA AGUDA- PARA CARTILAGO-HUESO- CON CREMALLERA LARGA-LONGITUD 9cm-3(4-8")-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION- USO EN OROTOPEDIA-
2582989	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ADAIR RECTA (AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS)-PTASAGUD CURVAS HACIA MEDIAL-MANDIB FUERTES-RATCHET 4-6 DNTS-LONG 180-210mm	PINZA DE ADAIR RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-PUNTASAGUDAS CURVAS HACIA MEDIAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582990	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA ADSON (KELLY) CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA-LONG 180-200 mm	PINZA DE ADSON (KELLY) CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA DESDE TERCIO DISTAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-EN ACERO QUIRUGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS ESTERILIZACION
2582991	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ADSON (KELLY) CURVA PRONUNCIADA (HEMOSTASIA TEJID DELICAD)-BOCA ESTRIADA TERCIO DISTAL-RATCHET 4-5 DIENTS-LONG 200-2	PINZA DE ADSON (KELLY) CURVATURA PRONUNCIADA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA DESDE TERCIO DISTAL-MANGO CONRATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 220 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2582996	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA ANCHO 8-0-9-0mm- DOBLE HILERA ASERRADA TRANSV-RATCHET 4-6 DNTS-LONG 210-260mm	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA ANCHO 8-0 mm - 9-0 mm- DOBLE HILERA ASERRADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 260 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582997	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ATRAUMATICA ANCHO 8-0-9-0mm- DOBLE HILERA ASERRADA TRANSV-RATCHET 4-6 DNTS-LONG 300-350mm	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA ANCHO 8-0 mm - 9-0 mm- DOBLE HILERA ASERRADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 300 mm - 350 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582998	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS (AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA DENTADA 2X3 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTES-LONG 150 mm-175 mm	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA DENTADA 2 X 3 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 175 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2582999	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS (AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA DENTADA 3X4 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTES-LONG 150 mm-175 mm	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA DENTADA 3 X 4 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 175 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583000	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS (AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS)-BOCA DENTADA 4X5 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTES-LONG 150 mm-17	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA DENTADA 4 X 5 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 175 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583001	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA DENTADA-5X6 DIENTES-LONGITUD 155-200 mm	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA DENTADA 5 X 6 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 155 mm - 200 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583002	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS- BOCA DENTADA 5 X 6 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 7 DIENTES-LONGITUD 210 - 25	PINZA DE ALLIS PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA DENTADA 5 X 6 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 7 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 255 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583003	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ALLIS-ADAIR (AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS)-BOCA DENTADA 9X10 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTS-LONG 155-175mm	PINZA DE ALLIS-ADAIR PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA DENTADA 9 X 10 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 155 mm- 175 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583004	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO RECTA CONGARRA (HEMOST TEJID DELICAD)-	PINZA DE ALLIS-BABY PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA DENTADA 4 X 5 DIENTES-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							BOCA FINA ESTRIADA TRANSVL-PUNTA 1X2 DIENTES-LONG 95-1	
2583008	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA BABCOCK PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA-FENESTRADO TRIANGULAR-BASE DISTAL 10-12mm LONGITUD 150-180mm	PINZA DE BABCOCK PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA- FENESTRADO TRIANGULAR- BASE DISTAL 10 mm A 12 mm-LONGITUD 150-180 mm-RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583009	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BABCOCK (AGARRE Y TRACC TEJIDOS DELIC)- BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA FENESTRADA-BASE DISTAL 10-12mm DENTADA-LONG 190-2	PINZA DE BABCOCK PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA- FENESTRADO TRIANGULAR- BASE DISTAL 10 mm - 12 mm DENTADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTEN TE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583010	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BABCOCK (AGARRE Y TRACC TEJIDOS DELIC)- BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA FENESTRADA-BASE DISTAL 10-12mm DENTADA-LONG 230-260mm	PINZA DE BABCOCK PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ATRAUMATICA EN CUCHARA- FENESTRADO TRIANGULAR- BASE DISTAL 10 mm - 12 mm DENTADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 230 mm - 260 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583011	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA BABCOCK PARA AGARREY TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS BOCA EN CUCHARA-FENESTRADO TRIANGULAR-BASE DISTAL ESTRIADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 - DIENTES-LONGITUD 150-180 mm	PINZA DE BABCOCK PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA EN CUCHARA-FENESTRADO TRIANGULAR- BASE DISTAL ESTRIADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583013	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BACKHAUS ANGULADA (SUJETAR CAMPOS)-BOCA DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS-PUNTAS CONVERGENTES- MANDIBULA CURVA-ANG 45°-LONG 80-105mm	PINZA DE BACKHAUS ANGULADA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS- PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVAS-ANGULAD AS 45° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 4 DIENTES-LONGITUD TOTAL 80 mm - 105 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583014	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA BACKHAUS ANGULADA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS-LONGITUD 110-135 mm	PINZA DE BACKHAUS ANGULADA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS- PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVAS-ANGULADA 45°-LONGITUD 110-135 mm-RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583015	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BACKHAUS-KOCHER ANGULADA (SUJETAR CAMPOS)-BOCA DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS PUNTAS CONVERGENTES- MANDIBULA CURVA-ANGULO 45°-LONGITUD 120-135mm	PINZA DE BACKHAUS-KOCHER ANGULADA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVAS-ANGULADAS 45° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 4 DIENTES-LONGITUD TOTAL 120 mm - 135 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583016	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BERNHARD RECTA (SUJETAR CAMPOS)-BOCA DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS-PUNTAS CONVERGENTES- MANDIBULAS RECTAS-FUERTES-LONGITUD 155-170mm	PINZA DE BERNHARD RECTA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS RECTAS- FUERTES- MANGO CON RATCHET 3 - 4 DIENTES-LONGITUD TOTAL 155 mm - 170 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583017	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BOZEMANN EN "S" PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS EN CUELLO UTERINO-BOCA FENESTRADA TERCIO DISTAL-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 250 mm-270 mm	PINZA DE BOZEMANN EN "S" PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS EN CUELLO UTERINO-BOCA FENESTRADA TERCIO DISTAL-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 250 mm - 270 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583018	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BRAUN RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS CUELLO UTERINO)-PUNTAS AGUDAS EN ANGULO RECTO HACIA MEDIAL-RATCHET 4-6 DNTS-LONG 250-265mm	PINZA DE BRAUN RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS EN CUELLO UTERINO-PUNTAS AGUDAS EN ANGULO RECTO HACIA MEDIAL-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 250 mm - 265 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583019	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE BRAUN RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS GRUESOS)-BOCA TENEDOR ANCHO 10-12mm-4X4 DIENTESAGUD OSANGULO RECTO-LONG 150-180mm	PINZA DE BRAUN RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA EN TENEDOR ANCHO 10 mm - 12 mm- 4 X 4 DIENTES-PUNTAS AGUDAS EN ANGULO RECTO HACIA MEDIAL-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583030	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DUVAL (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS DELICADOS)-BOCA TRIANGULAR-FENESTRADA-BASE DISTAL DENT 15-20mm-RATCHT 4-6 DNTS-LONG 200-230mm	PINZA DE DUVAL PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA TRIANGULAR-FENESTRADA- BASE DISTAL DENTADA 15 mm - 20 mm-MANGO C ON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583031	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE DUVAL-COLLIN (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA TRIANGULAR-FENESTRAD-	PINZA DE DUVAL-COLLIN PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA TRIANGULAR-FENESTRADA- BASE DISTAL 20 mm - 25 mm DENTADA- M ANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 195 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							BASE DISTAL 20-25mm DENTAD-RATCHET 4-6 DIENTS-LONG 195-230mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PR OCESOS DE ESTERILIZACION
2583032	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FOERSTER CURVA (AGARRE Y TRACCION TEJIDO REGULAR)-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-RATCHET 4-5 DNTS-LONG 170-200 mm	PINZA DE FOERSTER CURVA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDO REGULAR-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583033	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FOERSTER CURVA (AGARRE Y TRACCION TEJIDO REGULAR)-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-RATCHET 4-5 DNTS-LONGITUD 210-250mm	PINZA DE FOERSTER CURVA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDO REGULAR-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583034	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FOERSTER CURVA PARA ESPONJAS Y VENDAJES-BOCA LISA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTS-LONG 210-250mm	PINZA DE FOERSTER CURVA PARA ESPONJAS Y VENDAJES-BOCA LISA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD T OTAL 210 mm - 250 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583035	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FOERSTER RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDO REGULAR)-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 170-200 mm	PINZA DE FOERSTER RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDO REGULAR-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 170 mm - 200 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583036	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE FOERSTER RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDO REGULAR-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 250 mm	PINZA DE FOERSTER RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDO REGULAR-BOCA ESTRIADA CON FENESTRACION OVALADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583037	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA-PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 170 mm	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA- PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 170 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583038	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA- PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS- MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES- LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA- PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS- MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES- LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583039	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA- PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS- MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES- LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm	PINZA DE GEMINI (CISTICO) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA- PUNTA ANGULADA 80° - 90° GRADOS- MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES- LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583055	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE HEANEY MODIF- CURVA CONGARRA DOBLE- BOCA ESTRIADA- GARRA- CANALETA TRANSVERSAL TERCIO MEDIO Y TERCIO DISTAL-LONG 225-250mm	PINZA DE HEANEY MODIFICADA- CURVA CONGARRA DOBLE PARA HEMOSTASIA- AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- GARRA-CANALETA TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO Y TERCIO DISTAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES- LONGITUD TOTAL 225 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583056	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE HEANEY MODIF-CURVA CONGARRA DOBLE- BOCA ESTRIADA-GARRA-CANALETA TRANSVERSAL TERCIO MEDIO Y TERCIO DISTAL-LONG 320-350mm	PINZA DE HEANEY MODIF- CURVA CONGARRA DOBLE PARA HEMOSTASIA-AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- GARRA-CANALETA TRANSVERSAL EN TERCIO MEDIO Y TERCIO DISTAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 320 mm - 350 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583057	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE HEANEY-REZEK RECTA CON GARRA (AGARRE Y TRACCION TEJIDO GRUESOS)-BOCA ESTRIAD-GARRA-CANALETA TRANSVERSAL TERCIO DISTAL-LONGITUD 190-220mm	PINZA DE HEANEY-REZEK RECTA CONGARRA PARA HEMOSTASIA- AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- GARRA-CANALETA TRANSVERSAL EN TERCIO DISTAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 190 mm - 220 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583058	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE JACOBS RECTA (TEJIDOS GRUESOS CUELLO UTERINO)-BOCA DENTADA 2X2 DIENTES AGUDOS-ANGULO RECTO HACIA MEDIAL-LONGITUD 200mm-220mm	PINZA DE JACOBS RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS GRUESOS EN CUELLO UTERINO-BOCA DENTADA 2 X 2 DIENTES AGUDOS-ANGULO RECTO HACIA MEDIAL-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 220 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO - 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583059	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE JONES CURVA (SUJETAR CAMPOS)-BOCA DOS DIENTS CURVOS-	PINZA DE JONES CURVA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS- AGUDOS PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVAS ANGULADAS 45° GRADOS-MANGO PLANO-ACANALADO SIN RATCHET-LONGITUD TOTAL 80 mm - 100 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO

							AGUDOS PUNTAS CONVERGENTE - MANDIBULAS CURVAS ANGULADAS 45°- SIN RATCHT- LONGITUD 80-100mm	GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583060	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA (HEMOSTASIA DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FENESTRADA-PUNTA FINA CURVA-ANGULADA-LONGITUD 185-235mm	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA PARA HEMOSTASIA DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FENESTRADA- PUNTA FINA CURVA-ANGULADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 185 mm - 235 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583061	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDO DELICADOS)-BOCA FENESTRADA-PUNTA FINA CURVA-LEVE-LONGITUD 195-245mm	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA PARA HEMOSTASIA DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FENESTRADA- PUNTA FINA CURVA-LEVE-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 195 mm - 245 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583062	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA (HEMOST DISEC Y LIGADUR TEJID DELICAD)-BOCA FENESTR-	PINZA DE KELLY (KELLY ADSON) CURVA PARA HEMOSTASIA DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FENESTRADA- PUNTA FINA CURVA-PRONUNCIADA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 190 mm - 240 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							PUNTA FINA CURV-PRONUNCIADA-LONG 190-240mm	
2583063	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS-BOCA FENESTRADA DESDE TERCIO MEDIO-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 130mm-150mm	PINZA DE KELLY CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS-BOCA FENESTRADA DESDE TERCIO MEDIO-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583066	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY RECTA (HEMOSTASIA TEJIDOS)- BOCA FENESTRADA DESDE TERCIO MEDIO- MANGO RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 130mm-150 mm-TITANIO	PINZA DE KELLY RECTA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS-BOCA FENESTRADA DESDE TERCIO MEDIO-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm- TITANIO
2583067	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY CURVA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS- BOCA OVALADA-FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 4-6 DIENTES-LONG 300 mm - 320 mm	PINZA DE KELLY CURVA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA OVALADA-FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 4 - 6 DIENTES-LONGITUD TOTAL3 00 mm - 320 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583068	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KELLY CURVA PARA VENDAJES Y ESPONJAS-BOCA OVALADA-FENESTRADA-MANGO SIN RATCHET-	PINZA DE KELLY CURVA PARA VENDAJES Y ESPONJAS-BOCA OVALADA-FENESTRADA-MANGO SIN RATCHET-LONGITUD TOTAL 300 mm - 320 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONGITUD TOTAL 300-320mm	
2583069	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDO GRUESOS)-BOCA ESTRIADA- 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-RATCHET 4-5 DIENTES-LONGITUD 130-150mm	PINZA DE KOCHER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES- MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583070	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER RECTA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-RATCHET 4-5 DIENTS-LONG 130-150mm	PINZA DE KOCHER RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES- MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 130 mm - 150 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583071	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 160mm-190mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583072	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONGITUD 200mm-230mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583073	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 240mm-270mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583074	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 280mm-310mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 280 mm - 310 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583075	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 320mm-350mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 320 mm - 350 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583076	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 160mm-190mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583077	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 200mm-230mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583078	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 240 mm - 270 mm-ACERO QUIRURGICO DE

							TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 240mm-270mm	ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583079	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 280mm-310mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CONGARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 280 mm - 310 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583080	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE KOCHER-OCHSNER CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA 1X2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-LONG 320mm-350mm	PINZA DE KOCHER-OCHSNER RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA- 1 X 2 DIENTES-MANDIBULAS FUERTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 320 mm - 350 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583081	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE LAHEY (SWEET) CURVA-ANGULADA (HEMOST-DISEC Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA-PUNTA ANG 70°-	PINZA DE LAHEY (SWEET) CURVA-ANGULADA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA-LONGITUDINAL- PUNTA ANGULADA 70° - 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 190 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							90°-LONG 190-230mm	
2583082	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE LAHEY ANGULADA (HEMOST-DISECC Y LIGADURA TEJID DELICAD)-BOCA ESTRIADA-PUNTA ANG 45°-RATCHET 3-5 DIENTES-LONG 200-230mm	PINZA DE LAHEY ANGULADA PARA HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA-LONGITUDINAL- PUNTA ANGULADA 45°G RADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583083	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE LAHEY RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS)- BOCA TENEDOR ANCHO 8-0mm-10mm- 2X2 DIENTSAGUDOS- PUNTASANG 90°-LONG 150mm-180mm	PINZA DE LAHEY RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA EN TENEDOR ANCHO 8-0 mm - 10 mm- 2 X 2 DIENTES AGUDOS-PUNTASANGULADA S 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE ACORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583084	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE LAHEY RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS)- BOCA TENEDOR ANCHO 8-0mm-10mm- 3X3 DIENTES AGUDOS-PUNTAS ANGULADAS 90°-LONGITUD 150mm-180mm	PINZA DE LAHEY RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA EN TENEDOR ANCHO 8-0 mm - 10 mm- 3 X 3 DIENTES AGUDOS-PUNTAS ANGULADA S 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583085	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE LAHEY RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS)- BOCA TENEDOR	PINZA DE LAHEY RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA EN TENEDOR ANCHO 8-0 mm - 10 mm- 3 X 3 DIENTES AGUDOS-PUNTAS ANGULADAS 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 185 mm - 210 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-

							ANCHO 8-0mm-10mm- 3X3 DIENTES AGUDOS-PUNTAS ANGULADAS 90°-LONG 185mm-210mm	100% RESISTENTE ACORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583086	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MICHEL CON GARRA PARA APLICACION Y RETIRO DE GANCHOS DE AGRAFES-BOCA DENTADA MANGO LISO-LONGITUD 120-130 mm	PINZA DE MICHEL CON GARRA PARA APLICACION Y RETIRO DE GANCHOS DE AGRAFES-BOCA DENTADA MANGO LISO-LONGITUD TOTAL 120 mm - 130 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583087	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MICHEL MODIFICADA-(APLIC Y RETIRO AGRAFES)-BOCA HOJAS ASERRADAS-ACANALADA PARA RETIRO-MANGO DENTADO DISTAL PARA APLICACION-LONGITUD 125-135mm	PINZA DE MICHEL MODIFICADA- PARA APLICACION Y RETIRO DE GANCHOS DE AGRAFES-BOCA CON HOJAS ASERRADAS-ACANALADA PARA RETIRO-MANGO ARTICULADO HACIA MEDIAL Y DENTADO EN PUNTAS DISTALES PARA APLICACION-LONGITUD TOTAL 125 mm - 135 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583088	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MIXTER ANGULADA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS)- BOCA ESTRIADA-TRANSVERSAL-PUNTA ANG 75°-90°-LONGITUD 150-180mm	PINZA DE MIXTER ANGULADA PARA HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA-TRANSVERSAL- PUNTA ANGULADA 75° - 90° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583089	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MIXTER ANGULADA (HEMOST-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA-LONGITUDINAL-PUNTA ANGULADA 90°-LONGITUD 270-300mm	PINZA DE MIXTER ANGULADA PARA HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA-LONGITUDINAL- PUNTA ANGULADA 90 ° GRADOS-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 270 mm - 300 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583090	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MIXTER CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGAD TEJID)-BOCA ESTRIADA-TRANSVERSAL-PUNTA FINA CURVA-RATCHET 3-5 DIENTES-LONGITUD 200-230mm	PINZA DE MIXTER CURVA PARA HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS-BOCA ESTRIADA-TRANSVERSAL- PUNTA FINA CURVA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 230 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583095	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO CURVA CON GARRA (HEMOST TEJID DELICAD)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSALL - PUNTA 1X2 DIENTES-LONG 95-125mm	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA 1 X 2 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 125 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583096	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO CURVA PARA HEMOSTASIA-	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 125 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 125 mm-	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583098	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO RECTA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONG 95-125mm	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED MICRO RECTA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 125 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583099	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN RECTA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONGITUD 180-2	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA CONGARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERS TITANIO
2583100	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA (HEMOST-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADO)-	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGOC ON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 110 mm - 140 mm-TITANIO

							BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONGITUD 110-140mm- TITANIO	
2583101	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA CON GARRA (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-PUNTA 1X2 DIENTES-LONG 110-140mm-TITANIO	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA 1 X 2 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 110 mm - 140 mm-TITANIO
2583102	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONGITUD 110-140mm- TITANIO	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGOC ON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 110 mm - 140 mm-TITANIO
2583106	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONGITUD 120 mm-150mm	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED RECTA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DEE STERILIZACION

2583107	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA CON GARRA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDO DELICADO)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-1X2 DIENTES-LONG 180-210mm	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA 1 X 2 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583108	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONGITUD 180 mm-210mm	PINZA DE MOSQUITO-HALSTED CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583111	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE WHITE (AGARRE Y TRACCION TEJID BOCA-AMIGDALAS)-BOCA CURVA-BORDE DISTAL DENTADO-MANGO RATCHET 3-5 DIENTES-LONGITUD 180-2	PINZA DE MOSQUITO-HARTMANN BABY CURVA CON GARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA 1 X 2 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 105 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583112	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HARTMANN BABY CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y	PINZA DE MOSQUITO-HARTMANN BABY CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 105 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-LONGITUD 95-105mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583113	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MOSQUITO-HARTMANN BABY RECTA CON GARRA (TEJIDOS DELICADOS)-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL-PUNTA 1X2 DIENTS-LONGITUD 95-105mm	PINZA DE MOSQUITO-HARTMANN BABY RECTA CON GARRA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA FINA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA 1 X 2 DIENTES-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 95 mm - 105 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100 % RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583116	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-PUNTA FINA-LONG 210-235mm	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA FINA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 210 mm - 235 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583117	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICOS)-BOCA ESTRIADA	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA FINA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 240 mm - 265 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							TRANSVERSAL-PUNTA FINA-LONG 240-265mm	
2583118	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA (HEMOSTASIA-DISECCION Y LIGADURA TEJIDOS DELICADOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-PUNTA FINA-LONG 270-295mm	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA FINA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 270 mm - 295 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583119	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA (HEMOST-DISECC Y LIGADURA TEJID DELIC)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-PUNTA FINA-LONGITUD 300-325mm	PINZA DE OVERHOLT (KELLY LARGA) CURVA PARA HEMOSTASIA- DISECCION Y LIGADURA DE TEJIDOS DELICADOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL- PUNTA FINA-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 300 mm - 325 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583129	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE PENNINGTON RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS)- BOCA TRIANGULAR FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTES-LONGITUD 150-190mm	PINZA DE PENNINGTON RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA TRIANGULAR-FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 190 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583130	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE PENNINGTON RECTA (AGARRE Y TRACCION TEJIDOS)- BOCA TRIANGULAR FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 3-5 DIENTES-LONGITUD 200-235mm	PINZA DE PENNINGTON RECTA PARA AGARRE Y TRACCION DE TEJIDOS-BOCA TRIANGULAR-FENESTRADA-MANGO CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 200 mm - 235 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583141	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD 140-170 mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD 140-170 mm-EN ACERO QUIRUGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A LA CORROSION Y A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583142	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	INZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD 180-210 mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD 180-210 mm-EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583143	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583144	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 260-300mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 260 mm - 300 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583145	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 310-350mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN CURVA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 310 mm - 350 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583148	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN RECTA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-	PINZA DE ROCHESTER-PEAN RECTA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 220-250mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583149	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROCHESTER-PEAN RECTA (HEMOSTASIA TEJIDOS GRUESOS)-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4-5 DIENTES-LONG 260-300mm	PINZA DE ROCHESTER-PEAN RECTA PARA HEMOSTASIA DE TEJIDOS GRUESOS-BOCA ESTRIADA TRANSVERSAL-MANGO CON RATCHET 4 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 260 mm - 300 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583151	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE ROEDER ANGULADA (SUJETAR CAMPOS)-DIENTESAGUD-MANDIBULAS CURVAS-ANGULADAS 45°-TOPE ESFERICO EN TERCIO MEDIO-MANGO RATCHT-LONG 125-140mm	PINZA DE ROEDER ANGULADA PARA SUJETAR CAMPOS-BOCA CON DOS DIENTES CURVOS-AGUDOS PUNTAS CONVERGENTES-MANDIBULAS CURVASANGULADAS 45° GRADOS- CON TOPE ESFERICO EN TERCIO MEDIO-MANGO CON RATCHET 3 - 4 DIENTES-LONGITUD TOTAL 125 mm - 140 mm- ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583247	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE D'LEE RECTA (UROLOGIA-VASECTOMIA)-BOCA ATRAUMAT ANILLO EN LA PUNTA PARA CORDON ESPERMATICO-ANILLOS DORADOS-	PINZA DE D'LEE RECTA PARA UROLOGIA (VASECTOMIA- CONDUCTO DEFERENTE)-BOCA ATRAUMATICA- EXCAVACION CONCAVA BILATERAL EN MEDIO CIRCULO QUE AL CIERRE FORMA UN ANILLO EN LA PUNTA PARA TOMA DE CORDON ESPERMATICO-MANDIBULAS SUAVES-ATRAUMATICAS-MANGO ANILLOS DORADOS- CON RATCHET 3 - 5 DIENTES-LONGITUD TOTAL 150 mm - 180 mm-ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							LONG 150-180mm	
2587041	42291609	ZMQX	ZMQI-013	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA DE MAGUILL ANGULADA 45° INTUBACION ANESTESIA ADULTOS-BOCA REDONDA-ESTRIADA-FENESTRADA-MANDIBULAS ANGULADAS 45° LAT-LONG 230-260mm	PINZA DE MAGUILL ANGULADA 45° HACIA LATERAL PARA INTUBACION ANESTESIA EN ADULTOS-BOCA REDONDA- ESTRIADA- FENESTRADA-MANDIBULASA- EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

PINZAS SACABOCADOS BIOPSIAS

CODIGO GENERICO	CODIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE GENERICO	ESPECIFICACION TECNICA
2502478	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADOS DERECHA Ø3.4mm L130mm PINZA SACABOCADOS 90° DERECHA	PINZA SACABOCADOS DERECHA Ø3.4mm L130mm PINZA SACABOCADOS 90° DERECHA. PINZA SACABOCADOS DIAMETRO Ø 3.4mm-LONGITUD130mm CON BOCA ANGULADA Y MANGO EN FORMA DE TIJERA. PARA CORTE FRONTAL Y LATERAL DERECHA 90°-AUTOCLAVABLE. REUSABLE CORTE COMPLETO A LA DERECHA. LAS MANDIBULAS DEL INSTRUMENTO 3mm MANGO MACIZO ERGONOMICO USO ORTOPEDIA PARA ARTROSCOPIA CX ENDOSCOPICA DE HOMBRO Y RODILLA
2502480	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADOS IZQUIERDAØ3.4mm L130mm PINZA SACABOCADOS DIAMETRO Ø 3.4mm-LONGITUD 130mm	PINZA SACABOCADOS IZQUIERDAØ3.4mm L130mm PINZA SACABOCADOS DIAMETRO Ø 3.4mm-LONGITUD 130mm CON BOCA ANGULADA Y MANGO EN FORMA DE TIJERA. PARA CORTE FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA 90°- AUTOCLAVABLE
2505542	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADOS ELEMENTO MOVILØ3.4mmL 130mm PINZA	PINZA SACABOCADOS ELEMENTO MOVILØ3.4mmL130mm PINZA SACABOCADOS DIAMETRO Ø 3.4mm- LONGITUD UTIL 130mm- CON ELEMENTO MOVIL DENTADO- MANDIBULAS

							SACABOCADOS DIAMETRO Ø 3.4mm- LONGITUD UTIL 130mm	RECTAS. MANGO EN FORMA DE TIJERA. AUTOCLAVABLE
2505543	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-MANGO TIJERA RECTA ØV3.4mm L130mm PINZA TIJERA RECTA CON BOCA TIPO GANCHO- DIAMETRO (Ø) DEL VASTAGO 3.4mm- LONGITUD UTIL 130mm	PINZA-MANGO TIJERA RECTA ØV3.4mm L130mm PINZA TIJERA RECTA CON BOCA TIPO GANCHO- DIAMETRO (Ø) DEL VASTAGO 3.4mm- LONGITUD UTIL 130mm. MANGO EN FORMA DE TIJERA. PARA APLICACION UNIVERSAL EN TEJIDOS Y ESTRUCTURAS BLANDAS O DURAS. AUTOCLAVABLE
2505544	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADOS BOCA PLANA ALTURA1.6 mm PINZA SACABOCADOS BOCA PLANA, RECTA, ALTURA DE LA BOCA 1.6mm	PINZA SACABOCADOS BOCA PLANA ALTURA1.6 mm PINZA SACABOCADOS BOCA PLANA, RECTA, ALTURA DE LA BOCA 1,6mm. AUTOCLAVABLE
2505545	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADOS ESTANDAR- VASTAGO CURVO 2.1mm PINZA SACABOCADOS - ESTANDAR- VASTAGO CURVADO HACIA ARRIBA- ALTURA DE LA BOCA 2.1 mm-	PINZA SACABOCADOS ESTANDAR-VASTAGO CURVO 2.1mm PINZA SACABOCADOS- ESTANDAR-VASTAGO CURVADO HACIA ARRIBA- ALTURA DE LA BOCA 2.1 mm- CURVADA 15°. AUTOCLAVABLE
2505546	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO CON GANCHO EN FORMA DE PALA DIAMETRO 3.4mm-	PINZA SACABOCADO GANCHO PALAØ3.4mmL130mm PINZA SACABOCADOS CON GANCHO EN FORMA DE PALA- DIAMETRO (Ø) 3.4mm- VASTAGO CURVADO 15° GRADOS HACIA ARRIBA- LONGITUD UTIL 130mm. MANGO EN FORMA DE TIJERA. AUTOCLAVABLE

							LONGITUD 130mm	
2505609	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA GUBIA OSEA DE BOHLER BOCA RECTA CORTANTE LARGO 15cm-5(7-8") MANDIBULAS FUERTES ARTICULADA	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE BOHLER RECTA BOCA RECTA- CORTANTE- LARGO 15cm-5(7-8"). MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADOA BASTIDOR CENTRAL. PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA-PEQUEÑOSFRAGMENTOS). ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505610	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA GUBIA OSEA HARTMANN BOCA CURVA-CORTANTE-LONGITUD 17.5cm-6(7-8"	PINZA GUBIA OSEA DE HARTMANN- BOCA CURVA-CORTANTE- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 3.0mm - 5.0mm X LARGO17-5cm-6(7- 8"). MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. SE UTILIZA EN NICROCIRUGIA ORAL-PARA TEJIDOS DUROS. EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505611	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA GUBIA OSEA LUER-BOCA CURVA-CORTANTE-LONGITUG 14-5CM-5 (6-8")	PINZA GUBIA OSEA DE LUER- BOCA CURVA-CORTANTE- LARGO 14-5cm-5(6-8"). MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. SE UTILIZA PARA CORTAR FRAGMENTOS O CRESTAS- PARA TEJIDOS DUROS. EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2505613	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA GUBIA OSEA DE STILLE-BOCA CURVA-CORTANTE-LONGITUD 22-5CM-8(7-8")	PINZA GUBIA OSEA DE STILLE- BOCA CURVA-CORTANTE- LONGITUD 22-5cm-8 (7-8"). MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. SE UTILIZA PARA OSTEOPLASTIAS Y RESECAR FRAGMENTOS OSEOS IRREGULARES. PARA TEJIDOS DUROS. EN ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2580808	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-PUNCH OSEO DE BEYER (CIZALLA) ANGULADA DENSIDAD BAJA. HOJA PUNCH 90°-MORDIDA 1-3mm. VAST 90° PROF 80-100mm. LONG	PINZA SACABOCADO-PUNCH OSEO DE BEYER (CIZALLA) ANGULADA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORL). HOJA PUNCH-CORTANTE- ANGULADA 90° GRADOS- C APACIDAD DE MORDIDA 1.0 mm - 3.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 80 mm - 100 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL- TOPE DE SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 180 mm - 200 mm X 110 mm - 130 mm. ACERO QUIRU R GICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

							180-200X110-130mm	
2580812	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-PUNCH OSEO DE CITELLI (CIZALLA) ANGULADA DENSIDAD BAJA (ORL). HOJA PUNCH 90° MORD 2-4mm. PROF 80-100mm. LONG 120-140X130-150mm	PINZA SACABOCADO-PUNCH OSEO DE CITELLI (CIZALLA) ANGULADA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORL). HOJA PUNCH-CORTANTE- ANGULADA 90° GRADOS- CAPACIDAD DE MORDIDA 2.0 mm - 4.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 80 mm - 100 mm. MANGO DOBLE RAMA ACANAL ADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 120 mm - 140 mm X 130 mm - 150 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583328	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA SCHUBERT ANGULADA 30-45°-240-270 mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE SCHUBERT ANGULADA (CUELLO UTERINO). BOCA MORD ANCHO 4-6mmXLARGO 6-8mm. MANDIB ANG 30-45°. LONGITUD 240-270mm
2583329	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA SCHUBERT RECTA LONGITUD 200-230 mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE SCHUBERT RECTA (CUELLO UTERINO). BOCA MULTIDENTADA-MORDIDA ANCHO 4-6mm X LARGO 6-8mm. LONGITUD 200-230M
2583330	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINA SACABODADO-BIOPSIA DE SCHUBERT RECTA-LONGITUD 250-280MM	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE SCHUBERT RECTA PARA GINECOLOGIA (CUELLO UTERINO). BOCA OVALADA- MULTIDENTADA- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm X LARGO 6.0 mm - 8.0 mm. MANDIBULAS DE AGARRE FUERTE. MANGO SIN RATCHET. LONGITUD TOTAL 250 mm - 280 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583331	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE TISCHLER RECTA. BOCA RECTA-MORDIDA ANCHO 3-5mm X LARGO 5-8mm. PROF 190-	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE TISCHLER RECTA PARA GINECOLOGIA (UTERO-POLIPOS). BOCA RECTA- BORDES ROMOS- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 3 .0 mm - 5.0 mm X LARGO 5.0 mm - 8.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 190 mm - 220 mm. MANGO DOBLE RAMA ANILLADO Y CON TOPE DE SUJECION-ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 210 mm - 250 mm X 100 mm - 130 mm. ACERO

							220mm. LONG 210-250mmX100-130mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583332	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE BEYER CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA. BOCA MORDIDA ANCHA 3-5mm X LARGO 15-20mm. MANDIBULA ARTICULADA-LONGITUD 160-190mm	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE BEYER CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA CURVA- OVALADA- CORTANTE- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 3.0 mm - 5.0 mm X LARGO 15 mm - 20 mm. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO-ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583333	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE BEYER CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA. BOCA MORDIDA ANCHA 3-5mm X LARGO 15-25mm. MANDIBULA BIARTICULAR. LONGITUD 160-1190 mm	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE BEYER CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (OTORRINO-MAXILO- ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA CURVA-O VALADA- CORTANTE- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 3.0 mm - 5.0 mm X LARGO 15 mm - 25 mm. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS. MANGO DOBLER AMA ACANALADO- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE ACOR ROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583336	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE JANSEN CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA. BOCA MORDIDA ANCHA 4-6mmXLARG 15-20mm MANDIB ARTIC. LONG 160-190 mm	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE JANSEN CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA CURVA- OVALADA- CORTANTE - CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm X LARGO 15 mm - 20 mm. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2583337	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PZ/GUBIA JANSEN CURVA EN S/LONG180-210MM	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE JANSEN CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA CURVA- OVALADA- CORTANTE - CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 3.0 mm - 5.0 mm X LARGO 10 mm - 15 mm. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS-LEVE CURVATURA EN "S". MANGOD OBLE RAMA ACANALADO ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 180 mm - 210 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO-100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583338	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE JANSEN RECTA PARA HUESO DENSIDAD BAJA. BOCA MORD ANCH 4-6mmXLARG 15-20mm MANDIB ARTIC. LONG 160-190mm	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE JANSEN RECTA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA RECTA- OVALADA- CORTANTE - CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 4.0 mm - 6.0 mm X LARGO 15 mm - 20 mm. MANDIBULAS FUERTES ARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL. LONGITUD TOTAL 160 mm - 190 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A COR R OSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583339	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE ECHLIN CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA. PICO DE PATO MORD ANCHO 2-4mmXLARGO 10-20mm. LONG 220-250mm	PINZA SACABOCADO-GUBIA OSEA DE ECHLIN CURVA PARA HUESO DENSIDAD BAJA (OTORRINO-MAXILO- ORTOPEDIA-PEQUEÑOS FRAGMENTOS). BOCA EN "PI CO DE PATO" CURVA- OVALADA-CORTANTE- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 2.0 mm - 4.0 mm X LARGO 10 mm - 20 mm. MANDIBULAS FUERTES BIARTICULADAS. MANGO DOBLE RAMA ACANALADO ANTIDESLIZANTE- ARTICULADO A BASTIDOR CENTRAL- TOPE DE SUJECION EN TERCIO MEDIO. LONGITUD TOTAL 220 mm - 250 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583340	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE TAKAHASHI ANGULADA(ETMOIDES). BOCA ANG 130-150°ARRIB-MORD ANCH2-4mmXLARG10-15mm. LONG	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE TAKAHASHI (ALLIGATOR) ANGULADA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (ETMOIDES- SENO MAXILAR). BOCA ANGULADA 130 ° - 150° GRADOS HACIA ARRIBA- OVALADA- CORTANTE- CAPACIDAD DE MORDIDA ANCHO 2.0 mm - 4.0 mm X LARGO 10 mm - 15 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 100 mm - 130 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 80 mm - 110 mm. ACERO

							130-160X80-110mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZ
2583365	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COCODRILO). BOCA RECTA 1.5-2.0mmX5-10mm. VAST ANG 90° LATL-PROF 70-100mm. LONG 90-120mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COCODRILO) RECTA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA RECTA- OV ALADA- ESTRIADA TRANSVERSAL- FENESTRACION CENTRAL-CAPACIDAD DE AGARRE 1.5 mm - 2.0 mm X 5.0 mm - 10 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 100 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 90 mm - 120 mm X 70 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583366	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COCODRILO) ANGULADA. BOCA 0.5-1.0mmX3-5mm. VAST ANG 30°-60°- PROF 70-90mm. LONG 80-110mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COCODRILO) ANGULADA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA DELICA DA- RECTA- OVALADA-ESTRIADA TRANSVERSAL- FENESTRACION CENTRAL- CAPACIDAD DE AGARRE 0.5 mm - 1.0 mm X 3.0 mm - 5.0 mm. VASTAGO ANGULADO 30° - 60° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO-ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 90 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR LONGITUD TOTAL 80 mm - 110 mm X 70 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DEES
2583367	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COCODRILO) ANGULADA. BOCA 1.5-2.0mmX5-10mm. VAST ANG 30-90° PROF 70-100mm. LONG 90-120mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COCODRILO) ANGULADA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA- RECT A- OVALADA- ESTRIADA TRANSVERSAL- FENESTRACION CENTRAL-CAPACIDAD DE AGARRE 1.5 mm - 2.0 mm X 5.0 mm - 10 mm. VASTAGO ANGULADO 30° - 60° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 100 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONG I TUD TOTAL 90 mm - 120 mm X 70 mm - 90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZA

2583368	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COPA). BOCA RECTA EN CUCHARILLA DIAM 1.0-2.0mm. VAST ANG 90° PROF 70-90mm. LONG 80-110mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COPA) RECTA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA DELICADA- RECT A EN CUCHARILLA REDONDA- CAPACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 1.0 mm - 2.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 90 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 80 mm - 110 mm X 70 mm - 90 mm.AC E RO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583369	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COPA). BOCA RECTA EN CUCHARILL DIAM 2.5-3.5mm. VAST ANG 90° PROF 70-100mm. LONG 90-120mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COPA) RECTA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA RECTA EN CUCHA RILLA REDONDA- CAPACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 2.5 mm - 3.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 100 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 90 mm - 120 mm X 70 mm - 90 mm. ACERO QUIRU R GICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583370	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COPA). BOCA CUCHARILLA DIAM 1.0-2.0mm. VASTAGO ANG 30°-60°- PROF 70-90mm. LONG 80-110mmX70-90mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COPA) ANGULADA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA DELICADA- R ECTA EN CUCHARILLA REDONDA- CAPACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 1.0 mm - 2.0 mm. VASTAGO ANGULADO 30° - 60° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 90 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 80 mm - 110 mm X 70 mm -90 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583371	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN(COPA). BOCA CUCHARILLA DIAM 2.5-3.5mm. VASTAGO ANG 30°-60°- PROF 70-100mm.	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN-WULLSTEIN (COPA) ANGULADA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA (CUERPO EXTRAÑO-POLIPOS). BOCA RECTA EN CU CHARILLA REDONDA- CAPACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 2.5 mm - 3.5 mm. VASTAGO ANGULADO 30° - 60° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO - ALCANCE DE PROFUNDIDAD 70 mm - 100 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR.

							LONG 90-120mmX70-90mm	LONGITUD TOTAL 90 mm - 120 mm X 70 mm - 90 mm.AC E RO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583372	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA. BOCA REDONDA-FENESTRADA-MORD DIAM 5.0-7.0mm. VAST ANG 90° PROF 110-140mm. LONG 150-190mmX80-110mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). BOCA RECTA- REDONDA- FENESTRADA CORTANTE- C APACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 5.0 mm - 7.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD1 10 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 150 mm - 190 mm X 80 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGR ADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583373	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA. BOCA REDONDA-FENESTRADA-MORDI DIAM 9.0-11mm. VAST ANG 90° PROF 110-140mm. LONG 150-190mmX80-110mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). BOCA RECTA- REDONDA- FENESTRADA CORTANTE- C APACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 9.0 mm - 11 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD1 10 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 150 mm - 190 mm X 80 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOG RADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2583374	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA. BOCA REDONDA-FENESTRADA-MORDID DIAM 13-15mm. VAST ANG 90° PROF 110-140mm. LONG 150-190mmX80-110mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE HARTMANN RECTA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). BOCA RECTA- REDONDA- FENESTRADA CORTANTE- C APACIDAD DE MORDIDA DIAMETRO 13 mm - 15 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 150 mm - 190 mm X 80 mm - 110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTOGRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2587024	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008		PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 90° GRADOS HACIA ABAJO- BOCA FENESTRADA - CAPACIDAD DE MORDIDA 3.0 mm - 4.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRAD O - 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587025	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ORL(ETMOIDES) . HOJA ANG 90° ABAJO- CAPAC MORD 5-6.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 90° GRADOS HACIA ABAJO- BOCA FENESTRADA - CAPACIDAD DE MORDIDA 5.0 mm - 6.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRAD O - 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587026	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ORL(ETMOIDES) . HOJA ANG 90° ARRIB- CAPAC MORD 3-4.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 90° GRADOS HACIA ARRIBA- BOCA FENESTRAD A- CAPACIDAD DE MORDIDA 3.0 mm - 4.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110M M - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587027	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ORL(ETMOIDES) . HOJA ANG 90° ARRIB- CAPAC MORD 5-6.5mm.	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 90° GRADOS HACIA ARRIBA- BOCA FENESTRAD A- CAPACIDAD DE MORDIDA 5.0 mm - 6.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110M M - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100%

							LONG 130-160mmX100-120mm	RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587028	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ETMOIDES. HOJA ANG 130°-150° ABAJ-CAPAC MORD 3-4.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 130° -150° GRADOS HACIA ABAJO- BOCA FEN ESTRADA- CAPACIDAD DE MORDIDA 3.0 mm - 4.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DEAL T O GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587029	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ETMOIDES. HOJA ANG 130°-150° ABAJ-CAPAC MORD 5-6.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 130° -150° GRADOS HACIA ABAJO- BOCA FEN ESTRADA- CAPACIDAD DE MORDIDA 5.0 mm - 6.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DEAL T O GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587030	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA ETMOIDES. HOJ ANG 130°-150° ARRIB- CAPAC MORD 3-4.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 130° -150° GRADOS HACIA ARRIBA- BOCA FE NESTRADA- CAPACIDAD DE MORDIDA 3.0 mm - 4.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587031	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BX DE WEIL-BLAKESLEY	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY ANGULADA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA ANGULADA 130° -150° GRADOS HACIA ARRIBA- BOCA FE NESTRADA- CAPACIDAD

							ANGULADA PARA ETMOIDES. HOJ ANG 130°-150° ARRIB- CAPAC MORD 5-6.5mm. LONG 130-160mmX100-120mm	DE MORDIDA 5.0 mm - 6.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587032	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY RECTA PARA OTORRINO (ETMOIDES). BOCA CAPAC MORDIDA 3.0-4.5mm. LONG 130-160mm X 100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY RECTA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA RECTA- BOCA FENESTRADA- CAPACIDAD DE MORDIDA 3.0 mm - 4.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO AR TICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587033	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY RECTA PARA OTORRINO (ETMOIDES). BOCA CAPAC MORDIDA 5.0-6.5mm. LONG 130-160mm X 100-120mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE WEIL-BLAKESLEY RECTA PARA OTORRINO (ETMOIDES). HOJA RECTA- BOCA FENESTRADA- CAPACIDAD DE MORDIDA 5.0 mm - 6.5 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 110 mm - 140 mm. MANGO ANILLADO AR TICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 130 mm - 160 mm X 100 mm - 120 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587034	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA (SENO MXLF). HOJA ANG 45° ARRIB- CORTE RETROG- MORD 2-4mm. LONG	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA ARRIBA - BOCA FENESTRADA- CORTE RETROGRADO- CAPACIDAD DE MORDIDA 2.0 mm - 4.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIOM EDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 90 mm - 120 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm X 80 mm - 110mm. ACERO

							120-150mmX80-110mm	QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587035	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA (SENO MAXILAR). HOJ ANG 45° DER-CORTE RETROG- MORD 2-4mm. LONG 120-150mmX80-110mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA DERECH A- BOCA FENESTRADA- CORTE RETROGRADO- CAPACIDAD DE MORDIDA 2.0 mm - 4.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIOM EDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 90 mm - 120 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm X 80 mm - 110m m. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2587036	42291609	ZMQX	ZMQI-014	N/A	C/U	A.02.02.01.004.008	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA (SENO MAXILAR). HOJ ANG 45° IZQ-CORTE RETROG- MORD 2-4mm. LONG 120-150mmX80-110mm	PINZA SACABOCADO-BIOPSIA DE STAMMBERGER ANGULADA PARA OTORRINO Y MAXILOFACIAL (SENO MAXILAR). HOJA ANGULADA 45° GRADOS HACIA IZQUIE RDA- BOCA FENESTRADA- CORTE RETROGRADO- CAPACIDAD DE MORDIDA 2.0 mm - 4.0 mm. VASTAGO ANGULADO 90° GRADOS HACIA LATERAL DESDE TERCIO MEDIO- ALCANCE DE PROFUNDIDAD 90 mm - 120 mm. MANGO ANILLADO ARTICULADO A BASTIDOR. LONGITUD TOTAL 120 mm - 150 mm X 80 mm -110 mm. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO- 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
GRUPO BIOMATERIALES

Código genérico	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de artículos	Subgrupo de artículos	Unidad de Medida	Rubro	Nombre	Especificación técnica
2300028	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN CILINDRO. BIOCOMPUESTO FIBRAS CORTICALES+POLILACTIDO-CO-GLICOLICO. TEMP 2-30°C. CILINDRO DIAM	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL

							7-9mm X ALTO 25-30mm	
2300029	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN CUBO BIOCOMPUESTO FIBRAS CORTICALES+POLILACTIDO-CO-GLICOLICO. TEMP 2-30°C. CUBO LONG10-12mmXPROF10-12mmXALT10-12mm	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL
2300030	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN CUBO BIOCOMPUESTO FIBRAS CORTICALES+POLILACTIDO-CO-GLICOLICO. TEMP 2-30°C. CUBO LONG20-25mmXPROF20-25mmXALT20-25mm	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL
2300031	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN CUÑA BIOCOMPUESTO FIBRAS CORTICALES+POLILACTIDO-CO-GLICOLICO. TEMP 2-30°C. CUÑA BASE 15-20mmXALT40-45mmXANG10°-15°	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL
2300032	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN LAMINA BIOCOMPUESTO HUESO CORTICAL MINERALIZA 30%+COPOLIMERO L-LACTIDE-	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL

							CO-GLYCOLIDE 70%. LAMINA SOLIDA LXL80-100mm	
2300033	60103923	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUSTITUTO OSEO EN LAMINA BIOCOMPUESTO HUESO CORTICAL MINERALIZ 30%+COPOLIMERO L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE 70%. LAMINA SOLIDA LXL150-200mm	SUSTITUTO OSEO EN CUBO. BIOCOMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL- FORMADO POR FIBRAS CORTICALES ORIGEN CADAVERICO-SUSPENDIDAS PARA SER MOLDEADO-PERFORADO Y FIJADO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS; QUE DE ESTABILIDAD-MANTENGA SU FORMA INICIAL
2300034	42295515	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. BIOCOMPUESTO DE MATRIZ DE COLAGENO DE PIEL DE BOVINO. TEMP 2°-30°C. LAMINA LONG 20-30mmX20-30mm	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. SUSTITUTO BIOLOGICO DE USO UNICO E INDIVIDUAL- PARA REPARACION DE DURAMADRE EN NEUROCIRUGIA-MANIPULACION AUN EN CONDICIONES DE HUMEDAD- RESISTENTE A PUNTOS DE SUTURA- QUE SE MANTENGA A TEMPERATURA AMBIENTE 2°-30° GRADOS
2300035	42295515	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. BIOCOMPUESTO DE MATRIZ DE COLAGENO DE PIEL DE BOVINO. TEMP 2°-30°C. LAMINA LONG 40-60mmX40-60mm	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. SUSTITUTO BIOLOGICO DE USO UNICO E INDIVIDUAL- PARA REPARACION DE DURAMADRE EN NEUROCIRUGIA-MANIPULACION AUN EN CONDICIONES DE HUMEDAD- RESISTENTE A PUNTOS DE SUTURA- QUE SE MANTENGA A TEMPERATURA AMBIENTE 2°-30° GRADOS
2300036	42295515	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. BIOCOMPUESTO DE MATRIZ DE COLAGENO DE	INJERTO/PARCHE DURAMADRE EN LAMINA. SUSTITUTO BIOLOGICO DE USO UNICO E INDIVIDUAL- PARA REPARACION DE DURAMADRE EN NEUROCIRUGIA-MANIPULACION AUN EN CONDICIONES DE HUMEDAD- RESISTENTE A PUNTOS DE SUTURA- QUE SE MANTENGA A TEMPERATURA AMBIENTE 2°-30° GRADOS

							PIEL DE BOVINO. TEMP 2°-30°C. LAMINA LONG70-100mmX70-100mm	
2300037	42295515	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CHIPS. BIOCOMPUESTO HUESO CORTICAL. TEMP 2°-30°C. FRASCO 50 ML CON CUBOS LONGXPROFXALT2.0-3.0mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300038	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CHIPS. BIOCOMPUESTO HUESO CORTICAL. TEMP2°-30°C. FRASCO 150 ML CON CUBOS LONGXPROFXALT2.0-3.0mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300039	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA EN CUBOS O FRAGMENTOS DE ESPONJOSA. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP2°-30°C. FRASCO 50ML CON CUBOS O FRAGMENTOS HUESO ESPONJOSO	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300040	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA EN CUBOS O FRAGMENTOS DE ESPONJOSA.	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.

							COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP2-30°C. FRASCO 100-150ML CUBOS O FRAGMENTOS HUESO ESPONJOSO	
2300041	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA EN LAMINA CIRCULAR FLEXIBLE. COMPUESTO BIOLOGICO ORIGEN CADAVERICO. TEMPERATURA AMBIENTE 2°-30°C. DISCO DIAMETRO 50-60mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300042	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN LAMINA FLEXIBLE. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP 2°-30 C. LAMINA CUADRADA LONG 25mm-30mm X 25mm-30mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300043	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN LAMINA FLEXIBLE. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP 2°-30 C. LAMINA CUADRADA LONG 50mm-70mm X 50mm-70mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.

2300044	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN LAMINA FLEXIBLE. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP 2°-30 C. LAMINA RECTANGULAR LONG 25mm-30mmX50mm-60mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300045	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN LAMINA FLEXIBLE. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP 2°-30 C. LAMINA RECTANGULAR LONG 25-30mmX100-120mm	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300046	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS(DBM+BMP). PASTA CORTICAL+HIALURONATO SODICO. JERINGA 0.5-1.0ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300047	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS(DBM+BMP).	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.

							PASTA CORTICAL+HIALURONATO SODICO. JERINGA 2.0-5.0ML	
2300048	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS(DBM+BMP). PASTA CORTICAL+HIALURONATO SODICO. JERINGA 8.0-10ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300049	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS(DBM80%+BMP 20%). MEZCLA+HIALURONATO SODICO. FRASCO 0.5ML-1.0ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300050	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS (DBM80%+BMP20%). MEZCLA+HIALURONATO SODICO.	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.

							FRASCO 2.0ML-5.0ML	
2300051	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA LIOFILIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS (DBM80%+BMP20%). MEZCLA+HIALURONATO SODICO. FRASCO 8.0ML-10ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300052	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS (DBM + BMP). BIOCOMPUESTO TIPO GEL HUESO ESPONJOSO. JERINGA DE 0.5ML-1.0ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300053	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS (DBM + BMP). BIOCOMPUESTO TIPO GEL HUESO ESPONJOSO. JERINGA DE 2.0ML-5.0ML	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300054	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA+PROTEINAS OSEAS MORFOGENICAS (DBM + BMP). BIOCOMPUEST	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.

							O TIPO GEL HUESO ESPONJOSO. JERINGA DE 8.0ML-10ML	
2300055	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MEMBRANA DE REGENERACION ABSORBIBLE COMPUESTA DE ATELOCOLAGENO Y UNA MATRIZ SEMITRANSLUCIDA COMPRIMIDA. LAMINA LONG 15-20mmX25-30mm	MEMBRANA DE REGENERACION ABSORBIBLE COMPUESTA DE ATELOCOLAGENO TIPO I MAS UNA MATRIZ SEMITRANSLUCIDA COMPRIMIDA. INDICADA EN EL PROCMOLDEABLE-REABSORBIBLE; QUE PERMITA MEZCLA CON OTRAS MATRICES BIOLOGICAS Y ADECUADA DISTRIBUCION DE CARGAS
2300056	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MEMBRANA DE REGENERACION ABSORBIBLE COMPUESTA DE ATELOCOLAGENO Y UNA MATRIZ SEMITRANSLUCIDA COMPRIMIDA. LAMINA LONG 30-35mmX40-50mm	MEMBRANA DE REGENERACION ABSORBIBLE COMPUESTA DE ATELOCOLAGENO TIPO I MAS UNA MATRIZ SEMITRANSLUCIDA COMPRIMIDA. INDICADA EN EL PROCMOLDEABLE-REABSORBIBLE; QUE PERMITA MEZCLA CON OTRAS MATRICES BIOLOGICAS Y ADECUADA DISTRIBUCION DE CARGAS
2300783	42295511	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MATRIZ OSEA EN CUBOS O FRAGMENTOS DE ESPONJOSA. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP2°-30°C. FRASCO 5ML CON CUBOS O FRAGMENTOS HUESO ESPONJOSO	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA (DBM) EN CUBOS DE CORTICAL. COMPUESTO BIOLOGICO USO UNICO E INDIVIDUAL. Y DISTRIBUCION DE LAS CARGAS; QUE DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DE CARGA; TEMPERATURA 2°-30°C.
2300826	42295466	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	RESTRICTOR/TAPON DE CEMENTO 8-12mm.COMPUE	RESTRICTOR/TAPON DE CEMENTO 14-18mm.COMPUESTO POR GELATINA PORCINA-AGUA- GLICEROL- BIODEGRADABLE-BIOCOMPATIBLE- RESISTENTE A ALTAS

							STO POR GELATINA PORCINA-AGUA-GLICEROL-BIODEGRADABLE-BIOCOMPATIBLE	PRESIONES. FUNCION: SELLAR LA CAVIDAD INTRAMEDULAR- AUMENTAR LA PENETRACION-MEJORAR LA FIJACION Y EVITAR QUE EL HUESO SUFRA FILTRACIONES DURANTE LA DISPENSACION Y PRESURIZACION CONSTANTE. ESTERIL
2300827	42295466	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	RESTRICTOR/TAPON DE CEMENTO 14-18mm.COMPUESTO POR GELATINA PORCINA-AGUA-GLICEROL-BIODEGRADABLE-BIOCOMPATIBLE- RESISTENTE A ALTAS	RESTRICTOR/TAPON DE CEMENTO 14-18mm.COMPUESTO POR GELATINA PORCINA-AGUA- GLICEROL- BIODEGRADABLE-BIOCOMPATIBLE- RESISTENTE A ALTAS PRESIONES. FUNCION: SELLAR LA CAVIDAD INTRAMEDULAR- AUMENTAR LA PENETRACION-MEJORAR LA FIJACION Y EVITAR QUE EL HUESO SUFRA FILTRACIONES DURANTE LA DISPENSACION Y PRESURIZACION CONSTANTE. ESTERIL
2300903	42295466	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CEMENTO QUIRURGICO OSEO 40G POLVO DE 0.50G GENTAMICINA	CEMENTO QUIRURG OSEO 40g POLV/O.50g GENT REF. 880213 ES UN CEMENTO PARA APLICACION MANUAL- QUE SE PRESENTA EN UN ENVASE QUE CONTIENE UN SOBRE CON 40 G DE POLVO RADIO OPACO CON 0.50 G DE GENTAMICINA-ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO Y UNA AMPULA CON 20 ML DE LIQUIDO ESTERILIZADO POR ULTRAFILTRACION.
2300904	42295466	ZOST	ZOST-001	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CEMENTO QUIRURGICO OSEO 60G POLVO 0.75G GENTAMICINA	CEMENTO QUIRURG OSEO 60g POLV/O.75g GENT REF. 880408 ES UN CEMENTO PARA APLICACION MANUAL- QUE SE PRESENTA EN UN ENVASE QUE CONTIENEUN SOBRE CON G0 G DE POLVO RADIO OPACO CON 0.75 G DE GENTAMICINA-ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO Y UNA AMPULA CON 30 ML DE LIQUIDO ESTERILIZADO POR ULTRAFILTRACION.

GRUPO PLACAS								
NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300058	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION

							CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	BIDIRECCIONAL-ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300059	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300060	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSIDAD MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300061	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSIDAD MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJER TITANIO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA

2300062	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300063	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300064	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJER TITANIO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300065	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESO DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJER TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION

2300066	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300067	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300068	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLO CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300069	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLO CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESO DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION

2300070	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESO DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300071	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300072	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12AGUJ TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION
2300073	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESO DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24AGUJ TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.

2300074	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300075	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300076	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300077	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.

							4.0mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO	
2300078	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS AC	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300079	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300080	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300081	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS

							CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO	OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300082	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300083	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300084	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA

2300085	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSID ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300086	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300087	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA
2300088	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA

							CORTA 2-12 AGUJ TITANIO	
2300089	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA GAMA LARGA 14-24 AGUJ TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCIONES
2300090	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCIONES
2300091	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCIONES
2300092	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLO CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCIONES

							ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJE TITANIO	
2300093	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLO CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJ TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCIIONES
2300094	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESO DENSID ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCIONES
2300095	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESO DENSID ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCIONES
2300096	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESO DENSID ALTA.	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm - 5.0 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCIONES

							GAMA CORTA 2-12 AGUJ TITANIO	
2300097	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm HUESO DENSID ALTA GAMA LARGA 14-24 AGUJ TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGO BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300098	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300099	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300100	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.

							5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	
2300101	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300102	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300103	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300104	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA- SUPERFICIE INFERIOR CON

							TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300105	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0mm-CORTICAL 4.5-5.0mm Y/O ESPONJOSA 6.5mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO	PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm - 4.0 mm- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300106	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA CORTA 2-12 AGUJ ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm - 4.0 mm- AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA
2300107	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 4.0 mm-SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS

2300108	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 4.0 mm- SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS
2300109	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5mm-CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- AGUJEROS LISOS OVALES STRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS
2300110	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJ 4.0mm GAMA- RECT-CURV- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- AGUJEROS LISOS OVALES STRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 mm - 3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS- TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS
2300111	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJ 4.0mm GAMA- RECT-CURV- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- SUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEOS

2300112	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5 TORNILLOS BLOQ 3.5mm Y/O CORTICAL 3.5mm. GAMA-RECTAS-CURVAS- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- SUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEOS
2300113	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5 TORNILLOS BLOQ 3.5mm Y/O CORTICAL 3.5mm. GAMA-RECTA- CURVA-ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- SUPERFICIE INFERIOR CLADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300114	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILLO BLOQ 2.7-3.5- CORTIC 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0mm GAMA-RECT- CURV-ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ	PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- SUPERFICIE INFERIORLADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300115	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILL BLOQ 2.7-3.5- CORT 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0mm. RECT- CURV-ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. TITANI	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- REDUCCION- ALINEAMIENTO- ESTABILIZACION- NEUTRALIZACION

2300116	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5mm Y/O ESPONJ 6.5mm GAMA- RECTA-CURVA- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 mm Y/O ESPONJOSA 6.5 mm. USOS- REDUCCION- ALINEAMIENTO- ESTABILIZACION- NEUTRALIZACION.
2300117	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5mm Y/O ESPONJ 6.5mm GAMA- RECT-CURV- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300118	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNILLOS BLOQ 4.0-5.0mm Y/O CORTIC 4.5mm GAMA- RECT- CURV- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. ACER	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300119	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQ 4.0-5.0mm Y/O CORTIC 4.5mm GAMA- RECT- CURV- ANG 90°- EN L- EN J- DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS- SUPERFICIE IDE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO

2300120	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNILL BLOQUEO 4.0-5.0- CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3- CORTICAL 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. ACER	PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm- PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS-SUPERFICIEDE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300121	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQUEO 4.0-5.0- CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3- CORTIC 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm - 4.0 mm PARA CLAVICULA. AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRE3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS DE DIAFISIS CLAVICULAR
2300122	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DCP 3.5-4.0 CLAVICULA. TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA-DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 mm - 4.0 mm PARA CLAVICULA. AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRE3.5 mm Y/O ESPONJOSA 4.0 mm. USOS-TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS DE DIAFISIS CLAVICULAR
2300123	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DCP 3.5-4.0 CLAVICULA. TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5mm Y/O ESPONJOSA 4.0mm GAMA-DERECHAS E IZQUIERDAS. TITANIO	PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 mm PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURLISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA
2300124	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5mm- CORTIC 2.4-2.7-3.5mm	PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOOVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION

							Y/O ESPONJ 4.0mm. ANT-SUP- CON O SIN GANCHO- DER E IZQ. ACERO	BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA
2300125	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5mm- CORTIC 2.4-2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0mm. ANT- SUP- CON O SIN GANCHO- DER E IZQ. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm RAMA CORTA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO
2300126	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA CORTA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5mm Y CORTICAL 3.5mm GAMA-DERECHA E IZQUIERDA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm RAMA CORTA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO
2300127	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA CORTA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5mm Y CORTICAL 3.5mm GAMA-DERECHA E IZQUIERDA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO
2300128	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO

							3.5mm Y CORTICAL 3.5mm GAMA-DERECHA E IZQUIERDA. ACERO	
2300129	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5mm Y CORTICAL 3.5mm GAMA-DERECHA E IZQUIERDA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA HUMERO DISTAL MEDIAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO-CARGA
2300130	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL MEDIAL TORNILL BLOQUEO 2.7-3.0-3.5mm Y CORTIC 2.4-2.7-3.5mm GAMA-CON O SIN PROLONG DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA HUMERO DISTAL MEDIAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO-CARGA
2300131	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL MEDIAL TORNILL BLOQUEO 2.7-3.0-3.5 Y CORTIC 2.4-2.7-3.5mm GAMA-CON O SIN PROLONG DER E IZQ. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA HUMERO DISTAL LATERAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO-CARGA
2300132	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL LATERAL TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA LAT Y	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA HUMERO DISTAL LATERAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO-CARGA

							DORSOLAT CON O SIN SOPORT DER E IZQ ACER	
2300133	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL LATERAL TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA LAT Y DORSOLAT CON O SIN SOPORT DER E IZQ TITA	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA CUBITO PROXIMAL - OLECRANON. PERFIL BAJO Y REDONDY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300134	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL-OLECRANON TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA CORTA/LARGA CON/SIN GANCHO DER E IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA CUBITO PROXIMAL - OLECRANON. PERFIL BAJO Y REDONDY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300135	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL-OLECRANON TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA CORTA/LARGA CON/SIN GANCHO DER E IZQ TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA CUBITO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300136	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.0-3.5mm Y CORTICAL 2.4-2.7-3.5mm GAMA RAMA CORTA O LARGA- DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm PARA CUBITO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES

2300137	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.0-3.5 Y CORTICAL 2.4-2.7-3.5mm GAMA RAMA CORTA O LARGA- DER E IZQ. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 mm - 2.4 mm - 2.7 mm PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300138	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH- ACOD-L- T- OBLIC-CORT/LARG. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 mm - 2.4 mm - 2.7 mm PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300139	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH- ACOD-L- T- OBLIC-CORT/LARG TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300140	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR- CORT/LARG- DER E IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES

2300141	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR-CORT/LARG-DER E IZQ TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm ANGULO DE INCLINACION 5° - 7° PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJOVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300142	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 ANGULO DE INCLINACION 5-7° RADIO PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 2.4mm Y CORTIC 2.0-2.4-2.7mm GAMA CORT/LARG-DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm ANGULO DE INCLINACION 5° - 7° PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJOVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300143	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 ANGULO DE INCLINACION 5-7° RADIO PROXIMAL TORNILL BLOQUEO 2.4mm Y CORTIC 2.0-2.4-2.7mm GAMA CORT/LARG-DER/IZQ TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO-SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS-CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO
2300144	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 mm Y DE CORTICAL 2.0 mm - 2.4 mm - 2.7 mm. GAMA-RAMA CORTA O LARGA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO-SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS-CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO

2300145	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 mm Y DE CORTICAL 2.0 mm - 2.4 mm - 2.7 mm. GAMA RAMA CORTA O LARGA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm - 3.5 mm PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300146	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT- ACOD- L-T- OBLIC-CORT/LARG-DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm - 3.5 mm PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300147	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT- ACOD- L-T- OBLIC-CORT/LARG-DER/IZQ TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300148	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA YUXTARTIC/EXTRARTIC-RECTAS/OBLIC-T- CORT/LARG ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES
2300149	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm PARA FEMUR PROXIMAL. CUERPO PREMOLDEADO- PERFIL BAJO YMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y

							YUXTARTIC/EXTRARTIC-RECTA/OBLIC-T- CORT/LARGTIT	ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO Y COAXIALES
2300150	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 FEMUR PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 4.0-5.0mm CORTICAL 4.5mm Y CANULADOS DE BLOQUEO/CONICOS CANULADOS 5.0-7.3mm ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm PARA FEMUR PROXIMAL. CUERPO PREMOLDEADO- PERFIL BAJO YMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300151	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 FEMUR PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 4.0-5.0mm CORTICAL 4.5mm Y CANULADOS DE BLOQUEO/CONICOS CANULADOS 5.0-7.3 TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA FRACTURAS PERIPROTESICAS FEMUR. PERFIL BAJO REDUCIENDO RIELAS PLACAS LCP DE FEMUR PROXIMAL. AGUJEROS LIBRES COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300152	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 FRACTURAS PERIPROTESICAS FEMUR. TORNILLOS DE BLOQUEO 3.5 mm Y DE CORTICAL 3.5 mm. GAMA-CUATRO U OCHO AGUJEROS. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA FRACTURAS PERIPROTESICAS FEMUR. PERFIL BAJO REDUCIENDO RIELAS PLACAS LCP DE FEMUR PROXIMAL. AGUJEROS LIBRES COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL

2300153	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 FRACTURAS PERIPROTESICAS FEMUR. TORNILLOS DE BLOQUEO 3.5 mm Y DE CORTICAL 3.5 mm GAMA CUATRO U OCHO AGUJEROS TITANIO	PLACA ANATOMICA DHS ANGULO 130° - 150° GRADOS DE COMPRESION DINAMICA DCP O COMPRESION BLOQUEABLE LCP PARA FRACTURAS FEMUR PROXIMAL.QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA; O AGUJEROS COMBINADOS
2300154	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DHS ANG 130-150° DCP/LCP FRACTURAS FEMUR PROXIMAL TORN DHS/DCS 12.5-14 BLOQ 3.5-5.0 CORTIC 4.5 ESPONJ 6.5 Y CANULAD 6.5 ACERO	PLACA ANATOMICA DHS ANGULO 130° - 150° DE COMPRESION DINAMICA DCP O COMPRESION BLOQUEABLE LCP PARA FRACTURAS FEMUR PROXIMAL. PERFILPROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA; O AGUJEROS COMBINADOS
2300155	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DHS ANG 130-150° DCP/LCP FRACTURAS FEMUR PROXIMAL TORN DHS/DCS 12.5-14 BLOQ 3.5-5.0 CORTIC 4.5 ESPONJ 6.5 Y CANULAD 6.5 TITANI	PLACA ANATOMICA DCS ANGULO 95° GRADOS DE COMPRESION DINAMICA DCP PARA FRACTURAS FEMUR PROXIMAL Y DISTAL. PERFIL REDONDEADO. AGUJERQUE ADMITA TORNILLOS DHS/DCS 12.5 mm - 14 mm- DE BLOQUEO 3.5 mm - 5.0 mm- DE CORTICAL 4.5 mm- DE ESPONJOSA 6.5 mm Y CANULADOS 6.5 mm
2300156	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DCS ANG 95° DCP FRACTURAS FEMUR PROXIMAL Y DISTAL TORN DHS/DCS 12.5-14- BLOQ 3.5-5.0- CORT 4.5- ESPONJ 6.5 Y	PLACA ANATOMICA DCS ANGULO 95° DE COMPRESION DINAMICA DCP PARA FRACTURAS FEMUR PROXIMAL Y DISTAL. PERFIL REDONDEADO. AGUJEROS DCP-ADMITA TORNILLOS DHS/DCS 12.5 mm - 14 mm- DE BLOQUEO 3.5 mm - 5.0 mm- DE CORTICAL 4.5 mm- DE ESPONJOSA 6.5 mm Y CANULADOS 6.5 mm

							CANULAD 6.5 ACERO	
2300157	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DCS ANG 95° DCP FRACTURAS FEMUR PROXIMAL Y DISTAL TORN DHS/DCS 12.5-14- BLOQ 3.5-5.0- CORT 4.5-ESPONJ 6.5 Y CANULAD 6.5 TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA VARIABLE
2300158	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE CON O SIN ANGULO VARIABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA VARIABLE
2300159	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARES
2300160	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF-L-T-TREBOL ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARES
2300161	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA

							TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF-L-T-TREBOL TITAN	PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES
2300162	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL-T ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 mm - 5.0 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES
2300163	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL-T TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIONAL
2300164	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ DINAMICO 3.5mm Y CORT 3.5mm GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIONAL
2300165	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL

							DINAMICO 3.5mm Y CORT 3.5mm GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL TITAN	LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIONAL
2300166	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T-CURVAT PEQ/GRAND ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIONAL
2300167	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T-CURVAT PEQ/GRAND TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO
2300168	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA-DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO
2300169	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO

							ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA-DER/IZQ TITAN	
2300170	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°-L-T ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES- COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO
2300171	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°-L-T TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA PERONE DISTAL. CUERPO MULTIFUNCIONALES-AGUJEROS COMBINADOS CON DOS FUNCIONES-LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULAR ES DE BLOQUEO
2300172	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE PERONE DISTAL TORN BLOQ 2.4-2.7-3.5 CORT 2.4-2.7-3.5-4.0 Y ESPONJ4.0 CORT/LARG-DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA PERONE DISTAL. CUERPO MULTIFUNCIONALES-COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO
2300173	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE PERONE DISTAL TORN BLOQ2.4-2.7-3.5 CORT2.4-2.7-3.5-4.0 Y ESPONJ4.0 CORT/LARG-DER/IZQ TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO-SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO

2300174	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 mm Y CORTICAL 2.7mm-3.5mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA- DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300175	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 mm Y CORTICAL 2.7mm-3.5mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA- DERECHAS E IZQUIERDAS TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.0 mm - 1.3 mm DE ADAPTACION PARA FALANGES MANO Y PIE. PERFIL BAJO YY/O AGUJEROS COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300176	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 1.0-1.3 DE ADAPTACION FALANGES MANO Y PIE TORNILLOS BLOQUEO 1.3 Y CORTICAL 1.0-1.3 GAMA RECTAS- EN T- EN Y- REJILLA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE ADAPTACION BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.0 mm - 1.3 mm PARA FALANGES MANO Y PIE. PERFIL BAJO Y REDY/O AGUJEROS COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300177	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 1.0-1.3 DE ADAPTACION FALANGES MANO Y PIE TORNILLOS BLOQUEO 1.3 Y CORTICAL 1.0-1.3 GAMA RECTA- EN T- EN Y- REJILLA TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 mm PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL

2300178	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS-EN T- EN Y-REJILLA-CONDILARES ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 mm PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300179	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS-EN T- EN Y-REJILLA-CONDILAR TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 mm PARA FALANGES CARPO- METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO-QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300180	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT- H-T-Y- CONDILAR-CORRECC DE ROTAC ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 mm PARA FALANGES CARPO- METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO-QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300181	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT- H-T-Y- CONDILAR-CORRECC DE ROTAC TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES-LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL

2300182	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 mm Y CORTICAL 2.4 mm GAMA RECTAS- EN T- EN Y- CONDILARES. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300183	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 mm Y CORTICAL 2.4 mm GAMA RECTAS- EN T- EN Y- CONDILARES. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm ANGULO DORSIFLEXION 8° - 10° GRADOS PARA ARTRODESIS TOTAGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300184	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 ANG 8°-10° ARTRODESIS TOTAL DORSAL MUÑECA TORN BLOQ 2.7-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA RECTAS-CURVAT PEQ/STAND ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm ANGULO DORSIFLEXION 8° - 10° GRADOS PARA ARTRODESIS TOTAGUJEROS COMBINADOS- CADA UNO CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL
2300185	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7-3.5 ANG 8°-10° ARTRODESIS TOTAL DORSAL MUÑECA TORN BLOQ 2.7-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA RECTAS-CURVAT PEQ/STAND TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm PARA ARTICULACION METACARPOFALANGICA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO-OVAL SIMETRICO DE UN LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA
2300186	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7 ARTICULACION METACARPOFALANGICA	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm PARA ARTICULACION METACARPOFALANGICA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO-OVAL SIMETRICO DE UN

							TORNILLOS BLOQUEO 2.7mm Y CORTICAL 2.7mm GAMA RECTA- H- L- T- OBLICUAS- DER/IZQ ACERO	LADO- QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA
2300187	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.7 ARTICULACION METACARPOFALANGICA TORNILLOS BLOQUEO 2.7mm Y CORTICAL 2.7mm GAMA RECTA- H- L- T- OBLICUA- DER/IZQ TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA ASTRAGALO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFICIE ICOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300188	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 ASTRAGALO TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA ASTRAGALO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFICIE ICOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.
2300189	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 ASTRAGALO TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA HUESO NAVICULAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300190	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 HUESO NAVICULAR TORNILLOS DE BLOQUEO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA HUESO NAVICULAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS

							2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA. ACERO	TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300191	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 HUESO NAVICULAR TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA HUESO CUBOIDES. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFIPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300192	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 HUESO CUBOIDES TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA DERECHA E IZQUIERDA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA HUESO CUBOIDES. PERFIL BAJO Y REDONDEADO- SUPERFIPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO
2300193	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 HUESO CUBOIDES TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4mm-2.7mm Y DE CORTICAL 2.4mm-2.7mm GAMA DERECHA E IZQUIERDA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA FUSION TARSOMETATARSIANA MEDIAL O PLANTAR. PERFIL BAJO Y RMULTIFUNCIONALES-COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300194	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 FUSION TARSOMETATARSIANA MEDIAL O PLANTAR	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm PARA FUSION TARSOMETATARSIANA MEDIAL O PLANTAR. PERFIL BAJO Y RMULTIFUNCIONALES-COMBINADOS CON DOS FUNCIONES- LISO OVAL

							TORN BLOQ 2.7-3.5 CORT 2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA MEDIAL/PLANTAR DER/IZQ ACERO	SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO
2300195	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 3.5 FUSION TARSOMETATARSIANA MEDIAL O PLANTAR TORN BLOQ2.7-3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA MEDIAL/PLANTAR DER/IZQ TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA ANTEPIE Y MESOPIE. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA
2300196	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 ANTEPIE Y MESOPIE TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA RECT CON/SIN PUENTE- H-L-T-X-OBLIC-TREBOL-CONDIL ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 mm - 2.7 mm PARA ANTEPIE Y MESOPIE. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SCON DOS FUNCIONES- LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y COAXIALES BIFUNCIONALES CON ALMA LISA
2300197	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA LCP 2.4-2.7 ANTEPIE Y MESOPIE TORN BLOQ2.4-2.7 Y CORT2.4-2.7-3.5 GAMA RECT CON/SIN PUENTE- H-L-T-X-OBLIC-TREBOL-CONDIL TITANIO	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 100° - 110° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIASAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300198	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG100°-110° LCP 2.7-3.5-5.0 OSTEOTOMIA VARIZANTE	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 100° - 110° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIASAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS

							TORN BLOQ2.7-5.0 Y CORT2.7-4.5 GAMA DOS/TRES AGUJERO ACERO	
2300199	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG100°-110° LCP 2.7-3.5-5.0 OSTEOTOMIA VARIZANTE TORN BLOQ2.7-5.0 Y CORT2.7-4.5 GAMA DOS/TRES AGUJ TITANIO	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 120° - 130° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIAS DE DESROAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300200	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG120°-130° LCP 3.5-5.0 OSTEOTOMIA DE DESROTACION TORN BLOQ 3.5-5.0 Y CORT 3.5-4.5 GAMA CORTO/LARGO ACERO	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 120° - 130° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIAS DE DESROAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300201	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG120°-130° LCP 3.5-5.0 OSTEOTOMIA DE DESROTACION TORN BLOQ 3.5-5.0 Y CORT 3.5-4.5 GAMA CORT/LARG TITANIO	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 140° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIAS VALGUIAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300202	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG140° LCP	PLACA PEDIATRICA DE CADERA ANGULO 140° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 mm - 3.5 mm - 5.0 mm PARA OSTEOTOMIAS VALGUIAGUJEROS ROSCADOS CONICOS Y/O DE

							2.7-3.5-5.0 OSTEOTOMIA VALGUIZANTE TORN BLOQ 2.7-3.5-5.0 Y CORT 2.7-3.5-4.5 GAMA CORT/LARG ACERO	ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300203	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG140° LCP 2.7-3.5-5.0 OSTEOTOMIA VALGUIZANTE TORN BLOQ2.7-3.5-5.0 Y CORT2.7-3.5-4.5 GAMA CORT/LARG TITANIO	PLACA PEDIATRICA CONDILAR ANGULO 90° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 5.0 mm PARA CONDILO FEMORAL DISTAL. DISEDE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300204	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CONDILAR ANG90° LCP 3.5-5.0 CONDILO FEMORAL DISTAL TORN BLOQ 2.7-3.5-5.0 Y CORTIC 2.7-3.5-4.5 GAMA CORT/LARG ACERO	PLACA PEDIATRICA CONDILAR ANGULO 90° DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 mm - 5.0 mm PARA CONDILO FEMORAL DISTAL. DISEDE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS
2300205	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CONDILAR ANG90° LCP 3.5-5.0 CONDILO FEMORAL DISTAL TORN BLOQ 2.7-3.5-5.0 Y CORT 2.7-3.5-4.5 GAMA CORT/LARG TITANIO	PLACA PEDIATRICA DE CADERA PERFIL EN T ANGULADA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE DCP/LCP 3.5 mm - 4.5 mm PARA OSTEOTOMIAS DEPERFIL EN T EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS DCP O COMBINADOS
2300206	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA	PLACA PEDIATRICA DE CADERA PERFIL EN T ANGULADA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION

							CADERA ANG PERFIL EN T DCP/LCP 3.5-4.5 OSTEOTOMIA CADERA TORN BLOQ2.7-5.0 Y CORT2.7-4.5 GAMA LAMINA 80°-130° ACERO	BLOQUEABLE DCP/LCP 3.5 mm - 4.5 mm PARA OSTEOTOMIAS DEPERFIL EN T EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS DCP O COMBINADOS
2300207	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PEDIATRICA CADERA ANG PERFIL EN T DCP/LCP 3.5-4.5 OSTEOTOMIA CADERA TORN BLOQ2.7-5.0 Y CORT2.7-4.5 GAMA LAMINA 80-130° TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 mm CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE- PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA- ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 mm - 20 mm. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS
2300572	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm
2300573	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm
2300574	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm
2300575	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm
2300585	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN TITANIO

							CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN TITANIO	
2300586	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO
2300587	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL-ALIANS SLIM T2-3H STANDAR - DER TITANIO	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL-ALIANS SLIM T2-3H STANDAR - DERECHA-TITANIO
2300588	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL-ALIANS SLIM T2-3H STANDAR - DER ACERO	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL-ALIANS SLIM T2-3H STANDAR - DERECHA-ACERO
2300594	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA OLECRANON ALIANS T1-IZQ DE TITANIO CON SISTEMA DUAL TECH	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA OLECRANON ALIANS T1-IZQ DE TITANIO CON SISTEMA DUAL TECH
2300626	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO

2300627	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN ACERO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN ACERO
2300628	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO
2300629	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN ACERO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN ACERO
2300631	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 9.4-10.6cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 8-9. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 9.4-10.6cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 8-9. EN TITANIO
2300633	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm.	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7- 3.5mm. AGUJEROS 10-11. TITANIO

							AGUJEROS 10-11. EN TITANIO	
2300634	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN ACERO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm- TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN ACERO
2300635	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO
2300636	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6 AGUJEROS. EN ACERO	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6 AGUJEROS. EN ACERO
2300637	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6AGUJERO. EN COBALTO-CROMO	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm- TORNILLO CORTICAL 1.5mm- 3-6AGUJERO. EN COBALTO-CROMO
2300638	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 55-70-(Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGU12°.	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 55-70-(Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. TITANIO

							TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm- LONG14-22. TITANIO	
2300639	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 55-70- (Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm- LONG14-22. ACERO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 55-70- (Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. ACERO
2300640	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 71-76- (Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm- LONG14-22. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG71-76- DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. TITANIO
2300641	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 71-76- (Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm- LONG14-22. ACERO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG77-82- DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. ACERO

2300642	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 77-82-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG14-22. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG77-82-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. TITANIO
2300643	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 77-82-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG14-22. ACERO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 77-82-(Ø)3.5mm- PROF. GANCHO12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCADO (Ø)3.5mm- LONG14-22. ACERO
2300644	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 83-88-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG23-31. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG83-88-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 14-15mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCADO Ø)3.5mm- LONG23-31. TITANIO
2300645	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 83-88-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG83-88-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG23-31. ACERO

							13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG23-31. ACERO	
2300646	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 89-94-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG23-31. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG89-94-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG23-31. TITANIO
2300647	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 89-94-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG23-31. ACERO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG89-94-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG23-31. ACERO
2300648	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 95-100-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG95-100-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 12-13mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROTITANIO

							LONG23-31. TITANIO	
2300649	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 95-100-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO12-13mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG23-31. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG101-106-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 16-18mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG23-31. TITANIO
2300650	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 101-106-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO16-18mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG32-39. TITANIO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG101-106-DIAMETRO (Ø) 3.5mm- PROFUNDIDAD DEL GANCHO 16-18mm- ANGULACION 12°. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG23-31. TITANIO
2300651	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 101-106-(Ø)3.5mm-PROF. GANCHO16-18mm-ANGU12°. TORNILLO CORTICAL AUTORRO (Ø)3.5mm-LONG32-39. ACERO	PLACA GANCHO CLAVICULAR LONG 101-106-(Ø)3.5mm PROFUNDIDAD-GANCHO 16-18mm-ANGULACION 12°. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø)3.5mm- LONG32-39. ACERO
2300652	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201-	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201-DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4.5 TITANIO

							(Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO	
2300653	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201-(Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. ACERO	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG 161-201-DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4.5 mm ACERO
2300654	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG202-241-(Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG 202-241-DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO
2300655	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJERO-FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJEROS- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO
2300656	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJERO-FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN ACERO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJEROS- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO

2300657	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJERO- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJEROS- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN ACERO
2300658	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJERO- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN ACERO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJERO- FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN ACERO
2300661	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA VLP 3.5 CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO DISTAL EN TITANIO- 3-5 ORIF- LONG 47-72mm. DER-IZQ	PLACA VLP 3.5mm CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO DISTAL POSTERIOR EN TITANIO- 3-5 ORIFICIOS- LONG 47-27mm. TORNILLO DE BLOQUEO Y ESTANDAR 3.5mm. AGUJEROS QUE PERMITAN COMPRESION Y BLOQUEO. DERECHO-IZQUIERDO
2300662	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA VLP 3.5 CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL EN TITANIO- 4-7 ORIFICIOS- LONG64-98mm	PLACA VLP 3.5 CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL EN TITANIO- 4-7 ORIFICIOS- LONG64-98mm
2300674	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3-5mm X LONGITUD 108-160mm 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3-5mm X LONGITUD 108-160mm 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE

2300675	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3-5mm X LONGITUD 185-262mm 10-16 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE	PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4-5mm 4-8 ORIFICIOS X 85-157mm EN TITANIO
2300688	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA TUBULAR 3.5mm BLOQUEADA UN TERCIO- 4-6 O X 57-82mm EN TITANIO	PLACA TUBULAR 3.5mm BLOQUEADA UN TERCIO-4-6 O X 57-82mm EN TITANIO
2300689	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE COMPRESION 3.5mm NO BLOQUEADA DE 2-4 ORIFICIOS X 41-67mm EN TITANIO	PLACA TUBULAR 3.5mm BLOQUEADA UN TERCIO-4-6 O X 57-82mm EN TITANIO
2300690	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE COMPRESION 3.5mm NO BLOQUEADA DE 5-7 ORIFICIOS X 80-106mm EN TITANIO	PLACA DE COMPRESION 3.5mm NO BLOQUEADA DE 5-7 ORIFICIOS X 80-106mm EN TITANIO
2300691	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4-5mm 4-8 ORIFICIOS X 85-157mm EN TITANIO	PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4-5mm 4-8 ORIFICIOS X 85-157mm EN TITANIO
2300711	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PARA PIE RECTA DE 2-7 ORIFICIOS EN TITANIO- DEFECHA E IZQUIERDA	PLACA PARA PIE RECTA DE 2-7 ORIFICIOS EN TITANIO- DEFECHA E IZQUIERDA
2300713	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA PARA PIE EN H	PLACA PARA PIE EN H ORIFICIOS 7-9 EN TITANIO

							ORIFICIOS 7-9 EN TITANIO	
2300716	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA 3.5mm BLOQUEADA CLAVICULA SUPERIOR MEDIA 6-7 ORIFICIOS - LONGITUD 73-85mm. DERECHA E IZQUIERDA. EN TITANIO	COMPONENTE FEMORAL 1-2-3-4-5 EN CROMO COBALTO- DERECHO E IZQUIERDO. RESISTENTE AL DESGASTE- BIOCOMPATIBLE
2300825	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE TITANIO CON ESPACIADOR (0-8mm)- PARA LA ESTABILIZACION DEOSTEOTOMIAS DE LA BASE METATARSIANA	PLACA DE TITANIO CON ESPACIADOR (0-8mm)- PARA LA ESTABILIZACION DEOSTEOTOMIAS DE LA BASE METATARSIANA
2300833	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO RECTA 2.0mm- LONG 2.0-38mm- 5-7 ORIFICIOS- EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)- ANGULO VARIABLE	PLACA GANCHO RECTA 2.4mm- LONG 2.0-52mm- 5-7 ORIFICIOS- EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)- ANGULO VARIABLE- DISTANCIA ENTRE LOS ORIFICIOS 6mm. DISEÑADAS PARA FIJAR FRAGMENTOS OSEOS DE PORCIONES DISTALES. EMPAQUE INDIVIDUAL
2300834	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO RECTA 2.4mm- LONG 2.0-52mm- 5-7 ORIFICIOS- EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)- ANGULO VARIABLE	PLACA GANCHO RECTA 2.4mm- LONG 2.0-52mm- 5-7 ORIFICIOS- EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)- ANGULO VARIABLE- DISTANCIA ENTRE LOS ORIFICIOS 6mm. DISEÑADAS PARA FIJAR FRAGMENTOS OSEOS DE PORCIONES DISTALES. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2300835	42321512	ZOST	ZOST-002	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA GANCHO RECTA 2.7mm- LONG 2.0-68mm-	PLACA GANCHO RECTA 2.7mm- LONG 2.0-68mm- 5-7 ORIFICIOS- EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)- ANGULO VARIABLE

							5-7 ORIFICIOS-EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2mm)-ANGULO VARIABLE	
GRUPO TORNILLOS								
NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300208	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300209	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300210	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA,	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO	
2300211	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSIN-ESTERILIZACION
2300212	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-30MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 30 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS ESTERILIZACION
2300213	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-16MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 16 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

2300214	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300215	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300216	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300217	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

							CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-60MM TITANIO	
2300218	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300219	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.E STERILIZACION
2300220	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

2300221	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300222	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 14-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300223	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 14-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300224	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO	
2300225	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM -70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300226	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME O STARDRIVE. LONG 6.0-14MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 14 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300227	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORM O STARDRIVE. LONG 6.0-14MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 14 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

2300228	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.3MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME O STARDRIVE. LONG 6.0-18MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.3 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 18 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300229	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.3MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORM O STARDRIVE. LONG 6.0-18MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.3 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 18 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300230	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME O STARDRIVE. LONG 6.0-24MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300231	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 1.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLA

							ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORM O STARDRIVE. LONG 6.0-24MM TIT	CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300232	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-38MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 38 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300233	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-38MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 38 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300234	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE.	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

							LONG 6.0-40MM ACERO	
2300235	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300236	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO.CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300237	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

2300238	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300239	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300240	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300241	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA

							ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300242	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM ACER	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300243	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300244	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE.	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

							LONG 45-90MM ACERO	
2300245	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-90MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300246	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300247	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300248	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCAN	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON

							TE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO	PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300249	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300250	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300251	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION

							HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO	
2300252	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ESTERILIZACION
2300253	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300254	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300255	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300256	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300257	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA LARGA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300258	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	
2300259	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA-FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300260	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA-FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300261	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA-FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300262	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300263	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300264	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300265	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 3.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 3.5 MM ROSCA CORTA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	
2300266	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300267	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300268	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL.ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300269	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O

							CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300270	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300271	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300272	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300273	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300274	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300275	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300276	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	
2300277	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300278	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300279	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300280	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL.ROSCA	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O

							CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES
2300281	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL.ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300282	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300283	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300284	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300285	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300286	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300287	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	
2300288	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300289	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300290	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFOR O HEXAG. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300291	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTA O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300292	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFOR O HEXAG. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTEE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40 mm -QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300293	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA LARGA O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40 MM-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300294	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							CRUCIFORME O HEXAG. LONG 8.0-40MM ACERO	
2300295	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300296	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ CRUCIFORM O HEXAG. LONG 8.0-28MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300297	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TIT	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 mm - 28 mm - QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300298	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm- QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300299	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITA	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCIFORME O HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM-50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION
2300300	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFOR O HEXAG. LONG 8.0-28MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCIFORME O HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DEPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM-28 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. 100% RESISTENTE A CORROSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION

2300301	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCIFORME O HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM-28 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300302	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM-50 MM- QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300303	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 3.0 MM 50mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300304	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA, AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS.

							CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAG. LONG 8.0-28MM ACERO	LONGITUD 8.0 MM -28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300305	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 8.0-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA, AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300306	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM-50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300307	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAG. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300308	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-28MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300309	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM-ROSCA CORTA DE 16-CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA-ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE-LONG 10-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300310	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300311	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE.	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTE DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							LONG 30-50MM TITANIO	
2300312	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-28MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300313	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300314	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300315	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA,	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD

							ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 30-50MM TITANIO	30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300316	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 10-28MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300317	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 28 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300318	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300319	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 3.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300320	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300321	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300322	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

							STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO	
2300323	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300324	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300325	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300326	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA,	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD

							ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO	40 MM - 72 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300327	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 32-CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA-ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE-LONG 40-72MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 38 mm. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300328	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGONO STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300329	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300330	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300331	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300332	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300333	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS

							O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300334	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300335	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300336	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCACORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300337	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS.

							CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300338	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300339	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA-AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300340	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300341	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300342	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300343	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300344	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS

							HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300345	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300346	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300347	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 80 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION

2300348	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE-PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300349	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 48 mm-QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS-ESTERILIZACION
2300350	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM1
2300351	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE.	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MMB IOCOMPATIBL

							LONG 50-80MM TITANIO	
2300352	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM1 00%
2300353	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MMB IOCOMPATIBL
2300354	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM1 00%
2300355	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O

							CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80MBIOCOMPATIBLE,
2300356	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80MRE
2300357	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140B IOCOMPATIBLE,
2300358	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140R
2300359	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y

							PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM TITANIO	FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 BIOCOMPATIBLE
2300360	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100%
2300361	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80MBIOCOMPATIBLE,
2300362	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80MRE
2300363	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32.	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS

							CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO	OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140B IOCOMPATIBLE,
2300364	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140R
2300365	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 BIOCOMPATIBLE
2300366	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100%
2300367	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32.	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O

							CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO	AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80M100
2300368	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80MRESIS
2300369	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 1401 0
2300370	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 85-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140R ESI

2300371	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180
2300372	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 RES
2300373	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MBIOCOMPATIBLE,
2300374	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MRE

							HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM ACERO	
2300375	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 130B IOCOMPATIBLE,
2300376	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-130MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 130R
2300377	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-130MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MBIOCOMPATIBLE,
2300378	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA,	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MRE

							ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM ACERO	
2300379	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 130B IOCOMPATIBLE,
2300380	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-130MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 130R
2300381	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-130MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70M100
2300382	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS

							CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-70MM ACERO	DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MRESIS
2300383	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 1301 0
2300384	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 75-130MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 130R ESI
2300385	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-130MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90MBIOCOMPATIBLE,
2300386	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16.

							CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM ACERO	AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90MRE
2300387	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 140B IOCOMPATIBLE,
2300388	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 95-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 140R
2300389	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 95-140MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 BIOCOMPATIBLE

2300390	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100%
2300391	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90MBIOCOMPATIBLE,
2300392	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90MRE
2300393	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE.	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 140B IOCOMPATIBLE,

							LONG 20-90MM TITANIO	
2300394	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 95-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 140R
2300395	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 95-140MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 BIOCOMPATIBLE
2300396	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100%
2300397	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90M100

							O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO	
2300398	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-90MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90MRESIS
2300399	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 1401 0
2300400	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 95-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 95 MM - 140R ESI
2300401	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZ BAJO PERFIL	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS

							ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 95-140MM TITANIO	DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180
2300402	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 RES
2300403	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 1.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLACA
2300404	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 1.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-24MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 1.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLACCORROSI

2300405	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 1.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG6.0-24MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 30 MM. QUE CUMPLACA
2300406	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERICO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG6.0-30MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 30 MM. QUE CUMPLACCORROSI
2300407	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG6.0-30MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLACA
2300408	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD,	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLACCORROSI

							ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG6.0-40MM ACERO	
2300409	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CO C
2300410	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CORROSION
2300411	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUM RESISTE

2300412	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-40MM ACERO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO
2300413	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUM RESISTEN
2300414	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUM CO
2300415	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD,	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLACA

							ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	
2300416	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLACCORROSI
2300417	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 10-18MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLACA
2300418	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 42-80MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLACCORROSI
2300419	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL.	TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO

							CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TIANIO	O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 16 MM - 40 MM. QUE CUMPLACA
2300420	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 4.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 16-40MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 16 MM - 40 MM. QUE CUMPLACCORROSI
2300421	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 4.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 16-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLACA
2300422	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 4.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-80MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLACCORROSI

2300423	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 4.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUM RESISTEN
2300424	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 14-40MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUM CO
2300425	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 100 MM. QUE CU RESISTE
2300426	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD,	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 100 MM. QUE CU C

							ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG42-100MM ACERO	
2300427	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG42-100MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPA
2300428	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 30-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPATIBLE,
2300429	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMB IOCOMPA
2300430	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y

							PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM ACERO	FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMB IOCOMPATIBLE,
2300431	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPA
2300432	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPATIBLE,
2300433	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMB IOCOMPA

2300434	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMB IOCOMPATIBLE,
2300435	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPATIB
2300436	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 30-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM100
2300437	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O

							ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMB IOCOMPATIB
2300438	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 65-90MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM100
2300439	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60MBIOCOMPATIBLE,
2300440	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60MR

2300441	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 110B IOCOMPATIBLE
2300442	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-110MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 1101 00%
2300443	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-110MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 35 MM - 70MBIOCOMPATIBLE,
2300444	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 35 MM - 70MR

							O STARDRIVE. LONG 35-70MM ACERO	
2300445	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 35-70MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 110B IOCOMPATIBLE
2300446	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-110MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 1101 00%
2300447	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-110MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60M10
2300448	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O

							CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60MRESI
2300449	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 1001
2300450	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-100MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 6.5 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 100R ES
2300451	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 6.5MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-100MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 3.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSP ROCESOS

2300452	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 3.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCADA, ANCLAJ STARDRIVE. LONG 20-50MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 3.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSE ST
2300453	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 3.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG20-50MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 3.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSP ROCESOS
2300454	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 3.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCADA, ANCLAJ STARDRIVE. LONG 52-70MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 3.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSE ST
2300455	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 3.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL.	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON

							CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG52-70MM TITANIO	PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS PRO
2300456	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCADA, ANCLAJ STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D
2300457	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG30-50MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS PRO
2300458	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCADA, ANCLAJ STARDRIVE.	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D

							LONG 52-90MM ACERO	
2300459	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG52-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20BI OCOM
2300460	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20BI OCOMPATIBLE
2300461	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85BI OCO
2300462	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O

							PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-145MM ACERO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85BI OCOMPATIBL
2300463	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-145MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30BI OCOM
2300464	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30BI OCOMPATIBLE
2300465	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 55BI OCOM
2300466	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS

							LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 55-80MM ACERO	CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 55BI OCOMPATIBLE
2300467	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 55-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMB IOCOMPAT
2300468	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 30-50MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM1
2300469	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 55 MMB IOCOMPAT

2300470	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 55-80MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 55 MM1
2300471	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 55-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 8B IOCOMPATIBL
2300472	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 81 00%
2300473	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 1B IOCOMPATIB

							HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	
2300474	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-110MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 11 00
2300475	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-110MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 7B IOCOMPATIBL
2300476	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-75MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 71 00%
2300477	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O

							ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-75MM TITANIO	CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 80 MM - 1B IOCOMPATIB
2300478	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 80-110MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 80 MM - 11 00
2300479	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 80-110MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60MBIOCOMPATIBLE,
2300480	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60MRE
2300481	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA.	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN

							CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105B IOCOMPATIBLE,
2300482	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105R
2300483	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 7B IOCOMPATIBL
2300484	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 71 00%

2300485	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 1B IOCOMPATIB
2300486	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-145MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 11 00
2300487	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-145MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 7B IOCOMPATIBL
2300488	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE.	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 71 00%

							LONG 20-70MM ACERO	
2300489	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 1B IOCOMPATIB
2300490	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-145MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 11 00
2300491	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-145MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MBIOCOMPATIBLE,
2300492	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 70MRE

							HEXAGON O STARDRIVE. LONG 20-70MM ACERO	
2300493	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-70MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 145B IOCOMPATIBLE,
2300494	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAGON O STARDRIVE. LONG 75-145MM ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/OPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 75 MM - 145R
2300495	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 7.3MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 75-145MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPLACCORR
2300496	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA.	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 7.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN

							CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM ACERO	HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. A
2300497	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 7.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 8.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPLACCORR
2300498	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 8.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM ACERO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 8.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. A
2300499	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 8.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 9.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPLACCORR
2300500	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 9.0MM. ROSCA COMPLETA.	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 9.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN

							CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM ACERO	HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. A
2300501	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 9.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 10 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTORROSCANTEPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPLACCORRO
2300502	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 10MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM ACERO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 10 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. ADE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPLA
2300503	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 10MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 2.0 MM - 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA. LONGITUD 20 MM - 25 MM -AC ID
2300504	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 2.0-3.0MM. ROSCA	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 3.5 MM - 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS

							COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 257 5
2300505	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 3.5-4.5MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 5.0 MM - 6.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 257 5
2300506	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 5.0-6.0MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIP R
2300507	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIP ROCESOS
2300508	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16.	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS

							CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO	CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIP R
2300509	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIP ROCESOS
2300510	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 1.5 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 2.0 - 8.DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BA D
2300511	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 1.5MM. ROSCA CORTA DE 2.0-8.0MM. PASO ROSCA IDENTICAS CABEZA Y VASTAGO. LONG 8.0-20MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 1.5 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 2.0 - 8.DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BA ALE

2300512	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 1.5MM. ROSCA CORTA DE 2.0-8.0MM. PASO ROSCA IDENTICA CABEZA Y VASTAGO. LONG 8.0-20MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 1.5 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 2.0 - 8.DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BA COMPUE
2300513	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 1.5MM. ROSCA CORTA DE 2.0-8.0MM PASO ROSCA IDENTICA CABEZ Y VASTAG. LONG8.0-20MM POLIETILENO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASYOS
2300514	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASYOS
2300515	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL.	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASYOS

							LONG 8.0-40MM TITANIO	
2300516	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM CABEZA BAJO PERFIL LONG 8.0-40MM POLIETILEN	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8. TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO
2300517	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA DE 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8. TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO
2300518	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8. TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO
2300519	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG	TORNILLO MALEOLAR TIPO HERBERT DE 2.0 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. DOBLE CABEZA BARESOLUCION. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA. LONGIT BIOCOMPATIB

							8.0-40MM POLIETILENO	
2300520	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR TIPO HERBERT 2.0MM. CABEZA BAJO PERFIL DESCARTABLE ANCLADA A PIEZA DE CONEXION EN MINIBARRIL. LONG 10-15MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR TIPO HERBERT DE 2.0 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. DOBLE CABEZA BARESOLUCION. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA. LONGIT ACIDO
2300521	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO MALEOLAR TIPO HERBERT 2.0MM. CABEZA BAJO PERFIL DESCARTABLE ANCLADA A PIEZA CONEXION MINIBARRIL. LONG 10-15MM POLIETILENO	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDQUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORROSI ESTERILIZACION
2300522	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM. ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL. LONG 50-75MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDQUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORROSION Y AE STERILIZACION
2300523	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM. ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 50-75MM PARA PLACA DE	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE ESTERILIZACION

							CILINDRO CORTO TITANIO	
2300524	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM. ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 80-110MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A COR ESTERILIZACION
2300525	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 80-110MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR TITANIO	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE ESTERILIZACION
2300526	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 115-145MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA ESTANDESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A COR ESTERILIZACION
2300527	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 50 MM - 75 MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO. QUE CUMPLA

							DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 115-145MM PARA PLACA DE CILINDR ESTANDAR TITANIO	CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUE STERILIZACION
2300528	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 50-75MM EN PLACA CILINDR CORTO ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 50 MM - 75 MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIOES TERILIZACION
2300529	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 50-75MM EN CILINDRO CORTO TITANIO	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 80 MM - 110 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERE STERILIZACION
2300530	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 80-110MM EN CILINDRO ESTANDAR ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 80 MM - 110 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITAE STERILIZACION

2300531	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG80-110MM EN CILINDRO ESTANDAR TITANIO	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 115 MM - 145 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACEE STERILIZACION
2300532	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 115-145MM EN CILINDRO ESTANDAR ACERO	TORNILLO DHS/DCS DE 14 MM DE EMERGENCIA DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJEJOVENES. LONGITUD 115 MM - 145 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITE STERILIZACION
2300533	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DHS/DCS 14MM DE EMERGENCIA ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG115-145MM EN CILINDRO ESTANDAR TITANI	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 75 MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BESTERILIZACION
2300534	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 75 MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPA ESTERILIZACION

							LONG 65-75MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO ACERO	
2300535	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 65-75MM PARA PLACA DE CILINDRO CORTO TITANIO	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 110 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO ESTERILIZACION
2300536	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 80-110MM PARA PLACA CILINDRO ESTANDAR ACERO	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 110 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, DE ALTO GRADO ESTERILIZACION
2300537	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 80-110MM PARA PLACA CILINDRO ESTANDAR TITANIO	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 145 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO ESTERILIZACION
2300538	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG 115-145MM PARA	TORNILLO/LAMINA DHS DE 12.5 MM DESLIZANTE. EJE CENTRAL HUECO, PERFIL DE ROSCA EN ESPIRAL, ROSCA DE 20 MM - 30 MM. ANCLAJE MUESCA E- 145 MM PARA PLACA DE CILINDRO ESTANDAR. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, DE ALTO GRADO ESTERILIZACION

							PLACA CILINDRO ESTANDAR ACERO	
2300539	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/LAMINA DHS 12.5MM ROSCA 20-30MM ANCLAJE MUESCA EN DOS PLANOS U OCTAGONAL LONG115-145MM PARA PLACA CILINDRO ESTANDAR TITANIO	TORNILLO DE COMPRESION DHS/DCS, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA COMPLETA, AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJEMM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGICO DE ALTO GRADO, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CON ALTO GRADO ESTERILIZACION
2300540	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE COMPRESION DHS/DCS. ROSCA COMPLETA PERFIL ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA ANCLAJE HEXAGONAL LONG35-40MM ACERO	TORNILLO DE COMPRESION DHS/DCS, PERFIL DE ROSCA ESTRECHO, ROSCA COMPLETA, AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJEMM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORROSION ALTO GRADO ESTERILIZACION
2300541	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE COMPRESION DHS/DCS ROSCA COMPLETA PERFIL ESTRECHO CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA ANCLAJE HEXAGONAL LONG35-40MM TITANIO	CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV
2300583	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO AUTO-	TORNILLO CANULADO AUTO-COMPRESIVO Y AUTOPERFORANTE 6.0 MM-L60 MM (1,7MM) EN HACERO INOXIDABLE

							COMPRESIVO Y AUTOPERFORANTE 6.0 MM-L60 MM (1,7MM) EN TITANIO	
2300584	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO AUTO-COMPRESIVO Y AUTOPERFORANTE 6.0 MM-L60 MM (1,7MM) EN HACERO INOXIDABLE	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN TITAIO
2300589	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm ACERO
2300590	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm ACERO	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L20MM
2300591	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L20MM	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L12MM
2300592	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L12MM	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L18MM
2300593	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUE 2.8MM L18MM	PLACA POLIAXIAL BLOQUEADA OLECRANON ALIANS T1-IZQ DE TITANIO CON SISTEMA DUAL TECH
2300595	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO NUCLEO REFORZADO 2.8MM L45MM	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO NUCLEO REFORZADO 2.8MM L16MM
2300596	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DUAL TECH S2 BLOQUEADO NUCLEO REFORZADO 2.8MM L16MM	TORNILLO NO BLOQUEADO DE 3.5MM LONG 20MM

2300597	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO NO BLOQUEADO DE 3.5MM LONG 20MM	CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300623	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA	ANCLAJE TODO SUTURA 1.7mm. CON UNA SUTURA N° 2. ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO, REPARACION DE INESTABILIDAD
2300665	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO
2300666	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO
2300667	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO	TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR

2300668	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR
2300669	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR
2300670	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM
2300671	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM	ANCLAJE 2.0 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: RECONEXION DE TEJIDO BLANDO AL HUESO EN LESIONES DE PIE Y TOBILLO, CODO, MUÑEC A Y MANO. REF 72202019
2300676	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-40MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-40MM TITANIO
2300677	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 x 10-20MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZET20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.

							O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO	
2300678	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 X 10-20MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 x 10-20MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZET20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.
2300679	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 X 10-20MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 10-20MM EN ACERO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM.HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.
2300680	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 10-20MM EN ACERO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 22-32MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.
2300681	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 22-32MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 34-44MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.
2300682	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 34-44MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x46-58MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM.HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.
2300683	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 46-58MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T25 x 14-18MM EN TITANIO.
2300684	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 X 10-20MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T25 x 20-24MM EN TITANIO.
2300685	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25 X 20-	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO x 10-16MM EN TITANIO.

							24MM EN TITANIO	
2300686	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO X 10-16MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25-BLOQUEADO x 18-24MM EN TITANIO
2300687	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25-BLOQUEADO X 18-24MM EN TITANIO	PLACA TUBULAR 3.5MM BLOQUEADA UN TERCIO, 4-6 O x 57-82MM EN TITANIO
2300692	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PARCIALMENTE ROSCADO 4.0 X LONG TORNILLO 34-44MM. LONG ROSCA14-15MM. ACERO INOXIDABLE. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	SUTURA PARA MENISCO: ES UN DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEOO ENDOSCOPICO, INCLUYENDO LAS REPARACIONES DE DESGARROS DE MENISCOS. CONSTA DE DOS IMPLANTES FABRICADOS DEL POLIMERO PEEK-OPTIMA, N2 -0 SUTURA FIBERWIRE (UHMWPE) DOS ARPONES DE INSERCION, UN DISPOSITIVO DE INSERCION MANUAL Y UN RETENEDOR DE PROFUNDIDAD. INDICACIONE S: REPARAR LOS DESGARROS DE MENISCOS CON LA TECNICA DE SUTURA ARTROSCOPICA TODO-ADENTRO. VIDA UTIL 5 AÑOS.
2300694	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 X 23-28MM. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY (L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICA	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE. CARACTERISTICAS: ESPESOR 0.6mm LONGITUD 15mm, ANCHO 6MM. EN ACERO.
2300702	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO

							ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO	
2300703	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO
2300704	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO
2300705	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO

2300706	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO
2300707	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO
2300708	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO
2300709	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD,	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO

							ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	
2300710	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFERO CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAGO STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	PLACA PARA PIE RECTA DE 2-7 ORIFICIOS EN TITANIO, DEFECHA E IZQUIERDA
2300746	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 26-28mm. ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 29-31mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300747	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 29-31mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 32-34mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300748	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 35-37mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 32-34mm ACERO INOXIDABLE	
2300749	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 35-37mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 38-40mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300750	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 38-40mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 41-43mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300751	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 41-43mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 44-46mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300752	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 47-49mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 44-46mm ACERO INOXIDABLE	
2300753	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 47-49mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 50-52mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300754	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 50-52mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 53-55mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300755	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 53-55mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 56-58mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300756	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 59-60mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 56-58mm ACERO INOXIDABLE	
2300757	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 59-60mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 61-63mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300758	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 61-63mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 64-66mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300759	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 64-66mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 67-69mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300760	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 70-72mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 67-69mm ACERO INOXIDABLE	
2300761	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 70-72mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 73-75mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300762	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 73-75mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 76-78mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300763	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 76-78mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 82-84mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300764	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 83-85mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 82-84mm ACERO INOXIDABLE	
2300765	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 83-85mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 86-88mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300766	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 86-88mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 89-91mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300767	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 89-91mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 92-94mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300768	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 95-97mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR

							4.5mm, LONGITUD DESDE 92-94mm ACERO INOXIDABLE	
2300769	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 95-97mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 98-100mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADOFEMUR
2300770	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 98-100mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 1.5mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO
2300771	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 1.5mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 1.5mm, LONGITUD 4-7mm EN ACERO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CABEDIAMETRO
2300772	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 1.5mm LONGITUD 4-	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 2.0mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO

							7mm EN ACERO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	
2300773	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 2.0mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 2.0mm, LONGITUD 4-7mm EN ACERO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CABEDIAMETRO
2300774	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 2.0mm LONGITUD 4-7mm EN ACERO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300775	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm ACERO INOXIDABLE	ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3mm. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO Y CORTE DE TEJDOS BLANDOS, HEMOSTASIA DE VASOS SANGUINEOS, DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ARTROSCOPICOS. OFRECE ENERGIA DE RADIOFRECUENCIA

2300782	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME. EN TITANIO	MATRIZ OSEA EN CUBOS O FRAGMENTOS DE ESPONJOSA. COMPUESTO BIOLOGICO. TEMP2°-30°C. FRASCO 5ML CON CUBOS O FRAGMENTOS HUESO ESPONJOSOOSEA
2300805	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300806	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300807	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL

2300808	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300809	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300810	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300811	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL

2300812	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
2300813	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 6mm-8mm LARGO 25mm, DE ROSCA INVERSA (RI). PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSOR	CUCHILLA SHAVER 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.5mm. INCISOR. COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE, CENTRO MOLDEADO EN POLICARBONATO, SELLO DE SILICONA. INDICACION: RESECCION DE TEJIDOS BLANDOS Y OSEOS EN CAVIDADES ARTICULARES PEQUEÑAS, GRANDES Y CIRUGIA ENDOSCOP ICA FUNCIONAL DE SINUS (FESS). ESTERILIZADAS CON OXIDO DE ETILENO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2300815	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0-6.0, LONGITUD TOTAL 60-175MM, LONGITUD DE LA ROSCA 20-40MM, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0-6.0, LONGITUD TOTAL 60-175MM, LONGITUD DE LA ROSCA 20-40MM, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO
2300822	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA

2300823	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 18MM -30 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTIS
2300824	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-30MM TITANIO	PLACA DE TITANIO CON ESPACIADOR (0-8mm), PARA LA ESTABILIZACION DEOSTEOTOMIAS DE LA BASE METATARSIANA, APTAS PARA LA B.O.W. ARTRODESIS DE APERTURA EN HALLUX VALGUS. INDICADO PARA LA CORRECCION DEL ANGULO METATARSIANO
2300845	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300846	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

2300847	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300848	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300849	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300850	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300851	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 25-30mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 25-30mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300852	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 31-36mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 31-36mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300853	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300854	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300855	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300856	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300857	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

2300858	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300859	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300860	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300861	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300862	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300863	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300864	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300865	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 41-45mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							LONGITUD 41-45mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300866	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 46-50mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.5mm LONGITUD 46-50mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300867	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300868	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

2300869	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300870	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300871	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300872	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300873	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 41-45mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 41-45mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300874	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 46-50mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 4.0mm LONGITUD 46-50mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION CON CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300875	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300876	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300877	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300878	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 25-30mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2.5mm LONGITUD 25-30mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300879	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 2-5mm LONGITUD 31-36mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 31-36mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

2300880	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 10-14mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300881	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 15-19mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300882	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 20-24mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300883	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 25-29mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS

							COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	
2300884	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 30-34mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300885	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADO	TORNILLO CANULADO PEQUEÑO DIAMETRO (Ø) 3.0mm LONGITUD 35-40mm EN ALEACION DE TITANIO, DE COMPRESION SIN CABEZA. PARCIALMENTE ROSCADOFRACTURAS
2300886	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 4.0-4.1mm, LONG 16mm-18mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. ESTANDAR	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 4.0-4.1mm, LONGITUD 16mm-18mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO ESTANDAR
2300887	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 4.0-4.1mm, LONG 20mm-	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 4.0-4.1mm, LONGITUD 20mm-22mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO ESTANDAR

							22mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. ESTANDAR	
2300888	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 4.0-4.1mm, LONG 24mm-26mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. ESTANDAR	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 4.0-4.1mm, LONGITUD 24mm-26mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO ESTANDAR
2300889	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 4.0-4.1mm, LONG 28mm-30mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. ESTANDAR	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 4.0-4.1mm, LONGITUD 28mm-30mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO ESTANDAR
2300890	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 3.5-3.6mm, LONG 16mm-18mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MINI	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 3.5-3.6mm, LONGITUD 16mm-18mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MINI
2300891	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 3.5-3.6mm, LONG 20mm-	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 3.5-3.6mm, LONGITUD 20mm-22mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MINI

							22mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MINI	
2300892	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 3.5-3.6mm, LONG 24mm-26mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MINI	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 3.5-3.6mm, LONGITUD 24mm-26mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MINI
2300893	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 3.5-3.6mm, LONG 28mm-30mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MINI	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 3.5-3.6mm, LONGITUD 28mm-30mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MINI
2300894	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 2.5-2.8mm, LONG 8.0mm-9.0mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MICRO	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 2.5-2.8mm, LONGITUD 8.0mm-9.0mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MICRO

2300895	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 2.5-2.8mm, LONG 10mm-11mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MICRO	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 2.5-2.8mm, LONGITUD 10mm-11mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MICRO
2300896	42321512	ZOST	ZOST-003	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, 2.5-2.8mm, LONG 12mm-14mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANTE. MICRO	TORNILLO CANULADO DE COMPRESION SIN CABEZA, DIAMETRO (?) 2.5-2.8mm, LONGITUD 12mm-14mm, EN TITANIO, TOTALMENTE ROSCADO, AUTOPERFORANDESTORNILADOR HEXAGONAL DE 2.5mm CON UN CABLE GUIA DE 0.054". TORNILLO MICRO

GRUPO REEMPLAZOS ARTICULARES

NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300579	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CABEZA/COPA BIPOLAR 41-50MM ELABORADA EN CROMO (CR) COBALTO(CO) COMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL Y CABEZA DE APOYO	CABEZA/COPA BIPOLAR 52-60mm ELABORADA EN SU PARTE EXTERNA EN CROMO (Cr) COBALTO(Co) DE ALTO BRILLO Y LA PARTE INTERNA EN POLIETILENODE ALTO PESO MOLECULAR, DE FASIL MONTAJE, EXCELENTE INTEGRIDAD DEBLOQUEO, MAXIMA DURABILIDAD DEL POLIETILENOCOMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL Y CABEZA DE APOYO
2300580	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CABEZA BIPOLAR 52-60MM ELABORADA EN	VASTAGO FEMORAL LONGITUD 137-146mm - CABEZA Ø28mm 52-60mm EN CROMO (Cr) COBALTO (Co), CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO

							CROMO (CR) COBALTO(CO) COMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL Y CABEZA DE APOYO	
2300581	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	VASTAGO FEMORAL LONGITUD 137-146MM - CABEZA Ø28MM 52-60MM EN CROMO (CR) COBALTO (CO), CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO	SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO. CONTENIDO: ARANDELA EN TITANIO, ASA AJUSTABLE DE SUTURA Hi Fi HATA 4mm DEL BORDE CORTICAL, FIJACION EXTRACORTICAL. INDICADO PARA FIJACION FEMORAL EN LCA Y LCP. APLICA PARA INJERTO HTH Y SEM ITENDINOSO
2300717	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	COMPONENTE FEMORAL 1-2-3-4-5 EN CROMO COBALTO, DERECHO E IZQUIERDO. RESISTENTE AL DESGASTE, BIOCOMPATIBLE	INSERTO TIBIAL T1-T2-T3-T4-T5 X 9-11-13-14mm, EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. UTILIZADO PARA REMPLAZO TOTAL DE RODILLA
2300718	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	INSERTO TIBIAL T1-T2-T3-T4-T5 X 9-11-13-14MM, EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. UTILIZADO PARA REMPLAZO TOTAL DE RODILLA	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300743	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CABEZA/COPA 28mm-32mm-36mm, -3,5 +0 +3,5 +7 +10 ELABORADA EN	CABEZA/COPA 22mm-28mm, -2.0 -3,0 -8.0, ELABORADA EN CROMO (Cr) COBALTO(Co) COMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL Y CABEZA DE ACADERA

							CROMO (Cr) COBALTO(Co) BIOCOMPATIBLE	
2300744	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CABEZA/COPA 22mm-28mm, -2.0 -3,0 -8.0, ELABORADA EN CROMO (Cr) COBALTO(Co) BIOCOMPATIBLE. IMPLANTE UTILIZADO EN REMPLAZO DE CADERA	VASTAGO FEMORAL DE REVISION DIAMETRO Ø 1-5mm, LONGITUD 145mm-180mm EN CROMO COBALTO, CUELLO CON CONO DE PERFIL REDUCIDO, RANURAS METAXIALES
2300745	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	VASTAGO FEMORAL DE REVISION DIAMETRO Ø 1-5mm, LONGITUD 145mm-180mm EN CROMO COBALTO	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 26-28mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
2300778	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 37-46MM, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110MM. EN ACERO INOXIDABLE	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 37-46mm, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110mm, ANGULO CERVICO-DIAFISARIO 135ARTICULACION)
2300779	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 37-46MM, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110MM. EN ALEACION DE TITANIO	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 47-56mm, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110mm, ANGULO CERVICO-DIAFISARIO 135LA ARTICULACION)

2300780	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 47-56MM, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110MM. EN ACERO INOXIDABLE	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 47-56mm, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110mm, ANGULO CERVICO-DIAFISARIO 135ARTICULACION)
2300781	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 47-56MM, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110MM. EN ALEACION DE TITANIO	TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORTITANIO
2300819	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	COMPONENTE ACETABULAR MODULAR NO CEMENTADO, CON PERFIL HEMISFERICO 01/03 ORICIOS. FABRICADO EN TITANIO PURO NBR	VASTAGO FEMORAL MODULAR NO CEMENTADO DIAMETRO (Ø) 8.0-10.0, LARGO 142-152. FABRICADO EN ALEACION DE TITANIO LIGA 6Al 4V ELI NBR ISO5832-3 o ASTM F-136. USO: EN ARTROPLASTIA PARCIAL O TOTAL DE CADERA, PRIMARIA O DE REVISION. TIENE LA FINALIDAD DE SUSUTITUIR O RESTI TUIR LA ARTICULACION MUSLO-FEMORAL(CADERA), SIENDO UTILIZADA, NECESARIAMENTE, DE MANERA ASOCIADA CON LA CABEZA FEMORAL, NUCLEO ACETA BULAR POLIMÉRICO, DE ACUERDO CON LA INDICACION DE USO
2300820	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	VASTAGO FEMORAL MODULAR NO CEMENTADO DIAMETRO (Ø) 8.0-10.0, LARGO 142-152. FABRICADO EN ALEACION DE TITANIO	EL NUCLEO ACETABULAR NO CEMENTADO- CO-10 MODULAR SE FABRICA EN POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR (UHMW PE)- TIPO 2, CONFORME A LASESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NBR ISO 5834-2 O ASTM F-648. ESTANDAR Y DISPLASICO. USO: ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA, PRIMARIA O REVISION, TENIENDO COMO FINALIDAD LA SUSTITUCION DE LA ARTICULACION COXOFEMORAL(CADERA), SIENDO UTILIZADO, NECESARIAMENTE, DE FORMA ASOCIADA CON EL COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO Y LA CABEZA FEMORAL MODULAR

2300821	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	EL NUCLEO ACETABULAR NO CEMENTADO-CO-10 MODULAR SE FABRICA EN POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR (UHMW PE)-TIPO 2	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA
2300898	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CONDILO/COPA CEMENTADA 50MM CR -CO (CROMO-COBALTO)	CONDILO/COPA CEMENTADA 50mm Cr -Co REF. 52.34-0917
2300899	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	INSERTO PARA COPA DOBLE 28/50MM UHMWPE	INSERTO PARA COPA DOBLE 28/50mm UHMWPE REF. 52.34.0942
2300900	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	VASTAGO ESTANDAR CEMENTADO 10MM ACERO	VASTAGO ESTANDAR CEMENTADO 10mm ACERO REF. 56-11-2001ING
2300901	42321512	ZOST	ZOST-004	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CABEZA FEMORAL Ø EXTERIOR 28MM LONGITUD DEL CUELLO 0MM CO-CR (CROMO - COBALTO)	CABEZA FEMORAL Ø28mm L0mm Co-Cr REF. 2.30.011

GRUPO ARTROSCOPIA

NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300582	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO	TORNILLO CANULADO AUTO-COMPRESIVO Y AUTOPERFORANTE 6.0 MM-L60 MM (1,7MM) EN TITANIO

2300598	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300599	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300600	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300601	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300602	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300603	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA	FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA

							RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	
2300604	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300605	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
2300606	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15° DE ANGULACION EN LA PUNTA, 4 IMPLANTES Y HASTA TRES PUNTOS DE SUTURA.SUTURA
2300607	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15° DE ANGULACION EN LA PUNTA	GUIA CON OJAL, CURVATURA DERECHA E IZQUIERDA CON ANGULACIONES DE 25° A 45° Y NEUTRA. SISTEMA DE SUTURA QUE FACILITA LA INSERCION
2300608	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	GUIA CON OJAL, CURVATURA DERECHA E IZQUIERDA CON ANGULACIONES DE 25° A 45° Y NEUTRA	AGUJA PARA PINZA PASADOR DE SUTURAS

2300609	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA PARA PINZA PASADOR DE SUTURAS	PUNTA RADIOFRECUENCIA ANGULADA 30° DE 130mm LONG X 3.2mm DE DIAMETRO
2300610	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PUNTA RADIOFRECUENCIA ANGULADA 30° DE 130MM LONG X 3.2MM DIAMETRO	CANULA PARA ARTROSCOPIA 5mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES
2300611	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA PARA ARTROSCOPIA 5mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES	CANULA PARA ARTROSCOPIA 7mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES
2300612	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA PARA ARTROSCOPIA 7mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES	CANULA PARA ARTROSCOPIA 8mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES
2300613	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA PARA ARTROSCOPIA 8mm X 85mm. PUERTO DE TRABAJO ROSCADO Y LISO. TRANSPARENTES Y FLEXIBLES	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 5.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIDE CALIDAD
2300614	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO ESPONJOSA 5.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL. PREMONTADO CON DOBLE SUTURA. INDICADO PARA: PARA RRODILLA

							STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	
2300617	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO, Y TAPON)	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO, Y TAPON)
2300618	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO, Y TAPON)	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL)
2300619	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN TITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL)
2300620	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN TITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5mm MEDIAL-DISTAL, TIBIA 6 ORIFICIOS 127mm DERECHA O IZQUIERDA
2300621	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5 MM MEDIAL-DISTAL, TIBIA 6 ORIFICIOS 127MM DERECHA O IZQUIERDA	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO, Y TAPON)
2300622	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO	TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA

2300814	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CUCHILLA SHAVER 3.5MM, 4.0MM, 4.5MM, 5.5MM. INCISOR.COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE. UNIDAD	CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0/6.0, LONGITUD TOTAL 60-175mm, LONGITUD DE LA ROSCA 20-80mm, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. INDICADO PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE RADIO, MANO, FEMUR Y HUMERO
2300841	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA ROSCADA CON OBTURADOR DESECHABLE 8.5MMX72MM. ARTROSCOPIA DE HOMBRO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA ARTROS ROSCADA+OBTURADOR8.5x72mm SISTEMA DE CANULA DESECHABLE EN COPOLIESTER, PARA ARTOSCOPIA DE HOMBRO. CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO. DISEÑO DE TRIPLE SELLADO, CON FIJADOR DE SUTURA, TAPON EXTRAIBLE, NO LATEX. OBTURADOR REUTILIZABLE CON MANGO EN POLIFENILSULFONA Y PUNTA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2300842	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA ROSCADA CON OBTURADOR DESECHABLE 7.0MMX72MM. ARTROSCOPIA DE HOMBRO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA ARTROS ROSCADA+OBTURADOR7.0x72mm SISTEMA DE CANULA DESECHABLE EN COPOLIESTER, PARA ARTOSCOPIA DE HOMBRO. CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO. DISEÑO DE TRIPLE SELLADO, CON FIJADOR DE SUTURA, TAPON EXTRAIBLE, NO LATEX. OBTURADOR REUTILIZABLE CON MANGO EN POLIFENILSULFONA Y PUNTA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL
2300843	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA ROSCADA CON OBTURADOR DESECHABLE 5.0MMX45MM. A5TROSCOPIA DE HOMBRO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA ARTROS ROSCADA+OBTURADOR5.5x45mm SISTEMA DE CANULA DESECHABLE EN COPOLIESTER, PARA ARTOSCOPIA DE HOMBRO. CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO. DISEÑO DE TRIPLE SELLADO, CON FIJADOR DE SUTURA, TAPON EXTRAIBLE, NO LATEX. OBTURADOR REUTILIZABLE CON MANGO EN POLIFENILSULFONA Y PUNTA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL

2300844	42321512	ZOST	ZOST-006	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CANULA ROSCADA CON OBTURADOR DESECHABLE 5.0MMX72MM. A5TROSCOPIA DE HOMBRO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL	CANULA ARTROS ROSCADA+OBTURADOR 5.5x72mm SISTEMA DE CANULA DESECHABLE EN COPOLIESTER, PARA ARTOSCOPIA DE HOMBRO. CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO. DISEÑO DE TRIPLE SELLADO, CON FIJADOR DE SUTURA, TAPON EXTRAIBLE, NO LATEX. OBTURADOR REUTILIZABLE CON MANGO EN POLIFENILSULFONA Y PUNTA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL

GRUPO CLAVOS ENDOMEDULARES

NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300554	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300555	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300556	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE

2300557	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300558	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300559	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 360mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300560	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
2300561	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm.	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-4420mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PAUTORROSCANTE

							EN ALEACION DE TITANIO	
2300562	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300563	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300564	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300565	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300566	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE

							10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO	
2300567	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300568	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 360mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300569	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300570	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 401mm-4420mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
2300571	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm

							SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE TITANIO	
2300576	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TORNILLO/TAPON DE CIERRE EN TITANIO SIN PROLOMGACION (0MM)	TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD
2300577	42321512	ZOST	ZOST-007	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD	CABEZA/COPA BIPOLAR 41-42- 43- 44- 45--46-47-48-49-50mm ELABORADA EN SU PARTE EXTERNA EN CROMO (Cr) COBALTO(Co) DE ALTO BRILLO Y LAPARTE INTERNA EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, DE FASIL MONTAJE, EXCELENTE INTEGRIDAD DEBLOQUEO, MAXIMA DURABILIDAD DEL POLIETI LENOCOMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL Y CABEZA DE APOYO

GRUPO CLAVOS Y AGUJAS

NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300659	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO FEMUR TROCANTERICO-ANTEROGRADO NAVEGADO DIAMETRO (Ø)10-13 LONG X 32-36, ANGULO 1307135°, EN TITANIO (T16AL4V). DER-IZQ	CLAVO FEMUR TROCANTERICO-ANTEROGRADO "NAVEGADO" DIAMETRO (Ø)10-13 LONG X 38-44, ANGULO DEL CUELLO 130°/135°. EN TITANIO (T16AL4V). DERECHO-IZQUIERDO (CODIGO DE COLOR). SECCION TRANSVERSAL REDONDA. GUIA DE PUNTA ESFERICA
2300660	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO FEMUR TROCANTERICO-ANTEROGRADO	PLACA VLP 3.5MM CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO DISTAL EN TITANIO, 3-5 ORIFICIOS, LONG 47-72MM. TORNILLO DE BLOQUEO Y

							NAVEGADO DIAMETRO (Ø)10-13 LONG X 38-44, ANGULO 1307135°, EN TITANIO (T16AL4V). DER-IZQ	ESTANDAR 3.5MM. AGUJEROS QUE PERMITAN COMPRESION Y BLOQUEO. DERECHO-IZQUIERDO
2300719	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300720	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300721	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300722	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO,	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO -TROCANTE MENOR

							DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	
2300723	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300724	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300725	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300726	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO,	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR

							DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	
2300727	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 421mm-440mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300728	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 421mm-440mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 441mm-460mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300729	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 441mm-460mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 461mm-480mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300730	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO,	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR

							DIAMETRO DE 9.0mm-10.0mm, LONGITUD 461mm-480mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	
2300731	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300732	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300733	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300734	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO,	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR

							DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	
2300735	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300736	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300737	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300738	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO,	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR

							DIAMETRO DE11.0mm-12.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	
2300739	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 421mm-440mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300740	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 421mm-440mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 441mm-460mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR
2300741	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 441mm-460mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 461mm-480mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO - TROCANTE MENOR

2300742	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR SOLIDO, DIAMETRO DE 11.0mm-12.0mm, LONGITUD 461mm-480mm. EN ALEACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CABEZA/COPA 28mm-32mm-36mm, -3,5 +0 +3,5 +7 +10, ELABORADA EN CROMO (Cr) COBALTO(Co) COMPATIBLE CON CUALQUIER COMPONENTE FEMORAL YCADERA
2300777	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	COMPONENTE TIBIAL 1-2-3-4-5 EN CROMO COBALTO. COBERTURA TIBIAL OPTIMA SIN COMPROMETER LA CONGRUENCIA ARTICULAR	PROTESIS DE THOMPSON DIAMETRO DE LA CABEZA MONOPOLAR Ø 37-46mm, LONGITUD DEL VASTAGO (ESTANDAR) 110mm, ANGULO CERVICO-DIAFISARIO 135LA ARTICULACION)
2300784	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO
2300785	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO
2300786	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO

							TROCAR, EN ACERO	
2300787	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO
2300788	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO
2300789	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO
2300790	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO
2300791	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO

2300792	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO
2300793	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO
2300794	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO
2300795	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-70mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO
2300796	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-70mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO
2300797	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO

2300798	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO
2300799	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 100-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN TITANIO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 70/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO
2300800	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 70/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO
2300801	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO
2300802	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO
2300803	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-	AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO

							200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	
2300804	42321512	ZOST	ZOST-008	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). EST ERIL

GRUPO VARIOS Y ACCESORIOS

NUMERO DE MATERIAL	CÓDIGO UNSPSC	TIPO DE MATERIAL	GRUPO DE ARTICULOS	SUB-GRUPO DE ARTICULOS	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	NOMBRE DEL MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
2300615	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL.	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7mm. INDICADO PARA: INESTABILIDAD DE HOMBRO, CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO, CIRUGIA DE CODO
2300616	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7 mm	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO, Y TAPON)
2300624	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE TODO SUTURA 1.7MM. CON UNA SUTURA N° 2. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION.	ANCLAJE TODO SUTURA 1.9mm. CON DOS SUTURA N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO, REPARACION DE INESTABILIDAD
2300625	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE TODO SUTURA 1.9MM. CON DOS SUTURAS N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO

							DISPOSITIVO DE INSERCION.	
2300663	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 4.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2)	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5mm. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2). PUNTA DE SILLIN CUBIERTA. FABRICADO CON MATERIAL POLIETERETERCETONAS (PEEK), CON O SIN AGUJAS. REF CFP-5502
2300664	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2)	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO
2300672	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE CON SUTURA NO REABSORBIBLE , CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION EN TITANIO	ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 "POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-, TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: PROCEDIMIENTOS DE HOMBRO ARTROSCOPICOS O MINI ABIERTOS
2300673	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-,	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3,5MM X LONGITUD 108-160MM 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE. INDICACION: FIJACION DE FRACTURAS, ARTRODESIS, RECONSTRUCCION, REIMPLANTACION O REDUCCION DE HUESOS PEQUEÑOS Y FRAGMENTOS OSEOS PEQUEÑO S. IZQUIERDA-DRECHA.

							TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDAB	
2300693	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	SUTURA PARA MENISCO Nº2-0 DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEO	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 x 23-28mm. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY (L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICACIION: SEGUN CRITERIO MEDICO. ESTERIL. PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD
2300695	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE . CARACTERISTICAS: ESPESOR 0.6MM LONGITUD 15MM, ANCHO 6MM. EN ACERO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 25mm ANCHO 6mm. EN ACERO.
2300696	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE , ESPESOR 0.6MM LONGITUD 25MM ANCHO 6MM. EN ACERO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF AR-300-052S HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO
2300697	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE , ESPESOR 0.6MM LONGITUD 40MM ANCHO 6MM. EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 6 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO
2300698	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 6 MM	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO

							GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	
2300699	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO
2300700	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO
2300701	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO
2300714	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	DISPOSITIVO DE FIJACION CORTICAL - ARANDELA EN TITANIO, ASA	ANCLAJE OSEO DE SUTURA Hi Fi DIAMETRO (Ø) 1.3mm. 360° FORMFIT. INDICADO PARA: INESTABILIDAD DE HOMBRO, DE CADERA. CIRUGIA DE PIES YTOBILLO. CIRUGIA DE CODO

							(LOOP) DE SUTURA HI FI DE 15MM, 20MM	
2300715	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE OSEO DE SUTURA HI FI DIAMETRO (Ø) 1.3MM. 360° FORMFIT	PLACA 3.5mm BLQUEADA CLAVICULA SUPERIOR MEDIA 6-7 ORIFICIOS - LONGITUD 73-85mm. DERECHA E IZQUIERDA. EN TITANIO
2300776	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3MM. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO, CORTE DE TEJDOS BLANDOS	COMPONENTE TIBIAL 1-2-3-4-5 EN CROMO COBALTO. COBERTURA TIBIAL OPTIMA SIN COMPROMETER LA CONGRUENCIA ARTICULAR
2300829	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.1mm DE DIAMETRO (Ø), ROSCADO, BIOCOMPUESTO + SUTURA N° 2, DE 1 HILO, EN POLIETILENO (PE), NO ABSORBIBLE, LONGITU	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.1 DE DIAMETRO, ROSCADO, DE MATERIAL BIOCOMPUESTO, CON CRECIMIENTO INTERSTICIAL Y RESISTENCIA A LA TRACCION.INSERCION RAPIDA, IMPACTADO EN DOS PASOS, MONTAJE CON INJERTADOR DESECHABLE. USO: REPARACION DEL MANGUITO ROTADOR, REVISION, RECONSTn p212
2300830	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.1mm DE DIAMETRO (Ø), ROSCADO, BIOCOMPUESTO+SUTURA N°0,2 HILOS, EN POLIETILENO(PE), NO ABSORBIBLE, LONG 3.5m	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.6 DE DIAMETRO, ROSCADO, DE MATERIAL BIOCOMPUESTO, CON CRECIMIENTO INTERSTICIAL Y RESISTENCIA A LA TRACCION.RAPIDA, IMPACTADO EN DOS PASOS, MONTAJE CON INJERTADOR DESECHABLE. USO: REPARACION DEL MANGUITO ROTADOR, REVISION, RECONSTRUCCION CAn p261
2300831	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.6mm DE	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.6 DE DIAMETRO, ROSCADO, DE MATERIAL BIOCOMPUESTO, CON CRECIMIENTO INTERSTICIAL Y RESISTENCIA A LA

							DIAMETRO (Ø), ROSCADO, BIOCOMPUESTO + SUTURA N° 2, DE 2 HILOS, EN POLIETILENO (PE), NO ABSORBIBLE, LONGIT	TRACCION.RAPIDA, IMPACTADO EN DOS PASOS, MONTAJE CON INJERTADOR DESECHABLE. USO: REPARACION DEL MANGUITO ROTADOR, REVISION, RECONSTRUCCION CAn p262
2300832	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE SUTURA N° 2.6mm DE DIAMETRO (Ø), ROSCADO, BIOCOMPUESTO+SUTURA N°1,2 HILOS, EN POLIETILENO(PE), NO ABSORBIBLE, LONG 4m	PLACA GANCHO RECTA 2.0mm, LONG 2.0-38mm, 5-7 ORIFICIOS, EN ACERO INOXIDABLE 316L. PLACA DE BAJO PERFIL (1.2MM), ANGULO VARIABLE, DISTANCIA ENTRE LOS ORIFICIOS 5mm. DISEÑADAS PARA FIJAR FRAGMENTOS OSEOS DE PORCIONES DISTALES. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2300836	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	DISPOSITIVO DE FIJACION CORTICAL AJUSTABLE, TITANIO,14X4.5 X2MM, DISEÑADO PARA USO INJERTO DE TEJIDO BLANDO (ALB)	DISPOSITIVO DE FIJACION CORTICAL AJUSTABLE. ARANDELA/BOTON EN TITANIO. DIMENSIONES: 14mm x 4.5mm X 2 mm. SUTURA DE BUCLE AJUSTABLE Hi Fi DE 5 (RAYAS BLANCAS/AZULES), SUTURA INICIAL Hi-Fi N° 5 (AZUL SOLIDO). INDICADO FIJACION FEMORAL (EN TEJIDOS BLANDOS) EN LA REC ONSTRUCCION LCA Y REPARACION BICEPS DISTAL. REFERENCIA: KS-BTB DISEÑADO PARA USO CON INJERTO DE BLOQUE ÓSEO O DE TEJIDO BLANDO DEBU CLE CERRADO
2300837	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	DISPOSITIVO DE FIJACION CORTICAL AJUSTABLE, TITANIO,14X4.5 X2MM, DISEÑADO PARA USO CON INJERTO DE BLOQUE ÓSEO	DISPOSITIVO DE FIJACION CORTICAL AJUSTABLE, TITANIO,14X4.5X2MM, DISEÑADO PARA USO CON INJERTO DE BLOQUE ÓSEO
2300838	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TERMINAL DE CORTE DESECHABLE 5.5MM, CON AFILADO	TERMINAL DE CORTE DESECHABLE 5.5mm, CON AFILADO PRECISO Y DISEÑO DIENTE A DIENTE. ACABADO DE CUCHILLA QUE REDUCE LA FRICCION EVITANDO EL DESGASTE. INDICADO PARA LA RESECCION DE TEJIDO EN

							PRECISO Y DISEÑO DIENTE A DIENTE	PROCEDIMIENTOS COMP0LEJOS DE RECOSNTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR YMENISECTOMIA.
2300839	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	TERMINAL DE CORTE DESECHABLE 4.5MM, CON AFILADO PRECISO Y DISEÑO DIENTE A DIENTE	TERMINAL DE CORTE DESECHABLE 4.5mm, CON AFILADO PRECISO Y DISEÑO DIENTE A DIENTE. ACABADO DE CUCHILLA QUE REDUCE LA FRICCION EVITANDO EL DESGASTE. INDICADO PARA LA RESECCION DE TEJIDO EN PROCEDIMIENTOS COMP0LEJOS DE RECOSNTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR YMENISECTOMIA.
2300897	42321512	ZOST	ZOST-012	N/A	C/U	A-02-01-01-004-008	ANCLAJE DE SUTURA DE TITANIO FT 5mm X 18mm (LONGITUD) CON. DOS SUTURAS N°2 EXTERNO 5mm, COMPLETAMENTE ROSCADOS, AUTOPERFORANTES	ANCLAJE DE SUTURA DE TITANIO FT 5mm X 18mm (LONGITUD) CON DOS SUTURAS N° 2 DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. DIAMETRO EXTERAUTOPERFORANTES

Nota aclaratoria sobre los rubros presupuestales: Se proyecta la realización de mesas de trabajo durante la vigencia 2026, en coordinación con la DIGSA, JEFSA, DISAN EJC Y DISAN ARC, con el fin de avanzar en la unificación de los rubros presupuestales y establecer parámetros claros para las Subunidades Ejecutoras en el momento de determinar la imputación presupuestal.

Es importante precisar que los rubros considerados hasta la fecha corresponden únicamente, a un ejercicio preliminar y no deben entenderse como definitivos. La asignación del rubro presupuestal, conforme a normativa vigente y al Catálogo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permanece bajo la competencia y responsabilidad de cada Subunidad Ejecutora hasta tanto se formalice la unificación mencionada.

Numeral 5: Capacitación y Sensibilización

En el marco del proceso de fortalecimiento de la gestión de dispositivos médicos y con el propósito de garantizar la adecuada socialización del Catálogo de éstos entre el personal asistencial y administrativo del SSFM, se implementará un plan de capacitación estructurado que contempla las siguientes acciones estratégicas:

Desarrollo e implementación de jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes niveles del personal asistencial y administrativo, mediante sesiones presenciales y virtuales, asegurando la accesibilidad a la información, tener una adecuada apropiación del catálogo y así contribuir a la eficiencia operativa, mejora de la atención al paciente y el cumplimiento normativo, entre otros beneficios.

La capacitación se realizará por una herramienta informática que será asignada por la DIGSA de acuerdo con cronograma establecido para el 2026.

- ✓ Puede acceder a las materias y contenidos digitales.
- ✓ Puede subir tar4eas y trabajos.
- ✓ Realizar exámenes en línea.
- ✓ Participar en foros y clases virtuales.
- ✓ Consultar calendario académico.
- ✓ Ver calificaciones y avances.

Numeral 6: Mantenimiento y actualización

El catálogo será actualizado una vez al año, en reunión con personal de todas las fuerzas tanto para crear como para bloquear materiales por cambio de tecnología. La actualización y auditoria de los datos será realizada por personal asignado por la Dirección General de Sanidad Militar, la cual enviará al SILOG para su creación.

Numeral 7: Implementación de herramientas tecnológicas

Elaboración y distribución de material pedagógico, incluyendo manuales de consulta, infografías y presentaciones institucionales, desarrollo de los temas de capacitación incluyendo evaluaciones, talleres y poderlos subir a la herramienta informática designada para tal fin, para que el material esté disponible para la capacitación individual con el fin de facilitar la apropiación del catálogo.

Herramientas de visualización: Se proyecta implementar una herramienta que permita visualizar de manera amigable y práctica el catálogo, dicha herramienta será suministrada a los diferentes actores interesados, para que sirva de consulta referente a las especificaciones técnicas desde la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, estructuración de contratos, hasta los movimientos logísticos y salidas a usuarios.

Para la construcción de la herramienta de visualización de consulta por parte de los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar (ESM), se adaptará una hoja de cálculo denominada como "Archivo Catálogo", donde se realiza la descripción de cada insumo con su respectiva descripción técnica y código interno como se muestra a continuación:

Imagen 5. Muestra - Estructura del Catálogo de Dispositivos Médicos S+-SFM

Número de Material	Código UNSPSC	Tipo de Material	Grupo de Artículos	Sub Grupo de Artículos	Unidad de Medida	Nombre del Material	Especificaciones Técnicas	Retiro pre-seguridad
2584591	42251701	ZMDE	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	COBIJADOR PELVICO PARA SILLAS DE RUEDAS-ARNES PELVICO ELABORADO EN POLIESTER SEMIRIGIDO CON INTERIOR ACOLCHADO BAJO FORMULA MEDICA	COBIJADOR PELVICO PARA SILLAS DE RUEDAS-ARNES PELVICO ELABORADO EN POLIESTER SEMIRIGIDO CON INTERIOR ACOLCHADO QUE BRINDE COMODIDAD AL PACIENTE CON BANDA REFLECTIVA EN LOS BORDES BRINDANDO SEGURIDAD Y COMODIDAD AL PACIENTE MEDIANTE CORREAS DE SUJECION AJUSTABLES Y CIERRE CON HEBILLAS DE PRESION BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-001
2584539	42241502	ZMDX	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	COJIN AMORTIGUADOR DE CADERA ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DISEÑO ANATOMICO BAJO FORMULA MEDICA	COJIN ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DISEÑO ANATOMICO CON CANALES LATERALES QUE PERMITA POSICIONAR LAS PIERNAS FORMA IMPERMEABLE Y CORREAS DE SUJECION CONVELCRO QUE PERMITA MANTENER LA CADERA EN ABDUCCION BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-002
2584538	42251817	ZMDX	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	COJIN DE ALIVIO DE PRESION HIDROCELULAR PERFIL ALTO ELABORADO EN NEOPRENO POLIURETANO ALTURA DE LA CELDA 10 cm BAJO FORMULA MEDICA	ELABORADO EN NEOPRENO POLIURETANO ALTURA DE LA CELDA DE 10 cm 4 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES VALVULA REGULADORA INCLUYE FUNDA TRANSPIRABLE Y REMOVIBLE DE FACIL LAVADO ANCHO DE 30-50 cm IE 6 CELDAS ANCHO DE 30-50cm 30-50cm BOMBA DE INFLADO NEUMATICO AJUSTABLE A LA MEDIDA DE LA SILLA DE RUEDAS DEL PACIENTE INCLUYE MANUAL DE INSTRUCCIONES BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-003
2582516	42251817	ZMDX	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	COJIN DE ALIVIO DE PRESION DE MEDINA DENSIDAD ELABORADO EN ESPUMA DE MEDINA DENSIDAD BAJO FORMULA MEDICA	COJIN ELABORADO EN ESPUMA DE MEDINA DENSIDAD-CONFORMADO LATERAL Y PREGLUTEAL MEDIDAS DE 40x40 cm SOPORTA PESO HASTA DE 80 kg FORRO IMPERMEABLE CON CIERRE DE CREMALLERA BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-004
2583618	42251817	ZMDX	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	COJIN DE ALIVIO DE PRESION EN SILICONA ELABORADO EN MATERIAL VISCOELASTICO CUADRADO CON UNA FUNDA EXTERIOR REMOVIBLE BAJO FORMULA MEDICA	COJIN PARA ALIVIO DE PRESION VISCOELASTICO CUADRADO EN GEL DE SILICONA BLANDO DE FLOTACION LIQUIDA CON UNA FUNDA EXTERIOR REMOVIBLE LAVABLE ANTIDESLIZANTE PESO MAXIMO DE SOPORTE DE 113kg AJUSTABLE A LA MEDIDA DE LA SILLA DE RUEDAS BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-005
2582476	42251817	ZMDX	ZMDX-001	ZMDX-001-2	CIU	ELABORADO EN NEOPRENO POLIURETANO ALTURA DE LA CELDA 5 CM 4 COMPARTIMENTOS VALVULA REGULADORA FORRO ELASTICO REMOVIBLE DE FACIL LAVADO BOMBA EXTERIOR Y PARCHES DE REPUESTO A LA MEDIDA DE LA SILLA DEL PACIENTE	COJIN ELABORADO EN NEOPRENO POLIURETANO FUNDA TRANSPIRABLE ELASTICA REMOVIBLE DE FACIL LAVADO ALTURA 5 cm CUENTA CON 4 COMPARTIMENTOS VALVULA REGULADORA BOMBA DE INFLADO NEUMATICO AJUSTABLE A LA MEDIDA DE LA SILLA DE RUEDAS INCLUYE MANUAL DE INSTRUCCIONES BAJO FORMULA MEDICA	A-02-01-01-004-006

Fuente: Elaboración propia GRUGI – 2025

9.4. Uso de Marcas Comerciales en la Contratación Estatal

Según el Decreto 1082 de 2015 (compilatorio del Decreto 1510 de 2013), artículo 2.2.1.1.2.2.2, se establece que:

"Las entidades estatales no podrán incluir en los pliegos de condiciones, invitaciones o demás documentos del proceso de contratación, la referencia a una marca, patente o tipo particular, salvo que no exista una forma suficientemente precisa o inteligible de describir el objeto del contrato."

Excepciones permitidas:

Sí, se puede mencionar una marca únicamente cuando sea técnicamente necesario. Por ejemplo:

- ✓ Cuando no exista un estándar técnico equivalente.
- ✓ Cuando sea necesario garantizar la compatibilidad con equipos, sistemas o infraestructura existente.
- ✓ Cuando se trate de repuestos o consumibles exclusivos de una marca específica.

En esos casos, se debe justificar técnica y objetivamente por escrito en los estudios previos o en el documento técnico del proceso. Además, se debe agregar la expresión: "o su equivalente técnico" para mantener abierta la posibilidad de que se presenten productos equivalentes que cumplan las mismas especificaciones o estándares.

Marcas que se han encontrado en los contratos del SSFM:

- ✓ Hydrofiber - (Hidrofibra) es una marca registrada, utilizada principalmente por la empresa Convatec para describir sus apósitos para heridas. Estos productos utilizan una tecnología de Hidrofibra que retiene la humedad y forma un gel al contacto con el exudado de la herida, promoviendo un ambiente de cicatrización húmedo.
- ✓ Orthoplast®: Nombre de un material termoplástico, utilizado en la elaboración de dispositivos médicos de rehabilitación. Los termoplásticos son polímeros que se ablandan al calentarse y se endurecen al enfriarse, ejemplos de termoplásticos el Tereftalato de polietileno (PET), Polietileno de alta densidad (HDPE), Cloruro de Polivinilo (PVC), entre otros.
- ✓ "Nylon" fue originalmente una marca registrada por DuPont, Pero según la RAE, las formas correctas para el material en español son "nailon" y "nilón". Se recomienda evitar la grafía "nylon" para evitar confusión con el término de la marca registrada original.
- ✓ "Neopreno" es una marca registrada de DuPont para un caucho sintético basado en el policloropreno. Sin embargo, debido a su gran popularidad, se ha convertido en un nombre genérico para el material en sí, por lo que se utiliza comúnmente en minúscula para referirse al material en general, en un proceso conocido como vulgarización de marca.
- ✓ VELCRO® es una marca registrada propiedad de la empresa Velcro Companies, que necesita ser utilizada correctamente para proteger la marca. El término genérico para el producto es "cierre de gancho y bucle", ya que "velcro" se refiere específicamente a los cierres fabricados por esta compañía.
- ✓ Sting-kill es la marca de unos hisopos anestésicos de primeros auxilios, alivio instantáneo del dolor y la picazón de las picaduras de abejas y picaduras de insectos.
- ✓ Stomahesive es una marca registrada, propiedad de la empresa ConvaTec, y se refiere a una línea de productos médicos, especialmente barreras cutáneas y adhesivos para estomas.

10. BIBLIOGRAFÍA

Congreso de la República de Colombia. (16 de febrero de 2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015. Colombia.

Consultorsalud SAS. (6 de marzo de 2018). Codificación para los Dispositivos Médicos y Estándares semánticos.

Obtenido de https://consultorsalud.com/codificacion-para-los-dispositivos-medicos-y-estandares-semanticos/

Coursera Staff. (3 de diciembre de 2024). ¿Qué es la granularidad de datos? Definición, tipos y más. Obtenido de https://www.coursera.org/articles/data-granularity

Invima. (febrero de 2024). Manual del Usuario para el estandar semantico y codificación de dispositivos medicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/estandar-semantico/reporte-estandar/Manual%20de%20usuario%20para%20reporte%20de%20estandar%20semantico%20y%20codificaci%C3%B3n%20DM%20y%

Marcelo, d. (19 de febrero de 2024). La granularidad: la clave para elegir un modelo de base de datos. Obtenido de https://www.obsbusiness.school/blog/la-granularidad-la-clave-para-elegir-un-modelo-de-base-de-datos

Ministerio de la Protección Social. (26 de diciembre de 2005). Decreto Número 4725 de 2005. Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social. (11 de julio de 2013). Resolución Número 2535 de 2013. Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD. (abril de 2018). Interoperabilidad Semántica. Obtenido de Estandár Semántico para los Dispositivos Médicos: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/diseno-estandares-semanticos.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.). Estandarización Semántica y Codificación de Dispositivos Médicos. Obtenido de medicos.aspx#: ~:text=Finalmente%20la%20Resoluci%C3%B3n%202535%20de, los%20insumos%20y%20dispositivos%20m%C3%A9dicos

Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud. (2019). Estándar semántico y codificación de dispositivos médicos de uso humano IDM. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/estandar-semantico-codificacion-dispositivos-medicos-humano-idm.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.). Estándares para la Interoperabilidad en Salud. Interoperabilidad Semántica.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/4%20Interoperabilidad%20SEMANTICA_MSPS.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud. (10 de julio de 2019). ABECÉ Interoperabilidad de Datos de la Historia Clínica. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/ihc/Documentos%20compartidos/ABC-IHC.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud. (Julio del 2014). Interoperabilidad semántica- Estándar semántico para los dispositivos médicos. I Fase: etapa Diseño. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/diseno-estandares-semanticos.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (08 de febrero de 2024). Resolución Número 184 de 2024. Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social (11 de julio de 2013). Resolución Número 2535 de 2013. Colombia. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2535-de-2013.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.). Política de dispositivos médicos en Colombia. Obtenido de https://andi.com.co/Uploads/Aurelio%20Mejia.pdf

Morchón A., Pedernera F., Otero P., Costa G., López Noguerol M., Martínez M., . . . González Bernaldo de Quirós F. (s.f.). Desarrollo de un vocabulario para dispositivos médicos. Obtenido de Departamento de Información Hospitalaria. Hospital Italiano de Buenos Aires: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/servicios_attachs/2644.pdf

Organización Panamericana de la Salud, & Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Dispositivos Médicos. Obtenido de https://www.paho.org/es/temas/dispositivos-medicos

Organización Panamericana de la Salud, & Organización Mundial de la Salud. (2022). Elementos de datos comunes para la identificación de dispositivos médicos. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56256/OPSHSSMT220026_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11.ANEXOS

Anexo 1. Directiva Permanente No. 0121001353602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-ARSAP-23.1.

Anexo 2. Business Blueprint (BBP) "PROCESO DATOS MAESTROS MATERIALES Y SERVICIOS" con fecha 27 abril del 2009.

Anexo 3. Resolución 1405 del 2022 "por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación de los dispositivos Médicos de uso humano reactivos de diagnóstico in vitro".

Anexo 4. Resolución 184 de 2024 "por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos".

DIRECTIVA PERMANENTE

Radicado No 0121001353602 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-ARSAP-23.1

Bogotá D.C., Bogotá 10 Febrero 2021

ASUNTO : Estandarización Técnica de Botiquines M1, M3, M4 y M5.

PARA : Director de Sanidad Ejército Nacional, Director de Sanidad Naval, Jefe de Salud de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad.

I. OBJETO Y ALCANCE

A. Finalidad

Actualizar el contenido de los Botiquines M1, M3, M4 y M5, determinando la lista de insumos, medicamentos y dispositivos médicos, según el perfil de habilidades y competencias de los responsables de su uso.

B. Referencias

1. Ley 352 de 1997 *"Por la cual de reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional". Artículo 25. SALUD OPERACIONAL- Entiéndase por Salud Operacional las actividades en salud inherentes a las operaciones militares y las actividades de salud especializada que tienen por objeto el mantenimiento y la recuperación de la aptitud psicofisica especial, que deben tener en todo tiempo los efectivos de las Fuerzas Militares y Policiales para desempeñarse con seguridad y eficiencia en las actividades propias de cada Fuerza, incluyendo entre otras sanidad en campaña, medicina naval y medicina de aviación.*

   PARAGRAFO: Los Directores de Sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispondrán de la infraestructura administrativa en cuanto a los medios, organización, funcionamiento y disponibilidad para una inmediata atención del personal de que trata este Artículo ley.

2. Ley 1164 del 03 de Octubre de 2007, *"Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud.*

3. Ley 1831 del 02 mayo 2017 "P*or medio de la cual se regula el uso del desfibrilador externo automático (DEA).*

4. Decreto ley 1795 de 2000 *"Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional" Articulo 13. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, Literal o) Coordinar las acciones del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en apoyo logístico a las operaciones Militares.*

5. Decreto 1465 del 13 de agosto de 2019 "*Por el cual se adiciona el titulo 13 a la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en relación con los Desfibriladores Externos automáticos".* Título 13 – DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, Artículo 2.8.13.3 – Ruta vital para la atención a las víctimas de paro cardiorrespiratorio. Con el propósito de garantizar la respuesta de los servicios de salud en los ámbitos prehospitalario y hospitalario en el marco del Sistema de Emergencias Médicas – SEM, el uso del Desfibrilador Externo Automático - DEA, requiere la disponibilidad de la cadena de supervivencia.

6. Resolución 0003316 del 6 diciembre de 2019, *"Por el cual se establecen disposiciones para el uso del Desfibrilador Externo Automático - DEA"*- Anexo técnico No. 1 – Lineamientos para la operación, uso y dotación del Desfibrilador Externo Automático – DEA.

7. Resolución 0322 del 11 de marzo de 2020 - Grupos Internos DIGSA, *"Por la cual se crean y organizan Grupos Internos de trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar y se les asignan funciones" AREA SALUD OPERACIONAL, 1. Formular lineamientos en salud operacional del personal militar y aquellas propias del servicio militar. -2. Efectuar el análisis de la información disponible en salud operacional con el fin de implementar planes, programas o proyectos que permitan gestionar y mitigar los riesgos en salud, en articulación con el modelo de atención integral en salud. -12. Realizar asesoría y asistencia técnica a las fuerzas militares en la implementación, ejecución y evaluación de los programas de salud operacional.*

8. Acuerdo 060 de 2015, aprobado por el Consejo Superior de Salud el 25 de marzo de 2015. "Por el cual se establecen las políticas, estrategias y planes en salud como apoyo al cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares y se determinan los lineamientos para el desarrollo del Programa de Salud Operacional de las Fuerzas Militares" ARTÍCULO 6.- LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OPERACIONAL. Para la implementación y desarrollo del Programa de Salud Operacional se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos... 3. Logística Médica: *Es el conjunto de medios, métodos y elementos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las tareas relacionadas con la salud operacional.* ARTICULO 7.- ESTRATEGIAS DE SALUD OPERACIONAL,

9. Norma técnica NTMD 0311 2010-12-15 "Botiquín de primeros auxilios de tipo M3"

10. Cartilla perfiles y competencias profesionales en salud "*Profesiones, un aporte al cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades." 2016* - Ministerio de Salud.

11. Manual de instructores de Socorristas Militares aprobado mediante la Resolución No. 0952 del 21 de Julio de 2018, expedida por la Dirección General de Sanidad Militar.

C. Vigencia

"A partir de la fecha de su expedición y hasta su actualización", La presente Directiva deroga la Directiva permanente 020 Radicado 378476 de 2014 "Estandarización Técnica de Botiquines M1, M3, M4 Y M5.

II. INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta la experiencia en cuanto al uso de los botiquines M1, M3, M4 y M5, es necesario realizar un lineamiento actualizado, que permita estandarizar los contenidos de los botiquines, con el fin de contar con los elementos necesarios para brindar una atención en salud oportuna en el teatro de operaciones de acuerdo con las políticas normativas vigentes en salud operacional.

A. Antecedentes

Se realiza la verificación normativa vigente, el levantamiento de información de Inteligencia Médica estratégica y táctica, y las mesas de trabajo correspondientes , con el fin de contar con suficientes elementos de juicio que permitieron realizar el proceso de actualización a la " Estandarización Técnica de Botiquines M1, M3, M4 y M5", teniendo en cuenta el concepto técnico del personal que hace uso de los botiquines militares y con la participación de los coordinadores y funcionarios de Salud Operacional de cada Dirección de Sanidad Militar y Jefatura de Salud con los cuales se concertó el documento final.

B. Generalidades

Los botiquines de uso militar son un recurso básico e indispensable para el personal que asiste y presta un primer auxilio, ya que el botiquín provee todos los elementos indispensables necesarios para atender de manera inmediata al personal militar que requiere de su uso y así controlar cualquier enfermedad o evento que se manifieste de manera repentina en el teatro de operaciones.

III. EJECUCIÓN

A. Misión General

La Dirección General de Sanidad Militar, en el desarrollo de la Salud Operacional, establece las estrategias, planes y políticas en apoyo logístico a las operaciones militares como está contenido en el Decreto 1795 de 2000 *"Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional", Artículo 13, Literal o) Coordinar las acciones del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en apoyo logístico a las operaciones Militares.* Estructura el Acuerdo 060 de 2015, *"Por el cual se establecen las políticas, estrategias y planes en salud como apoyo al cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares y se determinan los lineamientos para el desarrollo del Programa de Salud Operacional de las Fuerzas Militares"*

Se hace necesario mantener actualizados los contenidos de los Botiquines, para que respondan a los requerimientos técnicos y tácticos de las fuerzas militares, así como a los perfiles del personal que brinda esta atención.

B. Misiones Particulares

1. Dirección General de Sanidad Militar.

Las misiones particulares de la DIGSA se encuentran a cargo del líder de logística médica del área de Salud Operacional.

a) Definir junto a los representantes de Salud operacional de la DISAN y JEFSA la estandarización técnica de los contenidos de los botiquines M1, M3, M4 y M5, de manera que se cumpla con el objetivo de contar con los insumos, medicamentos y dispositivos médicos necesarios para brindar una atención en salud oportuna y técnica al herido o enfermo en el área de operaciones.

b) Supervisar la Implementación de la presente Directiva en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

c) Ejercer la inspección, vigilancia y control de la ejecución de la presente Directiva.

d) Supervisar a través del Grupo de Salud Operacional que se brinde la capacitación y el manejo de botiquines por parte de las Direcciones de Ejército, Armada y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea.

e) Analizar la información brindada por las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea contemplada en el informe trimestral y en el diligenciamiento de los formatos del anexo 6 de la presente Directiva, con el fin de conocer, medir, estandarizar, documentar y estudiar los resultados obtenidos en relación a la cantidad, estado y ubicación de los botiquines

militares, cantidad y costo empleado de los insumos reabastecidos y utilizados para llevar a cabo la asistencia en salud en el teatro de operaciones.

2. Dirección de Sanidad Ejército Nacional, Dirección de Sanidad Naval y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea.

Las misiones particulares asignadas se encuentran a cargo del funcionario del área de Salud Operacional de cada DISAN y JEFSA.

a) Realizar la divulgación, distribución y ejecución de la presente Directiva y el seguimiento a la implementación de la misma.

b) Gestionar y supervisar que los ESM realicen los reabastecimientos de los insumos y medicamentos de los botiquines, de acuerdo a lo establecido en el contrato de medicamentos y mediante la presente directiva, según el tipo de botiquín en uso "Anexos 2, 3, 4, 5".

c) Verificar que los Botiquines M1, M3, M4 y M5 cumplan con los insumos, medicamentos y dispositivos médicos necesarios para brindar una atención oportuna en salud al personal militar herido o enfermo en el área de operaciones.

d) Enviar a la Dirección General de Sanidad Militar un informe Trimestral que contemple los aspectos relevantes y novedades encontradas sobre el uso de los botiquines en el área operacional, así como la información consolidada respecto a los formatos del anexo 6 de la presente directiva.

3. Establecimientos de Sanidad Militar.

Las misiones particulares asignadas se encuentran a cargo del funcionario del área de Salud Operacional de cada ESM.

a) Administrar los Botiquines asignados de manera que se tenga control del consumo, inventario y reabastecimiento del mismo, con el objetivo de que el personal que prestó la atención cuente de nuevo con los medicamentos e insumos necesarios para brindar una atención en salud oportuna al personal militar en el teatro de operaciones.

b) Realizar seguimiento a las condiciones de los Botiquines con el objetivo de controlar el manejo de dicho elemento y minimizar riesgo por el uso de elementos vencidos o en mal estado, por fallas en su almacenamiento o manipulación, informando los hallazgos a las Dirección Sanidad y Jefatura de Salud.

c) Registrar, consolidar y enviar a la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza la información trimestral de los botiquines existentes y reabastecidos, novedades y/o observaciones, junto con el diligenciamiento de los formatos del anexo 6 de esta Directiva.

4. Responsable del uso y administración del Botiquín (M1, M3, M4 y M5) según habilidades y perfiles del personal.

   a) Dar uso adecuado a los elementos del Botiquín según las habilidades de cada uno de los perfiles y capacitación brindada de acuerdo al Anexo "1 contemplado en la presente Directiva

   b) Verificar y controlar que los botiquines se encuentren debidamente abastecidos con los materiales, insumos, medicamentos y dispositivos médicos necesarios.

   c) Solicitar oportunamente el reabastecimiento del Botiquín (M1, M3, M4 y M5) asignado según Anexos que trata del contenido del Botiquín en la presente Directiva.

   d) Revisar mensualmente las fechas de vencimiento, condiciones de los insumos y medicamentos, informando al Establecimiento de Sanidad Militar y al responsable de Salud Operacional las novedades encontradas.

   e) No administrar medicamentos sin la indicación o validación médica expresa (aquellos que la requieran). Los medicamentos del Botiquín corresponderán únicamente al listado que hace parte integral de la presente Directiva.

   f) No administrar medicamentos por vías diferentes a las que se indican en la instrucción, (Anexo 1-"*Listado de habilidades según perfiles en Salud Operacional*") y el Manual de Instructores de Socorristas Militares vigente y validado por la Jefatura de Educación y Doctrina Conjunta o las Direcciones de Doctrina de cada una de las Fuerzas.

C. Instrucciones Generales de Coordinación

1. El reabastecimiento de los botiquines se debe realizar por medio de los Establecimientos de Sanidad Militar de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos al interior de cada DISAN o JEFSA para la provisión de insumos y medicamentos, para los cuales se debe diligenciar los formatos establecidos en esta directiva en el Anexo "6".

2. Los botiquines M5 serán de manejo exclusivo del personal médico que realice la atención inicial para la estabilización de heridos que requieran evacuación del área de operaciones; por lo tanto, la dotación inicial de medicamentos de control será por orden de suministro y posteriormente se realizará previa fórmula médica indicando que son medicamentos para el botiquín M5, bajo la responsabilidad del profesional solicitante.

3. Los medicamentos, insumos y dispositivos médicos de los botiquines deben cumplir con los requisitos legales exigidos como son: registro INVIMA vigente, no inclusión de medicamentos y tecnologías alteradas en las cuales se hayan sustraído o reemplazado total o parcialmente los elementos constitutivos que forman parte de su composición oficialmente aprobada.

4. De acuerdo con las necesidades del servicio y dadas las condiciones ambientales a las cuales se exponen los botiquines, los medicamentos independientemente a su fecha de vencimiento deben ser reemplazados cada 6 meses y se deben entregar al Establecimiento de Sanidad Militar para que se realice la disposición final de manera adecuada y solicitar el nuevo suministro de estos medicamentos. Esto no aplicará para medicamentos que se encuentran en lugares con control de temperatura y humedad adecuadas y controladas como en el caso de los servicios farmacéuticos que se encuentren a bordo de embarcaciones fluviales o marítimas.

5. El personal que opera los Botiquines de campaña será el responsable del inventario, reporte oportuno de medicamentos y elementos próximos a vencer. Así mismo, del seguimiento conforme al "Formato Hoja de Gasto Insumos Botiquines" establecido en el anexo 6 de la presente Directiva y los cuales deben ser reportados al Establecimiento de Sanidad Militar.

6. De los insumos y/o medicamentos elaborados en el extranjero que sean adquiridos comercialmente en el mercado interno, se debe garantizar su calidad mediante un certificado expedido por la autoridad sanitaria del país de origen mediante el cual se acredite si el consumo está legalmente permitido dentro del mismo, si la venta es libre o está sujeta a restricciones indicando cuáles son. Este certificado debe estar debidamente autenticado por el cónsul colombiano correspondiente y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con traducción en idioma español conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

7. Los insumos y/o medicamentos de otros países provenientes de adquisición directa, donaciones o similares deberá contar con una certificación de la FDA (Federal Drug Association) respectiva.

8. Todos los insumos y/o medicamentos importados deberán cumplir los requisitos de calidad exigidos para los productos de fabricación nacional, así como las normas y reportes exigidos por el Ministerio de Salud o la autoridad sanitaria competente en Colombia.

9. La disponibilidad del Desfibrilador Externo Automático "DEA" está sujeta a la capacitación y certificación del responsable de su uso, coordinación y existencia de la ruta vital y protocolos exigidos según la referencia normativa relacionada en la presente directiva.

10. La habilidad registrada como administración de oxígeno se habilita donde se encuentre el recurso para ser empleado, teniendo en cuenta las características de operación que garanticen la función adecuada del mismo y que no representen un riesgo que comprometa al herido o enfermo ni al desarrollo de las operaciones militares.

11. Los botiquines deben contener los medicamentos e insumos necesarios según los parámetros establecidos, en las cantidades relacionadas en la presente Directiva cumpliendo con los lineamientos para la operación, uso y dotación establecidos por la ley.

12. Los botiquines M1 serán utilizados por personal de unidades especiales que reciban capacitación mínima requerida, el botiquín M3 será utilizado por Socorristas Militares y Para-rescatistas, los botiquines M4 serán utilizados por Enfermeros de combate y/o Militar, Enfermeros Profesionales, Técnico o Tecnólogo Auxiliar de Enfermería, Técnico o Tecnólogo en APH, y el Botiquín M5 será uso exclusivo por los Profesionales en Medicina, quienes tienen a cargo la dotación de medicamentos de control que se debe realizar por orden de suministro soportado con formula médica indicando que son medicamentos para botiquín M5 bajo la responsabilidad del profesional solicitante.

13. Todos los botiquines deben contener el Anexo "1"- Listado de habilidades según perfiles en Salud Operacional, el Anexo "2, 3, 4 y 5" - Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos de acuerdo a cada Botiquín y el formato de Gastos del Anexo 6-. Dichos anexos hacen parte integral de la Presente Directiva y se actualizarán según necesidad.

14. Cada Dirección de Sanidad y Jefatura de Salud es responsable del procedimiento específico de esterilización que requieran los equipos e instrumentos, la cual debe estar garantizada por un método reconocido. El personal que haga uso del instrumental realizara entrega del mismo a los Establecimientos de Sanidad Militar para el proceso de esterilización, el instrumental debe retornar al botiquín del cual fue extraído y es responsabilidad del militar que lo utilizo.

15. Relación Socorrista versus número de hombres en operaciones militares (1 por cada 10) y relación Enfermero de Combate versus número de hombres en operaciones militares (1 por cada 36), con la capacidad y entrenamiento para brindar atención básica prehospitalaria en caso de presentarse un herido o un enfermo en el área de operaciones. Dicho entrenamiento debe incluir el manejo de botiquín correspondiente.

16. La provisión de medicamentos para enfermedades crónicas será responsabilidad de cada militar quien transportará la farmacoterapia que tenga formulada y en ningún caso el Socorrista o Enfermero Militar reemplazará la consulta o el diagnóstico médico, ya que el botiquín de atención de primeros auxilios no hace las veces de farmacia.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

a) El ciclo de suministros que corresponde a cada Fuerza deberá garantizarse con el objetivo de que, en caso de necesitarse, se cuente con los recursos y materiales necesarios para brindar una atención oportuna al personal comprometido en operaciones.

b) Para la óptima conservación de los elementos establecidos en los botiquines y teniendo en cuenta las condiciones ambientales a las que están expuestos, cada fuerza debe garantizar que los botiquines utilizados cumplan con las características básicas generales contempladas en la Norma Técnica del Ministerio de Defensa.

c) Con el propósito de cumplir con las necesidades de atención en primeros auxilios, cada fuerza debe considerar que los botiquines sean dispuestos, acorde con el nivel de riesgo operacional, de capacitación y entrenamiento de quien brinda la atención.

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Director General de Sanidad Militar

Autentica,

Coronel, ROCIO DEL PILAR GARZON AYALA
Subdirectora de Salud.

DISTRIBUCIÓN:
Original : Dirección General de Sanidad Militar
Copia No 1 : Dirección de Sanidad Ejercito Nacional
Copia No 2 : Dirección de Sanidad Armada Nacional
Copia No 3 : Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana

Anexos :
Anexo 1. Listado de Habilidades Según Perfiles en Salud Operacional
Anexo 2. Listado de Insumos, Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M1
Anexo 3. Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M3
Anexo 4. Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M4
Anexo 5. Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M5
Anexo 6. Formatos de Control y Reporte.

Elaboró : TS. Angela Urrea
Logística Médica - GRUSO

Revisó : MY. Cesar Antonio Castañeda Cotamo
Coordinador Grupo Salud Operacional

Vo. Bo. : PD. Angela Maria Tofiño Saavedra
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales DIGSA.

PD. Alexandra Martínez Vargas
Coordinadora Grupo Planeación DIGSA.

ANEXO 1: Listado de Habilidades Según Perfiles en Salud Operacional.

HABILIDAD	BOTIQUÍN	M1	M3	M4	M5
	PERFÍL	Militar Unidades Especiales	Socorrista Militar-Pararescatista	Enfermero de Militar, Técnico o Tecnólogo Auxiliar de Enfermería, Técnico Tecnólogo en APH	Médico
	HORAS DE FORMACIÓN	8 horas	60-120 horas	Min 600 horas	
Vista general de la medicina táctica		X	X	X	X
HEMOSTASIA					
Aplicación de presión directa		X	X	X	X
Aplicación de torniquete		X	X	X	X
Aplicación de Hemostático		X	X	X	X
TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE HERIDOS					
Todas las Técnicas de Inmovilización			X	X	X
Colocación de inmovilizador Cervical			X	X	X
Férulas		X	X	X	X
Férulas de tracción				X	X
VÍA AÉREA Y REANIMACIÓN					
Maniobra frente-mentón/pulsión mandibular		x	X	X	X
Inserción Cánula nasofaríngea			X	X	X
Mascarilla laríngea (ML)/intubación con ML (IML)				X	X
Intubación Endotraqueal					X
Cánula de Guedell			X	X	X
Maniobra para OVACE			X	X	X
Maniobra para RCP			X	X	X
Uso del DEA			X ▲ +	X ▲ +	X
RESPIRACIÓN					
Punción Torácica			X	X	X
Apósito de Tórax		X	X	X	X
Tubo de Tórax					X
Administración de oxígeno			X +	X +	X
ACCESO INTRAVENOSO (I.V) Y SUEROTERAPIA					
Evaluar Shock			X	X	X
Colocar vía I.V /llave salina			X	X	X
Analgésicos IV-IM			O	O	X
Antibióticos. IV-IM				O	X
TERAPIA ORAL E INTRAMUSCULAR					
Antibióticos orales				O	X
Analgésicos orales			X	X	X
Administración de Sales de Rehidratación Oral			X	X	X

Tramadol IM		O	O	X
Antihistamínicos IM		O	X	X
OTROS				
Triage		X	X	X
Valoración Primaria		X	X	X
Toma de Signos Vitales		X	X	X
Manejo Inicial de Heridas		X	X	X
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Infectocontagiosas		X	X	X
Evaluar Estrés de Combate		X	X	X

Convenciones:

x Habilitado.

O Se realiza con orden y direccionamiento médico.

▲ Se realiza con entrenamiento y certificación.

✣ Se realiza donde se encuentre autorizado el recurso para ser empleado según criterios técnicos, científicos y normativos, su uso no debe representar un riesgo en el desarrollo de las operaciones militares.

ANEXO 2: Listado de Insumos, Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M1.

CONTENIDOS BOTIQUÍN TIPO M1		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Apósito multipropósito estéril (Apósito de emergencia)	Apósito multipropósito estéril (apósito de emergencia): materiales: hilo de algodón e hilo de poliéster (no contiene látex). Dimensiones: largo hasta 4.5 metros (estirado) por mínimo 10 centímetros de ancho. Elongación 100% - 200% con dispositivo de presión directa y elemento de cierre para mantener cubierta la zona de la herida. Sirve como inmovilizador de la extremidad lesionada o parte del cuerpo herida.	1 und
Gasa hemostática para control de hemorragias	Gasa en empaque individual, impermeable, empaquetada al vacío estéril con impregnación de agente hemostático de mínimo 3m de largo en (acordeón o zig zag), puede ajustarse a cualquier tamaño o forma de herida (incluidas las heridas penetrantes).	1 und
Guantes de manejo no estériles.	Material nitrilo, no estériles, rotulado con la talla, en empaque plástico por pares	2 pares
Sello para herida de neumotórax con válvula	Sello o parche oclusivo con válvula unidireccional de aire estéril, empaque individual plástico.	1 und
Torniquete para control de hemorragia.	Dispositivo para control de hemorragia en extremidades con tira de mínimo 4cm de ancho y largo mínimo de 89 cm. con un sistema de parada automática que permite el apriete instantáneo de la banda de constricción sistema de gancho y bucle resistente a la intemperie que funcione cuando está completamente sumergido, proporcionando máxima seguridad en las condiciones climáticas más duras, el material exterior está optimizado para la visión nocturna, construcción duradera de correa de nylon de una sola capa, cuenta con agujeros a intervalos que se bloquean con la hebilla un sistema de seguridad, evitando que se libere accidentalmente y permitiendo un fácil ajuste al mismo, fácil auto colocación.	1 und
Vendaje elástico	Dimensiones: 5" X 5 yardas elaboradas en material de algodón, polyester y fibra de látex natural y empacado en plástico. Individual	2 und
Bolsas Hospitalaria Rojas	Cintas tipo cordón para anudarla fácilmente, 35 cm de largo x 31 cm de ancho, Bolsas biodegradables, con cordón, tamaño mini. higiénicas y fáciles de usar, tipo hospitalario. Capacidad 7 kilos elaboradas en Polipropileno x 12 unidades	1 paq.

ANEXO 3: Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M3.

CONTENIDOS BOTIQUÍN TIPO M3		
KIT DE HEMORRAGIA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Apósito abdominal	No adherente, absorbente y estéril de mínimo 280 mm ancho x 280 mm largo con barrera anti fluidos y 100 % algodón, estéril, debe estar recubierto en su cara externa por tela delgada, resistente, con tiras de amarre en la parte externa de la tela que recubre el apósito de amarre mínimo de 2700 mm de largo y 80 mm de ancho, la tira debe ser continua para mejor presión, que impida el ingreso de cuerpos extraños. Envoltura color militar con las especificaciones del producto en su exterior, la envoltura resistente a la humedad.	2 und
Apósito multipropósito estéril (Apósito de emergencia)	Apósito multipropósito estéril (apósito de emergencia): materiales: hilo de algodón e hilo de poliéster (no contiene látex). Dimensiones: largo hasta 4.5 metros (estirado) por mínimo 10 centímetros de ancho. Elongación 100% - 200% con dispositivo de presión directa y elemento de cierre para mantener cubierta la zona de la herida. Sirve como inmovilizador de la extremidad lesionada o parte del cuerpo herida.	5 und
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo. Material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril. calibre 18,	10 und
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo, material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril., calibre 20.	4 und
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo. Material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril. Calibre No. 14	2 und
Esparadrapo	Tipo hospitalario de tela adhesiva hidrorepelente, no hipo alergénico, masa adhesiva fabricada en tela de algodón, adhesivo, emolientes y antioxidante, óxido de zinc y lanolina de 2 pulgadas x 5 yardas rollo empaque individual en plástico, resellable.	1 rollo
Equipo de venoclisis	Equipo de macrogoteo sin aguja. para administración de soluciones, estéril desechable, con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, con factor goteo, manguera de tránsito, regulador de flujo con rodillo, para el control del goteo, para la inyección alterna de medicamentos, esterilizado con óxido de etileno, libre de pirógenos. Material polocloruro de vinilo (pvc) grado médico. Estéril, desechable. Empacadas en bolsa plástica individual.	5 und
Gasa hemostática para control de hemorragias	Gasa en empaque individual, impermeable, empaquetada al vacío estéril con impregnación de agente hemostático de mínimo 3m de largo en (acordeón o zig zag), puede ajustarse a cualquier tamaño o forma de herida (incluidas las heridas penetrantes).	4 und

Gasa Pre cortada	Tejidos poco tupidos o tela ligera, Dimensiones mínimas: 7,5cm x 5cm. En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable. de mínimo 5 unidades.	10 paq.
Lactato de Ringer	Bolsa por 500 ml. empaque individual en pvc plástico grado médico, con bolsa de protección.	5 und
Manta térmica de emergencia	Manta isotérmica No menor a 140cm x 190 cm aluminizadas, color verde militar y plata que permita la conservación y dispersión del calor. Empaque plástico individual impermeable.	2 und
Toallas Alcoholadas	Toallitas de alcohol con efecto bacteriostático, para desinfección de piel y preparar sitio de venopunción, impregnada de alcohol isopropílico al 70% cada toallita está dispuesta en paquete individual.	20 und
Torniquete para control de hemorragia	Dispositivo para control de hemorragia en extremidades con tira de mínimo 4cm de ancho y largo mínimo de 89 cm. con un sistema de parada automática que permite el apriete instantáneo de la banda de constricción sistema de gancho y bucle resistente a la intemperie que funcione cuando está completamente sumergido, proporcionando máxima seguridad en las condiciones climáticas más duras, el material exterior está optimizado para la visión nocturna, construcción duradera de correa de nylon de una sola capa, cuenta con agujeros a intervalos que se bloquean con la hebilla. Un sistema de seguridad, evitando que se libere accidentalmente y permitiendo un fácil ajuste al mismo, fácil auto colocación.	2 und
Torniquete para venopunción	Elástico, de caucho o banda elástica, en material impermeable, resistente con medidas entre 3.5 hasta 4.0 cm de ancho, 35 hasta 45 cm de largo. En paquete individual, empaque hermético e impermeable.	1 und
Vendaje elástico	Dimensiones: 5" X 5 yardas elaboradas en material de algodón, polyester y fibra de látex natural y empacado en plástico. Individual.	5 und
KIT DE BIOSEGURIDAD		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Bolsas Hospitalaria Rojas	Cintas tipo cordón para anudarla fácilmente, 35 cm de largo x 31 cm de ancho, Bolsas biodegradables, con cordón, tamaño mini, higiénicas y fáciles de usar, tipo hospitalario. Capacidad 7 kilos elaboradas en Polipropileno x 12 unidades.	1 paq.
Recipiente plástico color rojo para elementos corto punzantes	Recipiente rígido, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga pvc. Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. Desechable, para residuos corto punzantes de tipo hospitalario, liviano y de capacidad no mayor a 300cc. Debe tener rotulo para la información de generación de los elementos para su respectiva disposición final.	1 Und

Gafas de bioseguridad	Capa del lente Resistente a las ralladuras y antiempañante, Características de Comodidad Banda elástica, Color del lente Transparente, Estándares / Aprobaciones ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007, Protección contra salpicaduras, Lente de policarbonato resistente que absorbe el 99,9% UV, Amplio campo visual, Ventilación Indirecta, Banda elástica de seguridad tejida ajustable (25mm ancho).	1 Und
Guantes	Material nitrilo, no estériles, rotulado con la talla. 5 pares talla: M, 5 pares talla: L en empaque plástico por pares.	10 und
Mascara facial para RCP	Mascarilla adulta que cubra boca y nariz del paciente, con válvula y filtro antirreflujo que garantice las ventilaciones y evite el riesgo por contacto de fluidos, utilizada para reanimación, desechable, adulto, con estuche (caja).	2 und
Tapabocas	Tapaboca blando desechable, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico que permite fijación en región nasal. contenidos en empaque individual y hermético, impermeable y resellable	5 und
KIT MANTENIMIENTO VÍA AÉREA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Cánula nasofaríngea	Dispositivo de goma o plástico hueco con concavidad y alargado que se introduce por vía nasal. Rigidez media. Estéril para adulto talla 28fr o i.d. 7,0 o o.d 9.3mm, empacadas en bolsa plástica individual.	2 und
Cánula orofaríngea	No 4 y 5. Empaque individual hermético e impermeable.	1 de cada de una
Sello para herida de neumotórax con válvula	Sello o parche oclusivo con válvula unidireccional de aire estéril, empaque individual plástico.	1 und
Aguja de descompresión torácica	Tamaño de guja calibre 14G x 8,25cm. Envase 14.4cm x 1.7cm x 2cm.	2 und
KIT DE CURACIONES		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Ácido Fusídico	Crema al 2% tubo 15 gr.	1 und
Aplicadores	Mango de madera con punta en algodón, contenidos en empaque hermético por 10 unidades, impermeable y resellable.	1 paq.
Bajalenguas	Fabricados en madera, contenidos en empaque hermético por 10 unidades, impermeable y resellable.	1 paq.
Canastilla Ocular	Diseño universal adaptado para el ojo izquierdo y derecho, Fabricado con Polipropileno blanco, Cumple con estándares de Calidad, Su diseño permite una óptima comodidad del paciente.	2 und
Esparadrapo Hipo alergénico	Empaque plástico impermeable, color piel de 2" x 10 yardas	1 rollo

Gasa pre cortada	Tejidos poco tupidos o tela ligera, Dimensiones mínimas: 7,5cm x 5cm. En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable de mínimo 5 unidades.	10 paq.
Solución Salina	Bolsa 500 ml, concentración 0.9% empaque individual en pvc plástico grado médico, con bolsa de protección.	2 und
Sulfadiazina de plata máximo	Tubo-frasco 30 gr	1 und
Yodopovidona	Frasco plástico espuma máximo 120 ml	1 und
KIT DE INMOVILIZACIÓN		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Férula de aluminio maleable	Material radio - lucido, liviano, resistente al agua, altamente resistente y maleable recubierta por capa de material acolchada que pueda ser doblada en curvas simples para inmovilización de extremidades superiores o inferiores, color verde militar o negro. Empaque individual plástico.	2 rollos
Inmovilizador Cervical	Graduable mínimo 4 tallas Adulto en Plástico. Empaque individual.	1 und
Venda Triangular	Fabricado en material textil, tela color verde – militar resistente, suave al tacto y de fácil manejo, de 90x90x125 cm empacado individual e impermeable con rotulo o impresión que contenga información ficha técnica de uso, en su exterior.	2 und
VARIOS		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Manillas para clasificación	Adhesivo circular a la muñeca, de material duradero, y resistente al agua con sistema de fácil ajuste y seguridad, deben estar identificadas por colores de acuerdo a los colores internacionales de clasificación de víctimas (negro, rojo, amarillo y verde), cada paquete lo conforman 4 manillas una de cada color) Empacada individual en bolsa plástica con cierre hermético.	5 x cada color
Marcador	Grueso, tinta no Borrable, color negro y mina gruesa.	1 und
Recipiente Plástico	Caja con tapa y compartimentos suficientes para empacar los medicamentos.	1 und
Tarjeta de evacuación	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color de dimensiones 12 cm x 16 cm de largo.	10 und
Tarjeta de inventario	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color medidas: 13 cm de ancho x 17 cm de largo. Debe contener 6 columnas que describan: ítem, categoría, nombre del elemento, presentación, cantidad, empleo o indicaciones de uso del elemento. Empacada individual en bolsa plástica con cierre hermético.	1 und
Termómetro Digital	Empaque plástico rígido.	1 und

Tijeras de trauma	Hojas metálicas (acero inoxidable) con mango plástico color negro. Mínimo 18 cm de largo x 9 cm de ancho. esterilizables en empaque plástico con cierre hermético.	1 und
DEA	Equipo de batería recargable y/o baterías de larga duración, liviano de fácil transporte. Con modo de carga rápida entre 7 y 10 segundos. Menú de funcionamiento con opción en español que brinde instrucciones de análisis de compresión y recomendación de descarga de energía al paciente durante procedimiento de reanimación cardiopulmonar, indicación sonora del análisis del ritmo cardiaco, con alarma de nivel de carga de la batería, alarma desconexión del paciente audible y visual, debe incluir baterías. Debe incluir (01) juego de parches adhesivos correspondientes, Se debe hacer entrega de certificado de calibración, con guía rápida de manejo, con manual de usuario y técnico original con traducción simple al español, con registro sanitario INVIMA vigente, debe anexar certificado de fábrica (Si el dispositivo es para uso de vuelo se debe adicionar las certificaciones correspondientes)	1 UND
KIT DE MEDICAMENTOS		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Acetaminofén	Tabletas 500 mg.	40 und
Clemastina	Ampolla 2mg/2ml.	4 und
Diclofenaco	Ampolla 75 mg.	6 und
Ibuprofeno	Tabletas 400 mg.	40 und
Jeringa x 5cc	Empaque individual y contenido en empaque hermético, impermeable y resellable.	15 und
Sales de rehidratación oral	Sobres de 28,4 g de polvo saborizados para reconstituir a 100 ml, hidratante oral, con electrolitos y dextrosa, solubles en agua, para corregir el déficit isotónico, concentración del sobre de sales de rehidratación oral de 20.5 gr hasta 28.4 gr.	10 und
Tramadol	Ampolla 50 mg / 1ml (Para uso solo en caso de trauma, amputado. Administrar solo si se cuenta con autorización y apoyo médico)	2 und

ANEXO 4: Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M4

CONTENIDOS BOTIQUÍN TIPO M4		
KIT DE HEMORRAGIA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Apósito abdominal	No adherente, absorbente y estéril de mínimo 280 mm ancho x 280 mm largo con barrera anti fluidos y 100 % algodón, estéril, debe estar recubierto en su cara externa por tela delgada, resistente, con tiras de amarre en la parte externa de la tela que recubre el apósito de amarre mínimo de 2700 mm de largo y 80 mm de ancho, la tira debe ser continua para mejor presión, que impida el ingreso de cuerpos extraños. Envoltura color militar con las especificaciones del producto en su exterior, la envoltura resistente a la humedad.	2 und
Apósito multipropósito estéril o (Apósito de emergencia)	Apósito multipropósito estéril (apósito de emergencia): materiales: hilo de algodón e hilo de poliéster (no contiene látex). Dimensiones: largo hasta 4.5 metros (estirado) por mínimo 10 centímetros de ancho. Elongación 100% - 200% con dispositivo de presión directa y elemento de cierre para mantener cubierta la zona de la herida. Sirve como inmovilizador de la extremidad lesionada o parte del cuerpo herida.	5 und
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo, material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril. calibre 18,	12 und
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo. material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril.Calibre No. 14	2 und
Esparadrapo 2 pulgadas	Tipo hospitalario de tela adhesiva hidrorepelente, no hipo alergénico, masa adhesiva fabricada en tela de algodón, adhesivo, emolientes y antioxidante, óxido de zinc y lanolina de 2 pulgadas x 5 yardas rollo empaque individual en plástico, resellable.	1 und
Equipo de venoclisis macrogoteo	Equipo de macrogoteo sin aguja. para administración de soluciones, estéril desechable, con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, con factor goteo, manguera de tránsito, regulador de flujo con rodillo, para el control del goteo, para la inyección alterna de medicamentos, esterilizado con óxido de etileno, libre de pirógenos. Material polocloruro de vinilo (pvc) grado médico. Estéril, desechable. Empacadas en bolsa plástica individual.	6 und
Gasa hemostática para control de hemorragias	Gasa en empaque individual, impermeable, empaquetada al vacío estéril con impregnación de agente hemostático de mínimo 3m de largo. en (acordeón o zig zag), puede ajustarse a cualquier tamaño o forma de herida (incluidas las heridas penetrantes);	4und

Gasa pre cortada	Tejidos poco tupidos o tela ligera, Dimensiones minimas: 7,5cm x 5cm. En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable. de mínimo 5 unidades.	15 paq.
Lactato de Ringer	Bolsa por 500 ml. empaque individual en pvc plástico grado médico, con bolsa de protección.	6 und
Manta térmica de emergencia	Manta isotérmica No menor a 140cm x 190 cm aluminizadas, color verde militar y plata que permita la conservación y dispersión del calor. Empaque plástico individual impermeable.	3 und
Toallas alcoholadas	Toallitas de alcohol con efecto bacteriostático, para desinfección de piel y preparar sitio de venopunción, impregnada de alcohol isopropílico al 70%. cada toallita está dispuesta en paquete individual.	20 und
Torniquete para control de hemorragia	Dispositivo para control de hemorragia en extremidades con tira de mínimo 4cm de ancho y largo mínimo de 89 cm. con un sistema de parada automática que permite el apriete instantáneo de la banda de constricción sistema de gancho y bucle resistente a la intemperie que funcione cuando está completamente sumergido, proporcionando máxima seguridad en las condiciones climáticas más duras, el material exterior está optimizado para la visión nocturna, construcción duradera de correa de nylon de una sola capa, cuenta con agujeros a intervalos que se bloquean con la hebilla un sistema de seguridad, evitando que se libere accidentalmente y permitiendo un fácil ajuste al mismo, fácil auto colocación.	2 und
Torniquete para venopunción	Elástico, de caucho o banda elástica, en material impermeable, resistente con medidas entre 3.5 hasta 4.0 cm de ancho, 35 hasta 45 cm de largo. En paquete individual, empaque hermético e impermeable.	1 und
Vendaje elástico	Dimensiones: 5" X 5 yardas elaboradas en material de algodón, polyester y fibra de látex natural y empacado en plástico. Individual.	4 und
KIT DE BIOSEGURIDAD		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Mascara para RCP	Mascarilla adulta que cubra boca y nariz del paciente, con válvula y filtro antirreflujo que garantice las ventilaciones y evite el riesgo por contacto de fluidos, utilizada para reanimación, desechable, adulto, con estuche (caja).	2 und
Bolsas Hospitalaria Rojas	Cintas tipo cordón para anudarla fácilmente, 35 cm de largo x 31 cm de ancho. Bolsas biodegradables, con cordón, tamaño mini, higiénicas y fáciles de usar, tipo hospitalario. Capacidad 7 kilos elaboradas en Polipropileno x 12 unidades.	1 paq.

Gafas de bioseguridad	Capa del lente Resistente a las ralladuras y antiempañante, Caracteristicas de Comodidad Banda elástica, Color del lente Transparente, Estándares / Aprobaciones ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007, Protección contra salpicaduras, Lente de policarbonato resistente que absorbe el 99,9% UV, Amplio campo visual, Ventilación Indirecta, Banda elástica de seguridad tejida ajustable (25mm ancho).	1 Und
Guantes	Material nitrilo, no estériles, rotulado con la talla. 5 pares talla: M, 5 pares talla: L. en empaque plástico por pares.	20 und
recipiente plástico color rojo para elementos cortopunzantes	Recipiente rígido, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga pvc resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético, desechable, para residuos corto punzantes de tipo hospitalario, liviano y de capacidad no mayor a 300cc. Debe tener rotulo para la información de generación de los elementos para su respectiva disposición final.	1 Und
Tapabocas	Tapabocas blando desechable, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico que permite fijación en región nasal. contenidos en empaque individual y hermético, impermeable y resellable	5 und
Tapabocas de alta eficiencia N95	Mascarilla filtro de partículas micrométricas N95, doble banda elástica de sujeción, desechable, no estéril, libre de látex.	2 Unds
KIT MANTENIMIENTO VÍA AÉREA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Cánula nasofaríngea	Dispositivo de goma o plástico hueco con concavidad y alargado que se introduce por vía nasal. Rigidez media. Estéril para adulto talla 28fr o i.d. 7,0 o o.d 9.3mm, empacadas en bolsa plástica individual.	2 und
Cánula orofaríngea	No 4 y 5. Empaque individual hermético e impermeable.	1 de cada de una
Catéter venoso retráctil	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo" que protege la aguja después de su uso material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blister individual, desechable, estéril calibre 14, longitud mínima 45mm. en empaque individual y contenidos en empaque hermético, impermeable y resellable	2 und
Sello para herida de neumotórax con válvula	Sello o parche oclusivo con válvula unidireccional de aire estéril, empaque individual plástico.	2 und
Máscara laríngea No. 4	En empaque individual y hermético, impermeable y resellable.	1 und
Mascara facial con reservorio	Empaque en plástico.	1 und

Resucitador BVM adulto (Bag Valve Mask)	Consta de bolsa, válvula, reservorio de oxígeno, extensión de oxígeno y mascara tamaño adulto. En empaque individual impermeable + reservorio con filtro HME.	1 und
Aguja de descompresión torácica	Tamaño de guja calibre 14G x 8,25cm. Envase 14.4cm x 1.7cm x 2cm.	2 und
KIT DE CURACIONES		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Ácido Fusídico	Crema al 2% tubo 15 gr	1 und
Aplicadores	Mango de madera con punta en algodón, contenidos en empaque hermético por 10 unidades, impermeable y resellable.	1 paq.
Bajalenguas	Fabricados en madera, contenidos en empaque hermético por 10 unidades, impermeable y resellable.	1 paq.
Canastilla Ocular	Diseño universal adaptado para el ojo izquierdo y derecho, Fabricado con Polipropileno blanco, Cumple con estándares de Calidad, su diseño permite una óptima comodidad del paciente.	1 und
Esparadrapo Hipoalergénico	empaque plástico impermeable, color piel de 2" x 10 yardas	1 rollo
Gasa pre cortada	Tejidos poco tupidos o tela ligera, Dimensiones mínimas: 7,5cm x 5cm. En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable de mínimo 5 unidades.	10 paq.
Solución salina	Bolsa 500 ml, concentración 0.9%. empaque individual en pvc plástico grado médico, con bolsa de protección	2 und
Sulfadiazina de plata máximo	Tubo-frasco 30 gr	1 und
Yodopovidona	Frasco plástico espuma máximo 120 ml	1 und
KIT DE INMOVILIZACIÓN		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Férula de aluminio maleable	Material radio - lucido, liviano, resistente al agua, altamente resistente y maleable recubierta por capa de material acolchada que pueda ser doblada en curvas simples para inmovilización de extremidades superiores o inferiores, color verde militar o negro empaque individual plástico.	3 rollos
Inmovilizador Cervical	Graduable mínimo 4 Tallas Adulto en Plástico. Empaque individual.	1 und
Venda Triangular	Fabricado en material textil, tela color verde – militar, resistente, suave al tacto y de fácil manejo, de 90x90x125 cm empacado individual e impermeable con rotulo o impresión que contenga información ficha técnica de uso, en su exterior.	2 und

VARIOS		
ELEMENTO	CARACTERISTICAS GENERALES	CANT.
Fonendoscopio y tensiómetro.	Empaque impermeable.	1 und
Manillas para clasificación	Adhesivo circular a la muñeca, de material duradero, y resistente al agua con sistema de fácil ajuste y seguridad, deben estar identificadas por colores de acuerdo a los colores internacionales de clasificación de víctimas (negro, rojo, amarillo y verde), cada paquete lo conforman 4 manillas una de cada color). Empaque individual en bolsa plástica con cierre hermético.	5 paquetes
Marcador	Grueso, tinta no Borrable, color negro y mina gruesa.	1 und
Pinzas (mosquito y disección)	Empaque estéril y contenido en empaque hermético e impermeable.	1 kit
Recipiente Plástico	Caja con tapa y compartimentos suficientes para empacar los medicamentos.	1 und
Tarjeta de evacuación	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color de dimensiones 12 cm x 16 cm de largo.	10 und
Tarjeta de inventario	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color medidas: 13 cm de ancho x 17 cm de largo, debe contener 6 columnas que describan: ítem, categoría, nombre del elemento, presentación, cantidad, empleo o indicaciones de uso del elemento. Empacada individual en bolsa plástica con cierre hermético.	1 und
Termómetro Digital	Pantalla lcd digital fácil de leer, punta de plástico flexible, batería de 1,5v, emisión de sonido cuando la medición de la temperatura está completa, medición en grado centígrado. En empaque plástico rígido.	1 und
Tijeras de trauma	Hojas metálicas (acero inoxidable) con mango plástico color negro. Mínimo 18 cm de largo x 9 cm de ancho. Esterilizables en empaque plástico con cierre hermético.	1 und
DEA	Equipo de batería recargable y/o baterías de larga duración, liviano de fácil transporte. Con modo de carga rápida entre 7 y 10 segundos. Menú de funcionamiento con opción en español que brinde instrucciones de análisis de compresión y recomendación de descarga de energía al paciente durante procedimiento de reanimación cardiopulmonar, indicación sonora del análisis del ritmo cardiaco, con alarma de nivel de carga de la batería, alarma desconexión del paciente audible y visual, debe incluir baterías. Debe incluir (01) juego de parches adhesivos correspondientes, Se debe hacer entrega de certificado de calibración, con guía rápida de manejo, con manual de usuario y técnico original con traducción simple al español, con registro sanitario INVIMA vigente, debe anexar certificado de fábrica (Si el dispositivo es para uso de vuelo se debe adicionar las certificaciones correspondientes)	1 und

KIT DE MEDICAMENTOS		
ELEMENTO	CARACTERISTICAS GENERALES	ELEMENTO
Acetaminofén	Tabletas 500 mg	40 und
Diclofenaco	Ampolla 75 mg	6 und
Dicloxacilina	Cápsulas 500 mg	50 und
Dipirona Ampollas 2 g	Ampollas 2 g (uso intramuscular)	5 und
Hidrocortisona	Ampollas 100 mg	5 und
Ibuprofeno	Tabletas 400 mg	40 und
Jeringa 20cc	Empaque individual y contenido en empaque hermético, impermeable y resellable.	2 und
Jeringa 5cc	Empaques individuales y contenidos en empaque hermético, impermeable y resellable.	15 und
Jeringa 3cc	Empaques individuales y contenidos en empaque hermético, impermeable y resellable.	10 und
Metoclopramida	Ampolla 10 mg	2 und
Sales de rehidratación oral	Sobres de 28,4 g de polvo saborizados para reconstituir a 100 ml, hidratante oral, con electrolitos y dextrosa, solubles en agua, para corregir el déficit isotónico, concentración del sobre de sales de rehidratación oral de 20.5 gr hasta 28.4 gr.	10 und
Tramal Ampolla 50 mg	Ampolla 50 mg (Para uso solo en caso de trauma, amputado. Administrar solo si se cuenta con autorización y apoyo médico).	4 und

ANEXO 5: Listado de Insumos, Medicamentos y Dispositivos Médicos Botiquín Tipo M5

CONTENIDOS BOTIQUÍN TIPO M5		
KIT DE HEMORRAGIA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Apósito abdominal	No adherente, absorbente y estéril de mínimo 280 mm ancho x 280 mm largo con barrera anti fluidos y 100 % algodón, estéril, debe estar recubierto en su cara externa por tela delgada, resistente, con tiras de amarre en la parte externa de la tela que recubre el apósito de amarre mínimo de 2700 mm de largo y 80 mm de ancho, la tira debe ser continua para mejor presión, que impida el ingreso de cuerpos extraños envoltura color militar con las especificaciones del producto en su exterior, la envoltura resistente a la humedad.	2 und
Apósito multipropósito estéril	Apósito multipropósito estéril (apósito de emergencia): materiales: hilo de algodón e hilo de poliéster (no contiene látex). Dimensiones: largo hasta 4.5 metros (estirado) por mínimo 10 centímetros de ancho elongación 100% - 200% con dispositivo de presión directa y elemento de cierre para mantener cubierta la zona de la herida. Sirve como inmovilizador de la extremidad lesionada o parte del cuerpo herida.	4 und
Buretrol	150 ml. Empaque plástico.	2 und
Catéter venoso retráctil Cal. No 18	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril. calibre 18.	5 und
Catéter venoso retráctil Cal. No 16	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo" que protege la aguja después de su uso material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril, calibre 16.	2 und
Catéter venoso retráctil Cal. No 14	Catéter intravenoso periférico de seguridad, integrado "activo o pasivo" que protege la aguja después de su uso material en vialon poliuretano, aguja siliconada con bisel trafacetado, pabellón del catéter luer-lok, empaque blíster individual, desechable, estéril, calibre 14.	2 und
Equipo de venoclisis	Equipo de macrogoteo sin aguja. para administración de soluciones, estéril desechable, con tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, con factor goteo, manguera de tránsito, regulador de flujo con rodillo, para el control del goteo, para la inyección alterna de medicamentos, esterilizado con óxido de etileno, libre de pirógenos. Material polocloruro de vinilo (pvc) grado médico. Estéril, desechable. Empacadas en bolsa plástica individual.	5 und
Esparadrapo Hipoalergénico	Tipo hospitalario de tela adhesiva hidrorepelente, no hipo alergénico, masa adhesiva fabricada en tela de algodón, adhesivo, emolientes y antioxidante, óxido de zinc y lanolina de 2 pulgadas x 5 yardas rollo empaque individual en plástico, resellable.	1 rollo
Gasa hemostática	Gasa en empaque individual, impermeable, empaquetada al vacío estéril con impregnación de agente hemostático de mínimo 3m de largo en (acordeón o zig zag), puede ajustarse a cualquier tamaño o forma de herida (incluidas las heridas.	4 und

Gasa pre cortada	Tejidos poco tupidos o tela ligera, Dimensiones mínimas: 7,5cm x 5cm. En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable de mínimo 5 unidades.	10 paq.
Lactato de Ringer	Bolsa por 500 ml. empaque individual en pvc plástico grado médico, con bolsa de protección.	5 und
Manta térmica de emergencia	Manta isotérmica No menor a 140cm x 190 cm aluminizadas, color verde militar y plata que permita la conservación y dispersión del calor. Empaque plástico individual impermeable.	2 und
Torniquete para control de hemorragia	Dispositivo para control de hemorragia en extremidades con tira de mínimo 4cm de ancho y largo mínimo de 89 cm. con un sistema de parada automática que permite el apriete instantáneo de la banda de constricción sistema de gancho y bucle resistente a la intemperie que funcione cuando está completamente sumergido, proporcionando máxima seguridad en las condiciones climáticas más duras, el material exterior está optimizado para la visión nocturna, construcción duradera de correa de nylon de una sola capa, cuenta con agujeros a intervalos que se bloquean con la hebilla un sistema de seguridad, evitando que se libere accidentalmente y permitiendo un fácil ajuste al mismo, fácil auto colocación.	2 und
Torniquete para venopunción	Elástico, de caucho o banda elástica, en material impermeable, resistente con medidas entre 3.5 hasta 4.0 cm de ancho, 35 hasta 45 cm de largo. En paquete individual, empaque hermético e impermeable.	1 und
Toallas alcohol Isopropílico al 70%	Toallitas de alcohol con efecto bacteriostático, para desinfección de piel y preparar sitio de venopunción, impregnada de alcohol isopropílico al 70%. cada toallita está dispuesta en paquete individual	20 und
Vendaje elástico	Dimensiones: 5" X 5 yardas elaboradas en material de algodón, polyester y fibra de látex natural y empacado en plástico. Individual.	3 und
KIT DE BIOSEGURIDAD		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Bolsas Hospitalaria Rojas	Cintas tipo cordón para anudarla fácilmente, 35 cm de largo x 31 cm de ancho, Bolsas biodegradables, con cordón, tamaño mini, higiénicas y fáciles de usar, tipo hospitalario. Capacidad 7 kilos elaboradas en Polipropileno x 12 unidades.	1 paq.
recipiente plástico color rojo para elementos cortopunzantes	Recipiente rígido, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga pvc resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético desechable, para residuos cortopunzantes de tipo hospitalario, liviano y de capacidad no mayor a 300cc debe tener rotulo para la información de generación de los elementos para su respectiva disposición final.	1 Und
Gafas de bioseguridad	Capa del lente Resistente a las ralladuras y antiempañante, Características de Comodidad Banda elástica, Color del lente Transparente, Estándares / Aprobaciones ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007, Protección contra salpicaduras, Lente de policarbonato resistente que absorbe el 99,9% UV, Amplio campo visual, Ventilación Indirecta, Banda elástica de seguridad tejida ajustable (25mm ancho).	1 und

Guantes Nitrilo	No Estériles. Empaque en plástico por pares.	10 pares
Guantes Nitrilo Estériles	Material nitrilo, no estériles, rotulado con la talla. 5 pares talla: M, 5 pares talla: L. en empaque plástico por pares.	5 pares
Tapabocas	Tapaboca blando desechable, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico que permite fijación en región nasal contenidos en empaque individual y hermético, impermeable y resellable.	5 und
Tapabocas de alta eficiencia N95	Mascarilla filtro de partículas micrométricas N95, doble banda elástica de sujeción, desechable, no estéril, libre de látex.	2 Unds
KIT MANTENIMIENTO VÍA AÉREA		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
BVM (Bag Valve Mask)	Consta de bolsa, válvula, reservorio de oxígeno, extensión de oxígeno y mascara tamaño adulto. En empaque individual impermeable + reservorio con filtro HME.	1 und
Mascara de no re inhalación	Mascara: hecha en PVC no toxico de alta duración, transparente, elástico y suave, clip de ajuste en la nariz, tubo conector: de 210 cm de largo, que asegura una fácil conexión de la máscara al tubo de oxígeno, reservorio: Bolsa de vinilo capacidad de 750 cc. Válvula de control de baja resistencia.	2 und
Cánula nasofaríngea	Dispositivo de goma o plástico hueco con concavidad y alargado que se introduce por vía nasal. Rigidez media. Estéril para adulto talla 28fr o i.d. 7,0 o o.d 9.3mm, empacadas en bolsa plástica individual.	2 und
Cánula orofaríngea No 4 y 5.	Empaque individual hermético e impermeable.	1 c/d una
Catéter venoso retráctil Cal. No 14	En empaque individual y contenidos en empaque hermético, impermeable y resellable.	2 und
Laringoscopio adulto	Laringoscopio de fibra óptica, luz led, metálico en acero inoxidable, acabado acanalado o estriado o rugoso, de tamaño mediano, compatible con todos los modelos de hojas, mango que pueda funcionar con pilas tipo "c", accesorio a entregar: estuche para hojas y accesorios, con bombillo led necesario para su funcionamiento, con tres hojas reutilizables curvas no. 2,3 y 4,- con juego de pilas tipo "c" necesario para su funcionamiento.	1 und
Mascara laríngea No 4.	En empaque individual y contenidas en empaque hermético, impermeable y resellable.	1 c/d una
Sello Torácico con válvula	Sello para herida de neumotórax con válvula Estéril, empaque individual plástico.	2 und
Sonda Nasogástrica	Empaque plástico	1 und
Tubo Orotraqueal # 7- 7.5 – 8	Empaque individual y contenido en empaque hermético resellable.	1 c/d una
Aguja de descompresión torácica	Tamaño de guja calibre 14G x 8.25cm. Envase 14.4cm x 1.7cm x 2cm.	2 und

KIT DE CURACIONES		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Hilo para Sutura	Polipropileno con aguja curva cortante No 2 0 – 3 0. Absorbible	1 und
Porta Agujas	Porta agujas recto, con sistema de cierre tipo cremallera, en acero inoxidable, tamaño 14 o 16 cms	1 Und
Equipo de pequeña cirugía	Empaque impermeable de (5 piezas)	1 und
Esparadrapo Hipoalergénico	Empaque plástico impermeable, color piel de 2" x 10 yardas.	1 rollo
Solución salina	Bolsa. Concentración 0.9%, 250 ml. Empaque individual en plástico.	1 und
Yodopovidona	Frasco plástico espuma máximo 120 ml	1 und
KIT DE INMOVILIZACIÓN		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Férula de aluminio maleable	Empaque individual plástico.	3 rollos
Inmovilizador Cervical	Graduable mínimo 5 Tallas Adulto en Plástico. Empaque individual.	1 und
Venda Triangular	Fabricado en material textil, tela color verde – militar, resistente, suave al tacto y de fácil manejo, de 90x90x125 cm empacado individual e impermeable con rotulo o impresión que contenga información ficha técnica de uso, en su exterior.	2 und
VARIOS		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Fonendo y tensiómetro	Empaque impermeable	1 und
Manillas para clasificación	Adhesivo circular a la muñeca, de material duradero, y resistente al agua con sistema de fácil ajuste y seguridad, deben estar identificadas por colores de acuerdo a los colores internacionales de clasificación de víctimas (negro, rojo, amarillo y verde), cada paquete lo conforman 4 manillas una de cada color) Empaque individual en bolsa plástica con cierre hermético.	2 x c/d color
Marcador	Grueso, tinta no Borrable, color negro y mina gruesa.	1 und
Recipiente Plástico	Caja con tapa y compartimentos suficientes para empacar los medicamentos.	1 und
Tarjeta de evacuación	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color de dimensiones 12 cm x 16 cm de largo.	10 und

Tarjeta de inventario	Elaborada en material resistente al agua (plastificada que permita la escritura), doble cara a color medidas: 13 cm de ancho x 17 cm de largo Debe contener 6 columnas que describan: ítem, categoría, nombre del elemento, presentación, cantidad, empleo o indicaciones de uso del elemento. Empacada individual en bolsa plástica con cierre hermético.	1 und
Termómetro Digital	En empaque plástico rígido.	1 und
Tijeras de trauma	Hojas metálicas (acero inoxidable) con mango plástico color negro. Mínimo 18 cm de largo x 9 cm de ancho esterilizables en empaque plástico con cierre hermético.	1 und
DEA	Equipo de batería recargable y/o baterías de larga duración, liviano de fácil transporte. Con modo de carga rápida entre 7 y 10 segundos. Menú de funcionamiento con opción en español que brinde instrucciones de análisis de compresión y recomendación de descarga de energía al paciente durante procedimiento de reanimación cardiopulmonar, indicación sonora del análisis del ritmo cardiaco, con alarma de nivel de carga de la batería, alarma desconexión del paciente audible y visual, debe incluir baterías. Debe incluir (01) juego de parches adhesivos correspondientes, Se debe hacer entrega de certificado de calibración, con guía rápida de manejo, con manual de usuario y técnico original con traducción simple al español, con registro sanitario INVIMA vigente, debe anexar certificado de fábrica (Si el dispositivo es para uso de vuelo se debe adicionar las certificaciones correspondientes)	1 und
KIT DE MEDICAMENTOS		
ELEMENTO	**CARACTERISTICAS GENERALES**	**CANT.**
Adrenalina	Ampolla 1 mg	10 und
Atropina	Ampolla 1mg	4 und
Cefalotina	Ampolla 1 gr	4 und
Diclofenaco	Ampolla 75 mg inyectable	3 und
Dipirona	Ampolla 2 g	5 und
Fentanilo	Ampolla 0,5mg/5ml	1 und
Hidrocortisona	Ampolla 100 mg	3 und
Gentamicina	Ampolla 160 mg	4 und
Jeringa 20 cc	Empaque individual y contenido en empaque hermético, impermeable y resellable.	2 und

Jeringa 5 cc	Empaque individual y contenido en empaque hermético, impermeable y resellable.	15 und
Jeringa 3 cc	Empaque individual y contenido en empaque hermético, impermeable y resellable.	10 und
Lidocaína gel	Tubo	1 und
Lidocaína sin epinefrina	2% Ampolla	1 und
Metoclopramida	Ampolla 10 mg	2 und
Midazolam	Ampolla de 5mg/5ml	3 und
Tramal	Ampolla de 50 mg	4 und
Vecuronio bromuro	Ampolla de 10 mg/2.5 ml polvo liofilizado para solución inyectable	1 und

ANEXO 6: Formatos de control y reporte

Los formatos que se relacionan en este anexo, serán enviados de forma magnética a cada una de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, con los fines relacionados y establecidos en la presente directiva.

- Formato Hoja de Gasto Insumos Botiquines.

DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCION DE SALUD GRUPO SALUD OPERACIONAL	Formato Hoja de Gasto Insumos y medicamentos Botiquines - DIGSA Proceso: Salud Operacional

UNIDAD APOYADA							
NOMBRE SOCORRISTA		GRADO		PERFIL		OTRO	
TELEFONO							
TIPO DE BOTIQUIN							
ESMCLE APOYA							
SOPE ESM							

ITEM	INFORMACIÓN DEL PACIENTE			INFORMACIÓN DEL EVENTO				INFORMACION DE GASTOS					OBSERVACIONES
No.	GRADO	No. IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DIA	MES	AÑO	DIAGNÓSTICO O CAUSA	INSUMO UTILIZADO	CANTIDAD	COSTO	MEDICAMENTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	
1													

- Formato Hoja de Reabastecimiento Insumos Botiquines.

DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCION DE SALUD GRUPO SALUD OPERACIONAL	Formato Hoja de Reabastecimiento Insumos Botiquines - DIGSA Código: Proceso Salud Operacional

UNIDAD APOYADA						
DATOS DEL RESPONSABLE DEL BOTIQUIN		GRADO		PERFIL		
TELEFONO						
ESMCLE APOYA						
SOPE ESM						

ITEM	FECHA	RESPONSABLE DEL BOTIQUIN			TIPO DE BOTIQUIN DOTACION DE INSUMOS	RELACION DE DOTACION DE INSUMOS			OBSERVACIONES
No.		NOMBRE COMPLETO	GRADO	PERFIL		INSUMO	CANTIDAD	COSTO	
1									

- Formato Informe de Botiquines.

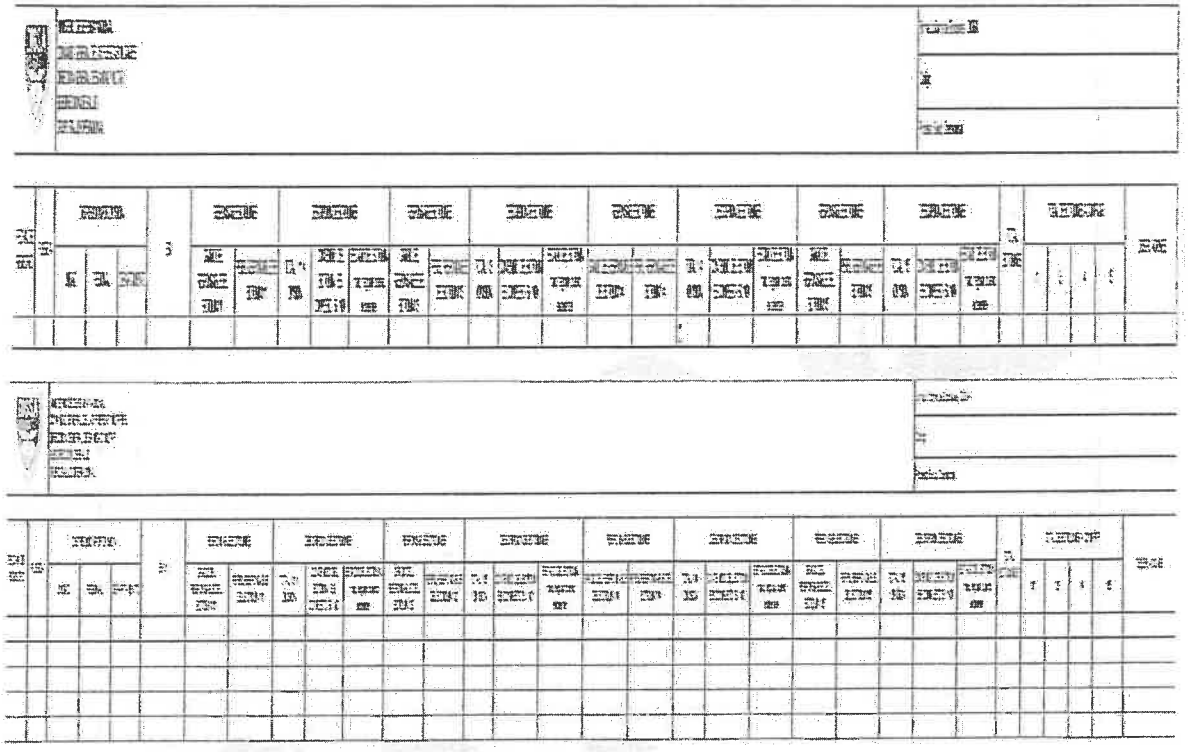

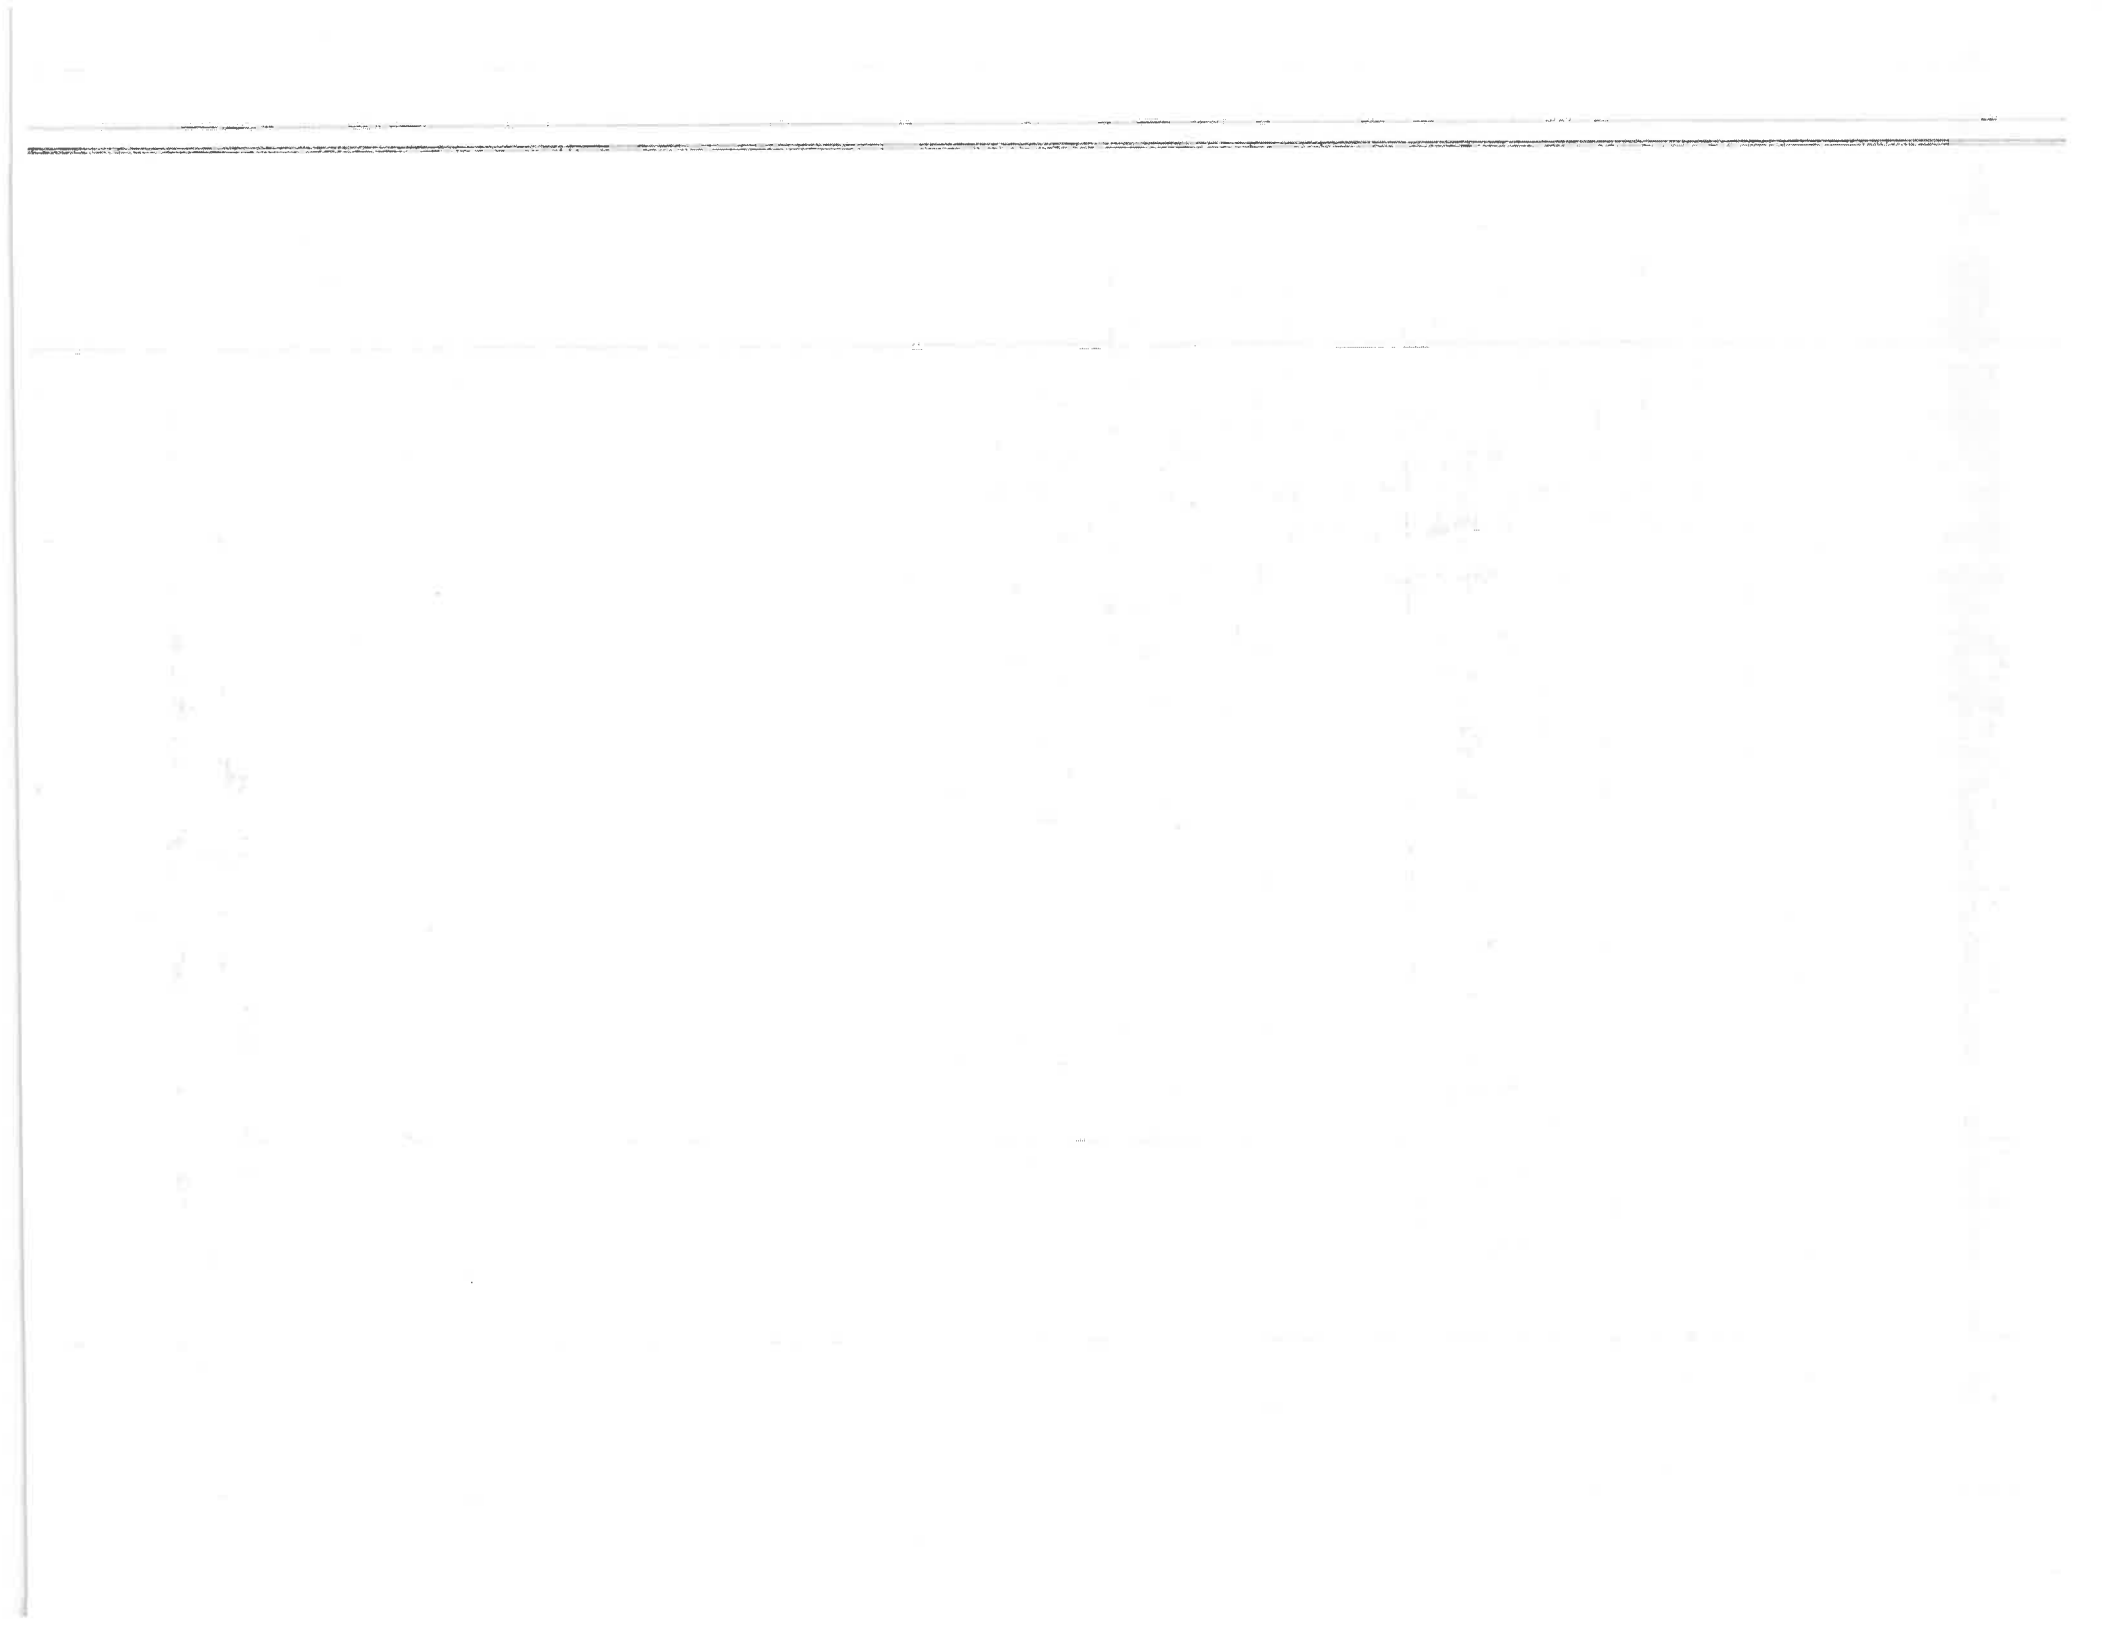

CARACTERIZACION DE FASE II – LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

1. **Titulo:** PROCESO DATOS MAESTROS (MAESTRO DE MATERIALES – MAESTRO DE SERVICIOS)

Fecha: abril 28 de 2009	**Versión:**	**Página:** Página 1 de 12

OBJETIVO: Registrar el dato maestro de materiales y de servicios de manera unificada y centralizada para el Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares y el HOMIC con el fin de generar información útil y razonable

ALCANCE :
Desde : Diligenciar el formato de solicitud de la creación del dato maestro de materiales o servicios
Hasta: Informar al solicitante la creación del dato maestro solicitado

PROVEEDOR	ENTRADA	DIAGRAMA DE FLUJO	SALIDA	CLIENTE
MDN, HOMIC, DGSM, DISANES Áreas de servicios de organización MDN, HOMIC DGSM, DISANES	Decretos, resoluciones Manuales de procedimiento, circulares. Contratos, actas de cambio, resoluciones, actas de reintegro actas de donación actas de sobrantes, actas de reposición, comprobantes de trasferencias y solicitudes de traslado, convenios de comodato,	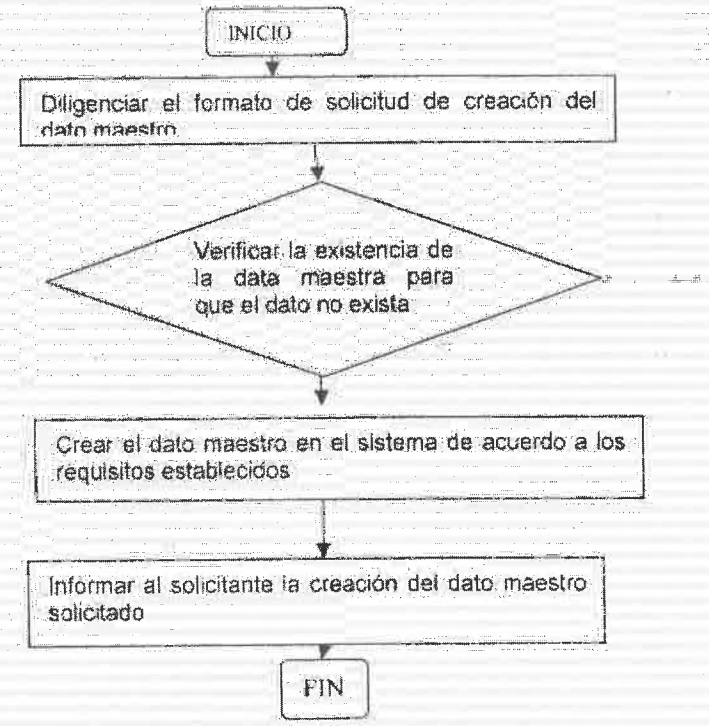	Dato maestro de material y servicio	Área de contratos, División Financiera, Almacenes

Elaborado Por:	FECHA:	Revisado Por:	FECHA:	Aprobado Por:	FECHA:
USUARIOS Y CONSULTORES MODULO MM		SILOG		GERENCIA PROYECTO	

CARACTERIZACION DE FASE II – LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

1. Titulo: PROCESO DATOS MAESTROS (MAESTRO DE MATERIALES – MAESTRO DE SERVICIOS)

Fecha: abril 28 de 2009	Versión:	Página: Página 2 de 12

01. DESCRIPCION DEL PROCESO

PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES	REGISTROS
1. Diligenciar el formato de solicitud de creación del dato maestro	Jefe de Precontractual, Jefe de Contratos y/o Almacenista	
2. Verificar la existencia de la data maestra para que el dato no exista No: Continua el proceso. Si: se Informa al solicitante el número de material o servicio y termina el proceso.	Lider de datos de SILOG	
3. Crear el dato maestro en el sistema de acuerdo a los requisitos establecidos	Lider de datos de SILOG	
4. Informar al solicitante la creación del dato maestro solicitado	Lider de datos de SILOG	

RECURSOS	REQUISITOS SGC	PARAMETROS DE CONTROL
Se deben identificar los recursos que son necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes al proceso *Ej: Equipo de Oficina, Talento Humano, Boletines Informativos*	Identifique los Numerales de la Norma NTCGP 1000 que aplican a cada proceso	Verificar la identificación del dato según los requerimientos del dato maestro Verificar en los datos maestros existentes según todas las opciones de identificación con el fin de evitar la creación de datos duplicados Verificar el código CUBS, el rubro presupuestal, la descripción, la unidad de medida del dato a crear

Elaborado Por:	FECHA:	Revisado Por:	FECHA:	Aprobado Por:	FECHA:
USUARIOS Y CONSULTORES MODULO MM		SILOG		GERENCIA PROYECTO	

RIESGOS	REQUISITOS LEGALES	CONDICIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR
1. Crear datos existentes con otro nombre 2. Crear datos con el mismo nombre con requisitos distintos (rubro presupuestal código CUBS, unidad de medida) 3. Solicitar la creación de datos ya creados en el sistema	Decreto No 791 del 5 de abril de 1979 "Por el cual se aprueba el Reglamento de Procesos Administrativos por pérdidas o daños de los bienes destinados al servicio del Ramo de Defensa Nacional" Articulo 267 de la Constitución Política de 1991 por medio del cual se suprime el control previo que ejercía la Contraloría General de la República, se consagra el control posterior y selectivo. Articulo 269 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra como obligación para las entidades públicas, diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley. Ley 42 del 26 de enero de 1993 "Sobre la organización del Sistema de Control Fiscal Financiero y organismos que lo ejercen". Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", y sus Decretos Reglamentarios". Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" Ley 298 del 23 de julio de 1996 "Por la cual se desarrolla el articulo 354 de la Constitución Política de la República de Colombia, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones". Decreto No. 2145 del 4 de noviembre 1999. "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único" Decreto 2200 de 2005 Mediante el cual se reglamenta el servicio farmacéutico	Normas de Seguridad para Centros de Computo (EIATIA 942) (QUEDA ASI)

Decreto de Liquidación del Presupuesto Anual de la Nación mediante el cual se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".

Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación

Resolución No. 355 del 5 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública".

Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública

Resolución No. 375 del 17 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se modifica los artículos 10 y 11 de la Resolución No. 248 de 2007, respecto de los puntos de reporte de la información contable a la Contaduría General de la Nación".

Resolución No. 393 del 28 de septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se adopta el Manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable MCICO 2007:1

Resolución 4748 de 2008 del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se modifica el Manual de Procedimientos administrativos y contables, para el manejo de bienes de las Unidades Ejecutoras.

INDICADORES

Número de datos maestros creados / Número de solicitudes de creación de datos

Elaborado Por:	FECHA:	Revisado Por:	FECHA:	Aprobado Por:	FECHA:
USUARIOS Y CONSULTORES MODULO MM		SILOG		GERENCIA PROYECTO	

02. DEFINICION DE TABLAS DE CONFIGURACION

TIPOS DE MATERIAL
RANGOS DE NUMEROS
GRUPO DE ARTICULOS
UNIDADES DE MEDIDA
RAMO
VISTA DE FARMACIA

03. CAMBIOS A LA ORGANIZACIÓN EXISTENTE

El maestro de materiales es único para el HOMIC y para el Subsistema de Salud de las FFMM.

04. DESCRIPCION DEL DEFICIT FUNCIONAL
N/A

05. ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DEL DEFICIT FUNCIONAL
N/A

06. CONSIDERACIONES DE CONFIGURACION

EXPLICACION GENERAL

En este documento se identificarán los datos necesarios para ser incorporados en el catálogo de materiales, gestión de lotes y maestro de servicios en el sistema.

MAESTRO DE MATERIALES

El maestro de materiales contiene información sobre todos los materiales que una compañía suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos específicos de los materiales para la empresa. Esta información se almacena en registros maestros de materiales individuales.

INTEGRACION

Todos los componentes de Logística utilizan el maestro de materiales. La integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos individual elimina el almacenamiento de datos redundantes. En Logística, los datos contenidos en el maestro de materiales son necesarios, por ejemplo, para las siguientes funciones:

En Compras, para la gestión de pedidos.
En Gestión de stocks, para la contabilización de movimientos de material y el inventario.

En Verificación de facturas, para la contabilización de facturas.
En Comercial para la gestión de pedidos de cliente
En Planificación de la producción, para la planificación de necesidades, programación y la planificación de trabajo.

TIPOS DE MATERIAL

Los materiales que tienen los mismos atributos básicos se agrupan y se asignan a un tipo de material. De este modo se pueden gestionar diversos materiales de manera uniforme según las necesidades de la empresa con rango de números y vistas de datos diferentes.

Los tipos de material definidos son, se definió que para diferenciarlos de los creados por SILOG se iniciaría su denominación por la letra Y.

ZMED – Medicamentos
ZMQX – Insumos Medicoquirúrgicos
ZFER – Productos terminados
ZDIE – Servicios para la venta
ZROH – Materia Prima

De los tipos de materiales definidos por el SILOG se utilizaran los siguientes:

ZCOM – Repuestos y accesorios de comunicación
ZTRA – Repuestos y accesorios de Transporte
ZINS – Insumos y Elementos misceláneos
ZALM – Alimentos
ZCOF – Devolutivos de Comunicaciones
ZACT – Activos Fijos
ZMAF – Devolutivo de Herramientas
ZTRF – Devolutivo de Transporte

RANGOS DE NUMEROS

Debe crear un registro maestro en el maestro de materiales para cada uno de los materiales que utiliza su empresa. Este registro se identifica únicamente con un número de material.

En el sistema se dispone de los siguientes tipos de asignación de números:

Asignación de números externa. Si utiliza claves nemotécnicas (normalmente alfanuméricas) se indica el string que se desea utilizar como número de material cuando se crea el registro maestro de materiales.

Asignación de números interna. Si utiliza claves no nemotécnicas, no introduzca un número de material cuando cree un registro maestro de materiales. En su lugar, el sistema asigna un número consecutivo al material. Este número es visible cuando se actualiza el registro maestro de materiales.

ZMED:
ZMQX
ZFER:
ZDIE:
ZROH:

GRUPO DE ARTICULOS

Los grupos de articulos permiten la posibilidad de agrupar los materiales con las mismas propiedades o con el mismo destino de utilización, el SILOG lo estableció para los CODIGOS CUBS al segundo nivel y se utilizaran los mismos.

Los grupos farmacológicos se manejaran por medication

En el caso de los medicamentos se manejarán las condiciones de temperatura y condiciones de almacenaje

UNIDADES DE MEDIDA

Se requiere crear las siguientes unidades de medida diferentes a las estándar para el manejo de los medicamentos e insumo medicoquirúrgicos:

AEROSOL
AMPOLLAS
APLICADOR
BOLSA
CAJA
CAPSULAS
CARPULAS
COLIRIO
COMPRIMIDOS
CREMAS
ESTUCHE
FRASCO
GALON
GARRAFA
INHALADOR
JERINGA

JUEGO
KILO
KIT
LATA
MINICURIOS
MILIGARMOS
MILILITRO
PAQUETE
PAR
PRUEBAS
ROLLO
SET
SOBRE
SOLUCION
TABLETAS
TARROS
TUBO
UNIDAD
VIAL

Unidad de medida base

Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material (Unidad mínima). El sistema convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base.

Unidades de medida alternativas

Por ejemplo, Gestión de compras puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestión de Stock (salida). Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan unidades de medida alternativas. El Sistema admite las siguientes unidades de medida alternativas:

Unidad de medida de pedido: Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de pedido se propone automáticamente en las funciones de compras, donde puede ser modificada.

Unidad de medida de venta: Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de venta se propone automáticamente en los pedidos de cliente, donde puede ser modificada.

Unidad de medida de salida: Unidad de medida en la que el material sale del almacén. El sistema permite que se registren consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la unidad de medida base y de la unidad de medida de almacén.

Si se manejan unidades de medida alternativas, para las cuales se requiere en el maestro de materiales crear los distintos factores de conversión.

RAMO:

Los ramos tienen funciones de control en el Sistema, igual que los tipos de materiales. Es, por ejemplo, un factor que determina la secuencia de pantallas y la selección de campos en un registro maestro de materiales. Cuando se crea un registro maestro de materiales, debe clasificar el material según el ramo y el material. Una vez ha asignado un ramo a un material, ya no puede volver a modificar el ramo.

SILOG autorizó crear para SISAM r un ramo **S- Sector Salud** para poder activar la vista de farmacia para los medicamentos. Por lo tanto se utilizará el definido por SILOG

CONTROL DE PRECIOS:

En el Sistema de SAP existen dos tipos de control de precio

Precio estándar (S)
Precio medio variable (V)

Se definió que se utilizara el control de precios como Precio Medio Variable (Promedio Ponderado por ESM) de acuerdo a lo parametrizado en SIIF

La valoración mediante un precio medio variable tiene los siguientes resultados:

- Las entradas de mercancías se contabilizan con el valor de entrada de mercancías.
- El precio en el maestro de materiales se ajusta de acuerdo al stock y al precio de la entrada.
- Si a un material se le asigna un precio medio variable (PMV), el precio se ajustará automáticamente en el registro maestro de materiales. Si se contabilizan los movimientos de mercancías o las recepciones de factura utilizando un precio diferente al precio medio variable, se contabilizan las diferencias en la cuenta de existencias, por consiguiente, el precio medio variable y el valor de stocks se modifican.

VALORACION DE STOCKS

El sistema permite valorar stocks de un material conjuntamente o por separado, es decir, en función de los distintos criterios de valoración. La valoración

separada es necesaria si, por ejemplo:

El stock de fabricación propia tiene un precio de valoración distinto al del stock de aprovisionamiento externo.
El stock conseguido de un fabricante o proveedor se valora con un precio diferente al stock obtenido de otro.
Los stocks de un material de lotes distintos tienen precios de valoración distintos

Estos datos se almacenan en el registro maestro de materiales determinando.

Valoración unitaria

Si desea valorar todos los stocks de un material a un mismo precio no especifique ni un tipo ni una clase de valoración.
Valoración separada

Si desea valorar stocks de un material por separado, debe crear un registro maestro de materiales con el tipo de valoración adecuado. Este registro se denomina "registro de cabecera de valoración". Cada material tiene siempre sólo uno de estos registros para cada centro (ESM).
Una vez especificado el tipo de valoración, se puede crear un registro maestro de materiales para cada cantidad de material que desee valorar por separado, con la clase de valoración y los datos de finanzas adecuados

Se tiene contemplado utilizar en SISAM tres tipos de valoración de stock.

- Para los materiales propios.
- Para los materiales del operador logistico
- Para las donaciones de Plan Colombia

GESTION DE LOTES

Los materiales que requieren una identificación muy precisa, por ejemplo, los productos farmacéuticos y medico quirúrgicos los alimentos, se identifican y gestionan en stock no sólo en función del número de material, sino también en función del número de lote

Mediante la gestión de lotes, se pueden gestionar no sólo lotes de fabricación propia sino también lotes de fabricación de proveedores como entidades independientes.

Para poder gestionar lotes de un material en stock, antes es preciso indicar en el registro maestro de materiales que el material se gestionará en lotes en el centro (ESM) especificado. Para ello, se debe fijar el indicador de sujeción a lotes en el registro maestro de materiales

Si un material está sujeto a la gestión en lotes, todas las cantidades de dicho material deben asignarse a un lote. Cada lote de material se identifica con un número de lote único, con el cual se gestiona. Este número lo indica el usuario (asignación de números externa) en el momento de realizar la entrada del material al almacén.

Si un material sujeto a valoración separada está sujeto también a la gestión en lotes, no se gestionan sus datos de stock por clase de valoración sino por lote. Cada lote se debe asignar a una clase de valoración.

MAESTRO DE SERVICIOS

Gestión de servicios es un componente de aplicación dentro del módulo Gestión de materiales (MM). Ofrece soporte al ciclo completo de requisición, licitación, la fase de adjudicación/supervisión de pedidos y la aceptación de servicios, así como el proceso de verificación de facturas.

En el Registro maestro de servicios, se pueden almacenar las descripciones de todos los servicios que puede ser necesario adquirir.

Un registro maestro de servicios comprende la siguiente información vital para la descripción unívoca de un servicio:

- Número de servicio
- Tipo de servicio
- Textos descriptivos (texto explicativo y texto breve)
- Unidad de medida base
- Grupo de material
- Categoría de valoración

Se requieren dos campos adicionales para el rubro presupuestal y para el código CUBS.

Catalogo de Prestaciones Modelo:

Un catálogo de prestaciones puede constar de un número cualquiera de posiciones de servicio, descripciones asociadas, junto con la determinación de precios, datos de cantidad y vigencia. Conjunto de catálogos de prestaciones que sirve de modelo para crear prestaciones adicionales.

El catálogo de prestaciones modelo se considera como un registro maestro en Gestión de servicios. Y se tiene contemplado su manejo para la prestación de servicios médicos hospitalarios

Se utilizara el maestro de servicios de SILOG adicionando los faltantes para SISAM.

07. CONSIDERACIONES DE CONVERSION DE DATOS
N/A

08. CONSIDERACIONES DE INTERFASES
N/A CON SIIF

09. CONSIDERACIONES DE FORMULARIO
N/A

5. CONSIDERACIONES DE REPORTES o DESARROLLOS

Programa de Cargue de Materiales, Lotes y Servicios
Listado de materiales y servicios con los datos que lo componen

FIRMAS:

MARTHA ISABEL UBAQUE DELGADO
LIDER MODULO LO SISAM

DIANA CELIS
CONSULTORA LIDER MM SISAM

CR. ALFONSO DUARTE
LIDER MODULO LO SILOG

WILLIAM HERNANDEZ
REPRESENTANTE GERENCIA CONSULTORIA

CR. ERWIN RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE DE PROYECTO SISAM

Elaborado Por:	FECHA:	Revisado Por:	FECHA:	Aprobado Por:	FECHA:
USUARIOS Y CONSULTORES MODULO MM		SILOG		GERENCIA PROYECTO	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001405 DE 2022

(-5 AGO 2022)

Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el artículo 173 numeral 7 de la Ley 100 de 1993, artículo 2, numerales 9 y 30 del Decreto - Ley 4107 de 2011, artículo 91 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 117 del Decreto-Ley 019 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en su artículo 6 señala que el derecho fundamental a la salud incluye, entre otros elementos esenciales e interrelacionados, la accesibilidad a los servicios y tecnologías de salud, y en el inciso final de su artículo 19 dispone que los agentes del Sistema de Seguridad Social en Salud -SGSSS, deben suministrar la información que requiera este Ministerio, en los términos y condiciones que este determine.

Que el artículo 117 del Decreto – Ley 019 de 2012 modificatorio del artículo 91 de la Ley 1438 de 2012, establece que este Ministerio desarrollará la codificación dispositivos médicos cuyo uso y destino sea el SGSSS.

Que para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*, existe una pluralidad de denominaciones para un mismo producto, lo que dificulta la identificación de la oferta de éstos por parte de los agentes del mercado y de los integrantes del Sistema general de Seguridad Social en Salud - SGSSS, sin permitir una optimización en la trazabilidad de los productos, generando algunos reprocesos en las acciones de las autoridades sanitarias en lo referente a la inspección, vigilancia y control - IVC.

Que la Resolución 2535 de 2013, reglamentaria del Decreto - Ley 019 de 2012, define el estándar semántico y determina sus etapas como parte integral del proceso de codificación de los insumos y dispositivos médicos, a los cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, otorgue registro sanitario o permiso de comercialización; igualmente establece que este Ministerio tendrá a su cargo, la administración de la información a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social – SISPRO, así como la coordinación de la operación del estándar semántico con la mencionada autoridad sanitaria.

Que la estandarización y codificación está dirigida a los dispositivos médicos, incluyendo los equipos biomédicos, regulados en el Decreto 4725 de 2005, y para los reactivos de diagnóstico *in vitro* reglamentados en el Decreto 3770 de 2004.

Que la finalidad de la estandarización y la codificación para estos productos es contribuir a la identificación, denominación y clasificación de estas tecnologías en

salud, facilitando su uso, trazabilidad y el intercambio de información por parte de los actores y agentes involucrados en la comercialización, distribución, inspección vigilancia y control.

Que, por lo anterior, se hace necesario estructurar e implementar un estándar semántico y de codificación para los dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico *in vitro* de uso humano en el país, que facilite la interoperabilidad en los procesos que requieran identificación, denominación y clasificación de estas tecnologías en salud.

Que el contenido de esta resolución, surtió el trámite de publicación, recibió comentarios de la ciudadanía y grupos de interés y concepto por parte de las entidades gubernamentales pertinentes, recibiéndose el informe de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, indicando que: *"En ese orden de ideas y con base en la información aportada por el regulador, esta Superintendencia encuentra que el cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en el Proyecto no representa una barrera de entrada o permanencia en el mercado de DM y RDIV ni un riesgo para el mercado en relación con la composición de su oferta y los presupuestos para su desarrollo en condiciones de libre competencia económica".*

Que en dicho concepto la SIC realizó la siguiente recomendación: *"Incluir y justificar el criterio de exclusión de reactivos in vitro sobre el cual se sustenta la incorporación del parágrafo del artículo 2 del Proyecto".*

Que, por lo anterior, se aclara que los reactivos *in vitro* grado analítico, analito específico y los de uso general en laboratorio, son utilizados para actividades propias del laboratorio clínico, y por sí solos, no son destinados a proveer un diagnóstico; de igual forma, los reactivos *in vitro* en investigación no han alcanzado el grado de diagnóstico. En consecuencia, los anteriores reactivos *in vitro* quedan exceptuados del alcance de esta resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. ***Objeto.*** La presente resolución tiene por objeto establecer los atributos del estándar semántico y codificación de los dispositivos médicos de uso humano – DM y los reactivos de diagnóstico *in vitro* - RDIV que se comercialicen en el país, definiendo los procedimientos y plazos para su adopción e implementación, como dato único de reporte y trazabilidad para el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, conforme a lo descrito en los Anexos Técnicos 1 y 2, que hacen parte integral de este acto.

Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos *in vitro* grado analítico y analito específico, los de uso general en laboratorio y los *in vitro* en investigación.

Artículo 2. ***Ámbito de aplicación.*** Las disposiciones contenidas en la presente resolución son de obligatorio cumplimiento por parte de los titulares de los registros sanitarios, de permisos de comercialización o sus autorizados, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los prestadores independientes, las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, las Secretarías de Salud Departamentales y Distritales, las entidades responsables del pago de servicios de

salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, la Superintendencia Nacional de Salud y agentes relacionados con la comercialización y distribución de los productos objeto de esta resolución.

Artículo 3. ***Definiciones.*** Para efectos de la aplicación de la presente resolución, además de la definición de estándar semántico establecida en el artículo 3 de la Resolución 2535 de 2013 y de aquellas establecidas en los Decretos 4725 de 2005 y 3770 de 2004, o las normas que los modifiquen o sustituyan, se tendrán en cuenta las siguientes:

3.1. Agencia emisora de códigos. Institución acreditada por autoridades que acogen el UDI-DI para operar el sistema de expedición *de Unique Device Identifier* -Código UDI- de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*.

3.2. Atributos del estándar semántico: Son las denominaciones, cualidades o propiedades del dispositivo médico de uso humano y el reactivo de diagnóstico *in vitro*, en cuanto a su descripción genérica, regulatoria y comercial, requeridas en el sistema de salud en Colombia.

3.3. Autorizado: Persona natural o jurídica a la cual el titular de los registros sanitarios o de permisos de comercialización, faculta para obtener el código y realizar el reporte del identificador de dispositivo médico y reactivo de diagnóstico *in vitro*.

3.4. Código GMDN: Combinación única internacional de números de carácter confidencial y de acceso para el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA, los titulares de los registros sanitarios, de permisos de comercialización o sus autorizados, asignado por la Agencia GMDN, a través del cual se obtiene información del nombre genérico, definición, componentes y uso del dispositivo médico y del reactivo de diagnóstico *in vitro*.

3.5. Identificador del dispositivo médico y reactivos de diagnóstico *in vitro* – IDM: Es un código de carácter público que corresponde al código ID del UDI expedido por las agencias emisoras de códigos acreditadas para ello, el cual permite la identificación específica de cada uno de los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro,* que se comercializan y usan.

3.6. Identificador Único de Dispositivos Médicos UDI-DI: Es un código que identifica de manera única los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro.*

3.7. Nomenclatura Global de Dispositivos Médicos, *Global Medical Device Nomenclature* – GMDN-: Es una lista de denominaciones genéricas, estandarizada universalmente para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*.

3.8. Término GMDN: Denominación o definición del dispositivo médico de uso humano o un reactivo de diagnóstico in vitro, definido por una expresión lingüística.

Capítulo II
Estructura del estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso humano y para los reactivos de diagnóstico *in vitro*

Artículo 4. ***Atributos del estándar semántico de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro.*** El estándar semántico de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro,* está integrado por los

siguientes atributos, los cuales se encuentran desarrollados en el Anexo Técnico 1 de la presente resolución:

4.1. Atributos básicos:

4.1.1. Identificador del dispositivo médico y del reactivo de diagnóstico *in vitro*, de acuerdo con el código UDI-DI.
4.1.2. Código GMDN del dispositivo médico y del reactivo de diagnóstico *in vitro*.
4.1.3. Término GMDN del dispositivo médico y de reactivos de diagnóstico *in vitro*.
4.1.4. Número del registro sanitario/permiso de comercialización del dispositivo médico y de reactivo de diagnóstico *in vitro*.
4.1.5. Agencia emisora de códigos.

4.2. Atributos regulatorios:

4.2.1. Datos del (los) fabricante(s).
4.2.2. Clasificación de riesgo del dispositivo médico según el Decreto 4725 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya.
4.2.3. Categoría del reactivo de diagnóstico in vitro según el Decreto 3770 de 2004 o la norma que lo modifique o sustituya.
4.2.4. Condición especial de almacenamiento.
4.2.5. Condición especial de empaque.

4.3. Atributos comerciales:

4.3.1. Descripción comercial (marca o signo distintivo comercial).
4.3.2. Unidad de presentación comercial (ej: caja, paquete, rollo, tarro).
4.3.3. Unidad mínima de consumo.

Parágrafo. Los catálogos de referencia del Anexo Técnico 2 serán dispuestos a través de SISPRO y corresponden a los diferentes valores utilizados para definir los atributos del estándar semántico de los productos objeto de esta resolución.

Artículo 5. ***Características del identificador del dispositivo médico y del reactivo de diagnóstico in vitro.*** El identificador del dispositivo médico - IDM- tiene las siguientes características:

5.1. Invariable: No cambia con el tiempo.
5.2. Obligatorio: Es de uso obligatorio para todos los actores y agentes descritos en el artículo 3 de la presente resolución, en todos los procesos del sector salud y que involucren el ciclo de vida de las tecnologías objeto de este acto administrativo.
5.3. Público: Es de uso público.
5.4. Único: Cada dispositivo médico y reactivo de diagnóstico in vitro tienen un solo identificador, el cual a su vez no identifica ningún otro producto contemplado en el universo de estas tecnologías.

Artículo 6. Adopción de la codificación del UDI-DI. Para la comercialización de estos productos en el país, el titular de los registros sanitarios o de los permisos de comercialización, deberá obtener el código UDI-DI otorgado por la agencia emisora de códigos y realizar el procedimiento de reporte establecido en el Capítulo III de la presente resolución.

Capítulo III
Procedimiento de reporte del estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*

Artículo 7. ***Procedimiento para reporte de información del estándar semántico del IDM.*** El procedimiento de reporte de la información del estándar semántico en el mecanismo informático que disponga el INVIMA, es el siguiente:

7.1. El titular o importador del registro sanitario, de permiso de comercialización o su autorizado deberá obtener el UDI-DI en la agencia emisora de códigos que realice la asociación a los atributos del estándar.
7.2. El titular o importador del registro sanitario, de permiso de comercialización o su autorizado, reportará ante el INVIMA la información señalada en el Anexo Técnico 1.
7.3. El INVIMA validará el reporte de la información del dispositivo médico de uso humano o del reactivo de diagnóstico *in vitro*, según corresponda. De requerir correcciones o ajustes, debe solicitarlo al titular o importador del registro sanitario, del permiso de comercialización o su autorizado, en los términos que esa entidad establezca.

Artículo 8. ***Acceso a la información por parte del INVIMA.*** Con el fin de determinar la exactitud de la información contenida en los códigos UDI-DI que son objeto de reporte, el INVIMA deberá estructurar, acordar e implementar mecanismos que le garanticen el flujo y acceso de datos generados por las agencias emisoras de códigos.

Artículo 9. ***Disponibilidad de información al SISPRO.*** El INVIMA debe disponer de manera permanente la información del estándar semántico de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro* para ser usada en todos los procesos del SISPRO.

Capítulo IV
Responsabilidades de las entidades en el uso e implementación del estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro

Artículo 10. ***Responsabilidades del INVIMA.*** El INVIMA, en el marco de las competencias definidas en el Decreto 2078 de 2012, y conforme a lo dispuesto en la presente resolución, será responsable de:

10.1. Adaptar los procesos institucionales y alojamiento de la codificación de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro* en su sistema de información para la implementación del estándar semántico de estas tecnologías de conformidad con lo descrito en esta resolución.
10.2. Realizar el monitoreo y seguimiento a la completitud y oportunidad de los datos relacionadas con el estándar semántico y codificación de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*.
10.3. Instruir a los actores y agentes obligados al reporte del código y cumplimiento de las demás condiciones dispuestas en la presente resolución.

Artículo 11. Responsabilidades de los titulares del registro sanitario o del permiso de comercialización de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*, importadores o sus autorizados. Los titulares del registro sanitario o del permiso de comercialización de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*, importadores o sus autorizados, tendrán las siguientes responsabilidades:

11.1. Presentar la información de manera completa y veraz para optimizar el reporte y procedimiento requerido para la generación de códigos UDI-DI, por parte de la agencia emisora.

11.2. Reportar ante el INVIMA el código UDI-DI en los términos establecidos en la presente resolución.

11.3. Complementar y corregir información la información, en caso de que el UDI-DI no contenga todos los atributos.

Artículo 12. Responsabilidades de otros actores. Los actores del SGSSS y demás agentes de la cadena de comercialización y distribución verificarán, a través del mecanismo electrónico que disponga el INVIMA, que los productos objeto de esta regulación cuenten con código UDI-DI.

Capítulo V
Disposiciones finales

Artículo 13. ***Tratamiento seguro de la información.*** El INVIMA garantizará la seguridad y veracidad de la información reportada, así como su reserva, confidencialidad, disponibilidad e integridad de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.

Artículo 14. ***Inspección, vigilancia y control sobre el reporte y uso del estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico In Vitro.*** El INVIMA, las Secretarías de Salud Departamentales o Distritales y la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, en el marco de sus competencias, verificarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución.

Asimismo, impondrán las medidas de seguridad y sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo señalado en la Ley 9ª de 1979, las demás normas complementarias y concordantes y conforme al procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Las autoridades que ejerzan inspección, vigilancia y control sobre los productos y actividades objeto de regulación en este acto administrativo, deberán utilizar el código UDI-DI a efectos de su identificación, en las acciones que desarrollen en el marco de sus competencias.

Artículo 15. ***Disposición Transitoria.*** Se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones transitorias:

15.1. El INVIMA tendrá un término de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de la presente resolución, para realizar las acciones tendientes a la implementación del estándar semántico y codificación de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico *in vitro*. El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá, en este mismo periodo, los catálogos a través de los servicios web desde la plataforma SISPRO.

15.2. Los productos objeto de esta regulación que cuenten con registro sanitario vigente, para la fecha en la que se cumpla el término señalado el numeral 15.1, tendrán los siguientes plazos máximos para realizar el cargue de la información:

15.2.1. Fase 1. Los dispositivos médicos de uso humano clase III y reactivos de diagnóstico *in vitro* categoría III: doce (12) meses contabilizados desde la culminación del término dispuesto en el numeral 15.1.

15.2.2. Fase 2. Los dispositivos médicos de uso humano clase IIb y reactivos de diagnóstico *in vitro* categoría II: dieciocho (18) meses contabilizados desde la culminación del término dispuesto en el numeral 15.1

15.2.3. Fase 3. Los dispositivos médicos de uso humano clases IIa y I y reactivos de diagnóstico *in vitro* de categoría I: veinticuatro (24) meses contabilizados desde la culminación del término dispuesto en el numeral 15.1.

Parágrafo. Los productos que obtengan registro sanitario o permiso de comercialización, posterior al término establecido en el numeral 15.1, no se les aplicará transitoriedad y por lo tanto deberán obtener y reportar el código, previo a la comercialización del dispositivo médicos de uso humano o del reactivo de diagnóstico *in vitro*.

Artículo 16. ***Vigencia.*** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los -5 AGO 2022

FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud y Protección Social

Aprobó:
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios
Directora Jurídica
Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Jefe de Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación

Continuación de la resolución *"Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro"*.

ANEXO TÉCNICO No. 1

DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DEL ESTÁNDAR SEMÁNTICO Y CODIFICACIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO *IN VITRO* EN COLOMBIA

Siglas utilizadas:

- **Tipo de dato:** N= Numérico, A= Alfanumérico (números, letras y caracteres especiales), F= Fecha, T = Texto (Solo letras y caracteres especiales).

Atributos		Descripción	Valores permitidos	Tipo de dato	Longitud
Atributos Básicos					
Identificador del dispositivo médico – IDM	Código	Código asignado por la agencia emisora de códigos	Hasta diecinueve (19) caracteres alfa numéricos del UDI – DI	A	19
Código GMDN	Código GMDN	Código de la agencia nomenclatora GMDN-*Global Medical Device Nomenclature*.	El valor corresponde al asignado al dispositivo por GMDN. Este código no es público, se usa solo para fines de interoperabilidad entre el Ministerio de Salud y Protección Social, titular del registro sanitario o permiso de comercialización o importador o su autorizado e INVIMA	N	5
Término GMDN	Término	Definición del dispositivo médico dada por la Agencia del GMDN	Definición del dispositivo dada por la Agencia del GMDN	T	250
Registro sanitario/permiso de comercialización	Año	Año de expedición del registro sanitario/permiso de comercialización	Cuatro (4) dígitos	N	4
	Clase		DM EB RD	T	2
	Guion	Separador	Guion (-)	A	1
	Número	Número	Número generado por el INVIMA	N	7
Agencia emisora de códigos	Nombre	Nombre de la agencia que expidió el código UDI-DI		A	250
Atributos Regulatorios					
Datos del (los) fabricante (s)	Código de país	Código del país de acuerdo con la norma ISO 3166 dos caracteres	Ver Anexo Técnico 2. Tabla "Código de país"	A	2
	Tipo de documento de identificación del (los) fabricante (s)	Es el tipo de identificación que se asigna a la persona natural o jurídica que es responsable de la fabricación del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico *in vitro*.	Son permitidos los siguientes tipos de documento de identificación: Para residentes en Colombia: CC = Cédula de ciudadanía. CE = Cédula de extranjería. PA = Pasaporte NI = Número de Identificación Tributaria si es una empresa nacional. Para el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras no residentes en Colombia se aplica el	A	2

Continuación de la resolución *"Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro"*.

Atributos	Descripción		Valores permitidos	Tipo de dato	Longitud
			tipo de documento de identificación. DE = Documento de extranjero.		
	Número de documento de identificación del (los) fabricante (s)	Número de documento que identifica de manera única a la persona natural o jurídica que es responsable de la fabricación del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico *in vitro*.	Para el caso de residentes en Colombia se permite el número de documento de identificación de la persona natural o jurídica asociado a los tipos de documento de identificación permitidos. Para el caso de persona natural o jurídica extranjeras no residentes en Colombia se utiliza el número de documento de identificación que aplique al fabricante en su país.	A	17
	Nombre o razón social del (los) fabricante (s)	Es el nombre o razón social del (los) fabricante (s) del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico *in vitro*.		A	250
Clasificación de Riesgo del dispositivo médico		Tipo de clase de riesgo del dispositivo médico de acuerdo a la normatividad vigente.	De acuerdo con Tabla de Clasificación de Riesgo del dispositivo médico. Anexo Técnico 2.	A	3
Categoría del reactivo de diagnóstico *in vitro*		Tipo de categoría de riesgo para el reactivo de diagnóstico *in vitro*, de acuerdo con la normatividad vigente.	De acuerdo con Tabla de Clasificación de Riesgo del reactivo de diagnóstico *in vitro*. Anexo Técnico 2.	A	3
Condición especial de almacenamiento		Descripción de las condiciones especiales de almacenamiento según criterios establecidos por el fabricante.	De acuerdo con la Tabla de referencia Condición especial de almacenamiento. Anexo Técnico 2	N	2
Condición especial de empaque		Descripción de las condiciones especiales de empaque según criterios establecidos por el fabricante.	De acuerdo con la Tabla de referencia Condición especial de empaque. Anexo Técnico 2	N	2
Atributos Comerciales					
Descripción comercial del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico *in vitro*	Marca o signo distintivo comercial	Descripción dada por el fabricante nacional o extranjero que corresponde a la expresión que aparece en las etiquetas e insertos del producto y que distingue al producto de los demás con las mismas características.	Cuando el dispositivo médico se comercialice con su descripción genérica se debe diligenciar la expresión, palabra o palabras que en la etiqueta e inserto diferencien al fabricante de los demás fabricantes.	A	250
Unidad de Presentación Comercial		Relacionada como presentación comercial dada por el fabricante al dispositivo médico o reactivo de diagnóstico in vitro.	De acuerdo con la Tabla de Unidad de presentación comercial. Anexo Técnico 2	N	2
Unidad mínima de consumo		Relacionada con la unidad mínima de consumo en el paciente o usuario final	De acuerdo con la Tabla de Unidad Mínima de Consumo. Anexo Técnico 2. Solo aplica para Unidad y Prueba	N	2

Continuación de la resolución *"Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro"*.

ANEXO TÉCNICO No. 2

CATÁLOGOS DE REFERENCIA DEL ESTÁNDAR SEMÁNTICO Y CODIFICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO *IN VITRO*

Siglas utilizadas:

- **MSPS**: Ministerio de Salud y Protección Social

Atributos	Descripción	Catálogo de referencia
TABLAS DE REFERENCIA		
Clasificación de riesgo del dispositivo médico	Tipo de clase de riesgo de acuerdo con la normatividad vigente.	Catálogo de Clasificación de Riesgo del dispositivo médico, disponible en web.sispro.gov.co, donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados
Categoría del reactivo de diagnóstico *in vitro*	Tipo de categoría de riesgo de acuerdo con la normatividad vigente.	Catálogo de Categoría del reactivo de diagnóstico *in vitro*, "disponible en web.sispro.gov.co, donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados o que sustituyan los mencionados en este campo.
Condición especial de almacenamiento	Reglas especiales que el fabricante determina para el almacenamiento de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico *in vitro*, teniendo en cuenta el ciclo de vida y características propias de los mismos.	Catálogo de condición especial de almacenamiento, disponible en web.sispro.gov.co donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados.
Condición especial de empaque	Reglas especiales que el fabricante determina para el empaque de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico *in vitro*, teniendo en cuenta el ciclo de vida y características propias de los mismos.	Catálogo de condición especial de empaque, disponible en web.sispro.gov.co donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados.
Unidad de presentación comercial	Unidad establecida por el fabricante en la etiqueta del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico *in vitro*, que determina la presentación comercial para la comercialización y uso final	Catálogo de presentaciones comerciales, disponible en web.sispro.gov.co donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados.
Unidad mínima de consumo.	Unidad establecida como la unidad mínima de consumo del dispositivo médico o reactivo de diagnóstico In vitro en el paciente o usuario final.	Catálogo de presentación mínima de consumo disponible en web.sispro.gov.co, donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados
Código de País del fabricante	Codificación de países de acuerdo con la norma ISO 3166 dos caracteres	Catálogo de códigos de países disponible en web.sispro.gov.co, donde encontrará los valores permitidos, modificados, adicionados

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000184 DE 2024

(08 FEB 2024)

Por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos

El MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En uso de sus facultades legales, en especiales conferidas en el artículo 86 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 23 de la Ley 1751 de 2015, el numeral 9 del artículo 2 y el numeral 1 del artículo 25 ambos del Decreto 4107 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 determina una garantía universal de accesibilidad a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y señala que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que la 60° Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución WHA60.29 en mayo de 2007, en la cual, basados en la necesidad de ampliar los conocimientos especializados sobre tecnologías sanitarias, sobre todo en los dispositivos médicos, instó a los países miembros a jerarquizar las necesidades y los recursos basados en información, implantar sistemas de evaluación, planificación, adquisición y gestión de tecnologías y a elaborar directrices sobre prácticas adecuadas de fabricación y reglamentación.

Que en el artículo 2 de la Ley 1751 de 2015 estatutaria del derecho a la salud establece que el derecho fundamental a la salud comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud e indica adicionalmente que el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

Que en la precitada ley, el literal j) del artículo 5, en lo referente a las obligaciones del Estado, determina que este debe intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación de la prestación del servicio; así mismo su artículo 10, enlista los derechos relacionados con la prestación del servicio de salud que tienen las personas, y señala en su literal i) que estos tienen derecho a la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos requeridos.

Que el Decreto 4107 de 2011, el cual determina los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, establece en el numeral 9° del artículo 2° que le corresponde a esta Entidad formular, adoptar y evaluar la política de dispositivos médicos, así como, establecer y desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de los mismos.

Continuación del Resolución *"Por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos"*

Que, de acuerdo con el contexto internacional, los reactivos de diagnóstico *in vitro* se encuentran incluidos dentro de los dispositivos médicos, por lo que en esta política se entenderá que los dispositivos médicos, comprenden también a los reactivos de diagnóstico *in vitro*, esto en concordancia con el Decreto 3770 de 2004 que reglamenta el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano y el Decreto 4725 de 2005 norma que contiene las disposiciones que autorizan la comercialización de los dispositivos médicos en Colombia.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y el Anexo 1 del Decreto 1081 de 2015, el presente proyecto de resolución fue publicado para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, en la página web del Ministerio, durante el periodo comprendido entre el día 28 de agosto de 2023 y el día 15 de septiembre de 2023.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario expedir la Política Nacional de Dispositivos Médicos la cual surge como resultado de un exhaustivo diagnóstico realizado en el sector salud por parte de este Ministerio y la cual contiene el conjunto de acciones que permitirán mejorar el acceso equitativo a los dispositivos médicos en Colombia, optimizar su utilización y contribuir al fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por medio de la integración de todos los factores que inciden en la disponibilidad, calidad, desempeño, continuidad, uso seguro y adecuado de estas tecnologías en salud.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. La presente resolución tiene como objeto adoptar la Política de Dispositivos Médicos contenida en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°. La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social realizarán un seguimiento anual a la ejecución de las acciones propuestas para el cumplimiento del objetivo de la presente política, presentando informes de avance anuales en el periodo comprendido entre 2024 y 2026 y un informe de cierre final en el año 2027.

ARTÍCULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 08 FEB 2024

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Ministro de Salud y Protección Social

Aprobó
Directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios
Jefe de la Oficina de Planeación y Asuntos Sectoriales
Rodolfo Salas F - Director Jurídico

RS

Director Jurídico

ANEXO TÉCNICO

POLITICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 5
PRINCIPIOS 5
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 6
MARCO CONCEPTUAL 7
Generalidades de los DM en Colombia 7
Disponibilidad y asequibilidad 9
Rectoría y gobernanza 9
Eficacia y Efectividad 9
Sostenibilidad 10
Sistemas de información 10
Ciclo de vida 10
Investigación y desarrollo e Innovación 11
Evaluación de tecnologías en salud (ETES) 11
Regulación de precios 11
Calidad y seguridad 12
Vigilancia Postmercado 12
Gestión de Tecnologías 13
DIAGNÓSTICO 13
Contexto nacional de los DM. 13
Problema identificado 15
Causas 16
1. Carencia de un sistema de información de DM que integre las herramientas existentes e identifique las que se requieran para responder a las necesidades de toma de decisiones en el sector. 16
2. Insuficientes lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la práctica clínica en materia de DM. 17
3. Debilidades en la rectoría y gobernanza sobre los DM con escazas capacidades técnicas en los actores. 19
4. Escasas estrategias para fortalecer la disponibilidad y la asequibilidad de DM priorizados, que respondan al perfil epidemiológico de la población colombiana. 19
5. Débiles lineamientos postmercado, regulación y reglamentación técnica que hagan énfasis en la promoción de la calidad y seguridad de los DM. 22
6. Escasos lineamientos para la gestión, así como para el uso adecuado de DM. 25

OBJETIVOS 26
Objetivo general 26
Objetivos específicos 26
PLAN DE ACCIÓN 27
SEGUIMIENTO 30
FINANCIAMIENTO 30
BIBLIOGRAFÍA 30

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ASIS. *Análisis de la Situación de Salud*

CEPAL. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*

CNPMDM. *Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos*

COPNIA. *Consejo Profesional Nacional de Ingeniería*

DANE. *Departamento Administrativo Nacional de Estadística*

DM. *Dispositivo médico*

DMTS. *Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud*

EPP. *Elementos de protección personal*

ETES. *Evaluación de tecnologías en salud*

GTS. *Gestión de tecnologías en salud*

IETS. *Instituto Nacional de Tecnologías en Salud*

IMDRF. *Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos*

INVIMA. *Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos*

IVC. *Inspección, vigilancia y control*

MSPS. *Ministerio de Salud y Protección Social*

OMS. *Organización Mundial de la Salud*

OPS. *Organización Panamerica de la Salud*

PC. *Permisos de Comercialización*

RDIV. *Reactivos de diagnóstico in vitro*

RS. *Registros Sanitarios*

SGSSS. *Sistema General de Seguridad Social en Salud*

SICA. *Sistema de la Integración Centroamericana*

SISDIS. *Sistema de Información de Precios de Dispositivos Médicos*

SISPRO. *Sistema Integrado de Información para la Protección Social*

TIC. *Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*

INTRODUCCIÓN

Los dispositivos médicos (DM) son un componente de la esencia de la prestación de servicios de salud en tanto que su acceso hace parte de la materialización del derecho a la salud. Esta definición, a nivel internacional, también comprende a los reactivos de diagnóstico *in vitro* (RDIV), razón por la cual cuando se mencione DM se entenderá incluidos los RDIV.

Los DM representan la respuesta tecnológica de alta utilización en los sistemas de salud implicándole un alto costo, dado a que estos participan en las fases de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación de la atención en salud.

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, para 2017 se estimaba que había alrededor de 2 millones de tipos diferentes de DM en el mercado mundial, clasificados en más de 22.000 grupos de DM genéricos (OMS, 2017), lo que evidencia la presencia de DM en el mercado y su importancia en la atención en salud. En ese mismo año, la OMS insta a los Estados Miembros a que formulen *"estrategias y planes nacionales adecuados para la evaluación y gestión de los dispositivos médicos"* (OMS, 2012).

Por su parte, Colombia desde el año 2011, dispuso mediante la Ley 1438 la formulación de la Política de Dispositivos Médicos, por lo que, siguiendo los posteriores lineamientos de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha venido trabajando en esta etapa de formulación, concretamente presentando un exhaustivo diagnóstico en el año 2019 y una propuesta de Política de Dispositivos Médicos en el año 2022.

De esta forma, este documento presenta la Política de Dispositivos Médicos para Colombia en el horizonte temporal 2024-2026, con las acciones sectoriales que permitan al MSPS y sus entidades adscritas establecer las estrategias para fortalecer a corto plazo el sector de DM.

El problema central identificado en esta política se enmarca en las dificultades en el acceso equitativo de la población colombiana a los DM y desintegración de los factores que inciden en la disponibilidad, calidad, continuidad, uso seguro y adecuado en la salud individual y colectiva para contribuir con los resultados en salud que se dan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Las causas de este problema se han clasificado en seis grandes categorías: (i) carencia de un sistema de información que integre las herramientas existentes e identifique las que se requieran para responder a las necesidades de toma de decisiones en el sector, (ii) insuficientes lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la práctica clínica en materia de DM, (iii) debilidades en la rectoría y gobernanza sobre los DM con escazas capacidades técnicas en los actores, (iv) escasas estrategias para fortalecer la disponibilidad y la asequibilidad de DM priorizados, que respondan al perfil epidemiológico de la población colombiana, (v) débiles lineamientos postmercado, regulación y reglamentación técnica que hagan énfasis en la promoción de la calidad y seguridad de los DM y (vi) escasos lineamientos para la gestión, así como para el uso adecuado de DM.

De esta forma se definen las estrategias a desarrollar en el siguiente trienio, en términos de gobernanza, acceso equitativo y asequible y sostenible, sistemas de información y los avances sugeridos para investigación y desarrollo, así como el fortalecimiento de la industria local, todo esto, orientado al logro de acceso a los DM, que permita la satisfacción de las necesidades de la salud pública de la población colombiana.

PRINCIPIOS

La política de dispositivos médicos contempla los siguientes principios:

Accesibilidad. Los DM deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información.

Asequibilidad. Medida en que los usuarios a quienes está destinado un DM pueden pagarlo.

Equidad. Los DM deben estar disponibles para toda la población independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población.

Integralidad. La atención en salud de la población debe incluir los DM necesarios para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad.

Calidad. Los DM deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello

requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos.

Eficiencia. Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los mejores resultados en salud y calidad de vida de la población.

Disponibilidad. Es la presencia de un DM en el mercado colombiano.

Oportunidad. Los DM deben proveerse sin dilaciones.

Sostenibilidad. Los DM que se enmarcan en las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La administración de los fondos del sistema no podrá afectar su flujo de recursos.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Política de Dispositivos Médicos ha sido referenciada desde el artículo 86 de la Ley 1438 de 2011 y reiterada en la Ley 1751 de 2015 Ley estatutaria del derecho a la salud. En ese periodo de tiempo entró a funcionar la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud (DMTS) para fortalecer la estructura técnica, tanto de talento humano como financiero, que permitieron adelantar estudios que sirvieron de insumos para su construcción.

En este panorama, aunado con el fortalecimiento gradual y la apropiación del presupuesto de los últimos años, se logró contar con un diagnóstico del sector de los DM, elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías en Salud (IETS) en 2019, lo que permitió en el año 2022 socializar y validar con los actores, los avances de la construcción del presente documento.

Por otra parte, el crecimiento exponencial que han tenido los DM en el mundo confirma la rapidez de los avances tecnológicos y el aumento en su uso, generando la necesidad de afianzar el concepto de calidad en los servicios de salud, de revisar el contexto de uso de los DM y la posibilidad de que ocurra un incremento en los costos de la atención en salud.

Otros factores reconocidos a nivel global como problemáticos relacionados a los DM, incluye la débil gestión, carencia de mecanismos de selección y priorización, bajos recursos para la adquisición, falta de información y capacitación del talento humano y una evidente discordancia entre la regulación, las medidas de control y el mercado (OMS, 2012).

Como respuesta a dichas problemáticas, la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2007, adoptó la Resolución WHA60.29, en la cual se plasmó la necesidad de establecer prioridades en la selección que cubran la carga de enfermedad, ampliar los conocimientos sobre tecnologías sanitarias, especialmente DM, garantía de la disponibilidad y a precios asequibles con el objetivo de "*asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y tecnologías sanitarias*" (OMS, 2007).

De igual forma también instó a los Estados Miembros a que en sus agendas incluyan la formulación de "estrategias y planes nacionales para la implantación de sistemas de evaluación, planificación, adquisición y gestión de tecnologías sanitarias, en particular dispositivos médicos, en colaboración con personal dedicado a la evaluación de las tecnologías sanitarias y la ingeniería biomédica" (OMS, 2017, p. 2), y a que "elaboren directrices nacionales o regionales sobre prácticas adecuadas de fabricación y reglamentación, instituyan sistemas de vigilancia y otras medidas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos y, cuando corresponda, participen en la armonización internacional" (OMS, 2017, p. 2). Colombia como país miembro de la OMS, viene adoptando lineamientos desde hace más de una década sobre DM, de igual modo, ha desarrollado normatividad local bajo la legislación general como la Ley 9 de 1979 que en su título 11, establece la vigilancia y el control de productos que incidan en la salud pública. Igualmente, para el año 1986 el Decreto 2092, en los artículos 92 y 93, determinó que las suturas y algunos materiales de curación requerían registro sanitario.

En el año 1993, se promulgó la Ley 100 que consagró la equidad y la obligatoriedad como fundamentos del servicio público de la seguridad social en salud. En esta ley se incluyeron algunos lineamientos relacionados con DM tales como: la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA en el artículo 245 y un paquete de servicios de salud que dispuso estas tecnologías de salud a toda la población afiliada.

Posteriormente la Ley 1122 de 2007, que modifica la Ley 100 de 1993, en el literal d) del artículo 34, introdujo mecanismos y establecimientos para la distribución y venta de DM; por su lado la Ley 1438 de 2011, incluyó el control de precios de los DM, en la hoy Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), estableció además la codificación de DM ratificada

en el artículo 117 del Decreto Ley 019 de 2012 y ordenó la definición de la política farmacéutica, de insumos y DM a nivel nacional, la cual tendría como objetivos garantizar acceso, la calidad y el uso racional de estas tecnologías en salud a nivel nacional.

De igual forma, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que representa uno de los avances legislativos de mayor relevancia en el país, en términos de reconocimiento de derechos para la población, al considerar la salud como derecho fundamental, desarrolla en el capítulo IV lineamientos enfocados a la regulación sanitaria de medicamentos, DM e insumos para la salud, innovación, ciencia y tecnologías en salud. Así mismo, destacan la renovación de la política farmacéutica nacional, programática e integral y en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos, basadas en criterios de necesidad, calidad, costo efectividad, suficiencia y oportunidad.

Ahora bien, el MSPS inicia la regulación sanitaria específica para DM, cuando en 2004 expide el Decreto 3770, que establece las disposiciones del régimen de registro y vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico *in vitro* (RDIV), al año siguiente expide el Decreto 4725 de 2005 considerado norma marco, dado su alcance al universo de los DM, cuyo objeto igualmente es el registro sanitario y la vigilancia sanitaria, con el propósito de garantizar la efectividad, seguridad y calidad de los productos, para la protección de la salud pública de la población.

Cabe mencionar asi mismo, la existencia de reglamentación mediante resoluciones de los referidos decretos y de los DM sobre medida, adicional a las modificaciones que se han tenido en los últimos años.

A partir de 2013, los reglamentos relacionados a DM y otras tecnologías en salud, se diseñan bajo los lineamientos del modelo de inspección, vigilancia y control sanitario establecido en la Resolución 1229, que define la obligatoriedad de implementar mecanismos que reduzcan las "*amenazas y riesgos asociados a la producción e intercambio de bienes y servicios de uso y consumo humano*".

Con relación a control de precios de DM, la CNPMDM ha expedido las siguientes circulares: 01 de 2015, 02 de 2015, 02 de 2016, 02 de 2017, 05 de 2018, 13 de 2021 y 14 de 2022. Como resultado, actualmente se tienen dos mercados relevantes de DM endovasculares coronarios y anticonceptivos, en régimen de libertad vigilada (únicamente reporta el precio de comercialización); un DM, estent coronario medicado en control directo de precios (establece un precio máximo de venta). Para el reporte al Sistema Integrado de Información para la Protección Social (SISPRO) el MSPS cuenta con el Sistema de Información de Precios de Dispositivos Médicos (SISDIS).

Por otro lado, es importante mencionar el hito que marca la historia del mundo actual, al enfrentar la pandemia por COVID-19 en el año 2020, en donde Colombia tuvo que adoptar medidas para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos. Para dar respuesta a la grave situación de salud generada por la pandemia, se definieron acciones que abrevien las condiciones de fabricación, adquisición, compra y gestión de tecnologías sanitarias, específicamente para DM, en su mayoría consumibles, elementos de protección personal (EPP), equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico *in vitro*.

En este tema, según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en la crisis provocada por el COVID-19 se identifica la fragilidad de la gestión y el papel de la gobernanza, la planificación y el gobierno digital que se vio reflejado en todos los componentes de la atención, y en especial en el abastecimiento de las tecnologías sanitarias (CEPAL, 2021).

En este contexto, en cuanto a DM es fundamental establecer una política integral, que contribuya al fortalecimiento del SGSSS, propender por la seguridad, calidad y desempeño de los DM, los cuales son tecnologías en salud cruciales para la prestación de la atención en salud y así poder responder a las necesidades, en términos de prevención y a lo largo del ciclo de atención: investigación, diagnóstico, tratamiento y manejo, seguimiento y rehabilitación.

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se tratarán los principales conceptos en torno a los DM en Colombia que son la base para el desarrollo de la Política de Dispositivos Médicos y que permitirán consolidar los términos y establecer el lenguaje común.

Generalidades de los DM en Colombia

Según la normatividad vigente en Colombia, las tecnologías sanitarias incluyen las actividades, procedimientos e intervenciones, medicamentos, dispositivos, productos, servicios y procedimientos

usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta la atención en salud (Resolución 2366 de 2023).

Dentro de las tecnologías en salud se encuentran los DM y los RDIV, aunque en Colombia su reglamentación especifica es diferente, internacionalmente los RDIV son considerados DM, en atención a la definición establecida en el año 2018 por el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF por las siglas en inglés de International Medical Device Regulators Forum) y que agrupa los usos de los DM y RDIV. Para este documento, cuando se hable de DM se incluyen también los RDIV.

Los DM por su lado, constituyen un universo de productos que incluye desde un aplicador de algodón o una gasa, cuya manufactura no es compleja, hasta un ventilador mecánico o un tomógrafo. El Decreto 4725 de 2005, define DM como cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo que se usen en diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, como soporte de una estructura anatómica o de un proceso fisiológico; también lo son todos aquellos que se usan en el control de la concepción, en el diagnóstico y cuidado del embarazo, en la atención del parto y recién nacidos y los usados como productos de desinfección o esterilización de los mismos DM.

Así mismo, el Decreto 3770 de 2004 define el RDIV como "un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano (...)" (Decreto 3770 de 2004).

Con estas definiciones se puede concluir que la diversidad es una característica inherente en el mundo de los DM. Ahora bien, los DM por su definición son usados en todas las etapas de la atención en salud y su uso seguro es relevante, ya que impacta directamente la vida o la salud de las personas.

Para su abordaje, la DMTS del MSPS ha realizado una clasificación en tipologías y subtipologías así:

1. Tipología consumible. Compuesta por cuatro subtipologías:

1.1 Subtipología consumibles o insumos. Conocidos como de único uso, fungibles, descartables o desechables (Minsalud, 2019).

1.2 Subtipología implantables. Dispositivos utilizados en diferentes especialidades quirúrgicas que son implantados de forma temporal o definitiva en un paciente (Minsalud, 2019). Incluyen aquellos que son sobremedida implantables.

1.3 Subtipología reactivo *In vitro* y de diagnóstico *in vitro*. Sustancia o compuesto químico o biológico, que solo o en asociación es diseñado para análisis o pruebas de muestras de origen humano con el fin de proporcionar información relativa a la situación en estudio (Decreto 3770 de 2004).

1.4 Subtipología reutilizables. Instrumento destinado a fines quirúrgicos para cortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes (Decreto 4725 de 2005).

2. Tipología equipos biomédicos.

Tecnologías operacionales y funcionales que reúnen sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervienen en su funcionamiento. (Minsalud, 2019).

3. Tipología dispositivos sobre medida.

Tecnologías personales elaboradas, fabricados, siguiendo una prescripción médica para un usuario particular, para suplir deficiencias visuales/oculares, auditivas, bucales y funcionales del sistema musculo esquelético (Minsalud, 2019).

Dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica: Suplen deficiencias del funcionamiento de miembros superiores, inferiores y otras estructuras músculo esqueléticas. (Minsalud, 2019).

Dispositivos médicos sobre medida de salud visual y ocular: Suplen deficiencias, ayudas ópticas y no ópticas para baja visión, tratamiento de problemas ortópticos, y pleópticos, estereogramas que requieran correspondencia dióptrica y filtros de lentes (Minsalud, 2019).

Dispositivos médicos sobre medida de ayuda auditiva: Suplen deficiencias auditivas (Minsalud, 2019).

Dispositivos médicos sobre medida bucales: Suplen las deficiencias dentales e integran la aparatología de ortodoncia, las prótesis dentales y las órtesis intrabucales (Minsalud, 2019).

4. Tipología DM como software.

Software destinado a ser utilizado para uno o más fines médicos que realizan estos propósitos sin ser parte de un dispositivo médico de hardware (FDA, 2023).

5. Tipología *borderline*.

Son aquellos dispositivos que por sus características intrínsecas no está claro desde el principio si está comprendido como dispositivo médico, medicamento, cosmético, o un producto de consumo general, por lo que se consideran productos frontera (*borderline*). (*Borderline and Classification Working Group - Medical Device Coordination Group*, 2022).

Disponibilidad y asequibilidad

Para que el SGSSS pueda brindar una atención efectiva e integral a la población colombiana se requiere de condiciones de disponibilidad de las tecnologías en el mercado local a precios asequibles que permitan el acceso seguro.

La OMS propone que los países establezcan acciones para mejorar el acceso en todo el mundo a unos DM idóneos, y que se propenda porque estos sean efectivos como medida terapéutica, que sean los necesarios para atender a la población y que cuenten con la calidad bajo estándares internacionales (OMS, 2012).

La accesibilidad o el acceso se refiere a "la capacidad de las personas de obtener tecnologías sanitarias de buena calidad cuando se necesitan y de utilizarlas adecuadamente" (OMS, 2012). La disponibilidad por su lado, "es la presencia de un DM en el mercado" (OMS, 2012). Finalmente, la asequibilidad está definida como la medida en que los usuarios a quienes está destinado un servicio de salud o producto sanitario pueden pagarlo (OMS, 2012).

En este sentido, la OMS promueve la utilización de DM prioritarios, adecuados al contexto o entorno al que está destinado; es decir, es preciso asociar el DM a la necesidad de salud, a fin de maximizar su efectividad y disminuir el gasto en DM inútiles, utilizando estudios y encuestas como el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) y datos nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que permiten determinar los DM requeridos para manejar la carga de enfermedades existente en el país.

Los elementos de acceso, disponibilidad y asequibilidad son constitutivos de una adecuada gestión del ciclo de vida de los DM y contribuyen a una atención integral de la población.

Rectoría y gobernanza

Otros aspectos claves para la Política de DM es el abordaje a la rectoría y la gobernanza necesarias para establecer el rol regulatorio y el establecimiento de las reglas que deben regir en el desempeño de los actores y de los agentes del SGSSS para favorecer la atención integral, segura y con calidad, esto en concordancia, con la legislación vigente colombiana, los estándares internacionales y los lineamientos de la OMS.

Para ilustrar lo mencionado se puede considerar lo afirmado por Muthuri y Gatwiri que el alcance de la gobernanza en materia de salud va más allá del rol de rectoría, dado que incluye a parte de los acuerdos, los procesos, relaciones entre actores, reglas, mecanismos de control y rendición de cuentas (Kirigia J, 2011). Adicionalmente, la gobernanza también es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia, fundamentales y coyunturales, y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido y su capacidad de dirección (Aguilar, 2006).

Por su parte, la rectoría según la OPS es una función indelegable e ineludible del Estado, ejercida a través de la autoridad de salud nacional, en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social (OPS y USAID, 2007). Esta rectoría debe contemplar dimensiones como: (i) conducción sectorial, (ii) regulación, (iii) financiamiento, (iv) aseguramiento, (v) armonización, (vi) ejecución de las funciones esenciales de salud pública. (Molina-Marín, 2012).

En este contexto, Colombia viene desarrollando la gobernanza y regulación incluidos en la reglamentación específica y a través de esta política que se convierte en el eje articulador.

Eficacia y Efectividad

Otro de los elementos a considerar en la Política de DM hace referencia a la eficacia y efectividad, la eficacia entendida como el logro del resultado esperado dentro de un entorno controlado, dado que según la definición (Monter, 2008) "*es el grado en que una determinada intervención origina un resultado beneficioso en ciertas condiciones, medido en el contexto de un ensayo clínico controlado*"; mientras la efectividad está relacionada al uso de los DM en términos del desempeño, así se encuentra definido por el IETS (IETS, 2014), como, "*el beneficio (p. ej. en resultados en salud) que supone utilizar una tecnología para un determinado problema en condiciones generales o habituales*" y definida por el IMDRF como la "*capacidad de un dispositivo médico para proporcionar resultados*

clínicamente significativos de acuerdo con su uso previsto, conforme lo declara el fabricante" (traducido del inglés) (IMDRF,2019).

La eficacia y efectividad también están ligadas a los métodos, procedimientos, técnicas definidas en estándares internacionales para la fabricación y control de calidad, con el fin de generar DM aptos en el desempeño según su diseño, para que responda a la necesidad del paciente de manera segura.

Sostenibilidad

Para que el SGSSS pueda funcionar y cumplir con la misión de brindar salud integral y universal, bienestar a la población colombiana, así como para proporcionar los resultados en salud esperados, necesita del apalancamiento con recursos financieros permanentes y disponibles que le permita ser sostenible en el tiempo (Ley 1438 de 2011).

Al respecto, la OMS afirma "un sistema de salud sostenible como aquel que asegura el acceso equitativo a medicamentos esenciales, vacunas y tecnologías, mientras que recauda fondos adecuados para la salud, con el fin de garantizar que las personas puedan utilizar los servicios necesarios y estén protegidas de catástrofes financieras o empobrecimiento asociados al hecho de tener que pagar por ellos" (FIFARMA, 2019).

Este precepto promulgado por la OMS es adoptado por la legislación colombiana con mayor énfasis sobre la equidad para población vulnerable, sin diferencias injustas en todo el territorio nacional y de acuerdo con las necesidades propias de cada territorio (OPS, 2023).

En este sentido, la sostenibilidad del SGSSS es entendida como la capacidad de contar con los recursos económicos, humanos, ambientales y sociales suficientes que, usados de manera eficiente, garanticen el acceso equitativo y seguro a los servicios y tecnologías en salud de toda la población colombiana, mejorando el bienestar de la sociedad y minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente.

Sistemas de información

Para la toma de decisiones informadas dentro del SGSSS se requiere contar con datos de calidad y confiables, mediante desarrollo de sistemas de información integrados, interoperables, seguros y públicos.

Para Vega-Perez un sistema de información es un conjunto formal de procesos que, operado sobre una colección de datos estructurados de acuerdo con las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente.

Así mismo, se ha entendido al sistema de información como el conjunto de personas, datos, información, herramientas de procesamiento y almacenamiento de información dentro de una organización a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Vega-Perez et al., 2017). Definiciones menos recientes, como la de Laudon & Laudon presentan el sistema de información como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización (Laudon, 2004).

Adicionalmente, es importante aclarar que en el presente documento "información", corresponde a aquellos datos que se han procesado significativamente y son útiles y comprensibles para las personas (Laudon, 2004) mientras que los "datos" son la representación en bruto de un evento y son el material de partida para producir información (Laudon, 2004). Bajo este entendido, es preciso afirmar que los datos por sí solos no son útiles, estos deben ser "traducidos" en productos de información y conocimiento para mejorar la toma de decisiones.

Específicamente, en lo referente a los DM, que en conjunto con los medicamentos son los productos más transados en el sector salud, la recolección de datos que se relacionan con el precio, la evaluación de tecnología, el suministro, la calidad, el uso y la disposición final de estas tecnologías en salud contribuyen a generar información y conocimiento suficiente para usar racionalmente los recursos destinados a ellos. De aquí, la relevancia que tiene la disponibilidad de sistemas de información ajustados a la realidad dentro de los sistemas sanitarios.

Lo anterior aportará en el cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, sobre la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud *"orientada a la investigación y generación de nuevo conocimiento en salud, la adquisición y producción de las tecnologías, equipos y herramientas necesarias para prestar un servicio de salud de alta calidad que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población"*.

Ciclo de vida

Según estándares internacionales toda tecnología o producto o dispositivo tiene un ciclo de vida, al respecto la OMS propone una amplia definición del ciclo de vida que abarca fases que van desde la

concepción y desarrollo de una idea, la fabricación, empaquetado y etiquetado del producto final, la publicidad para su comercialización, su utilización y su eliminación en el servicio clínico (Cheng, 2003).

Se entiende entonces que el ciclo de vida para los DM, en el marco de este documento, abarca todas las fases que van desde el diseño, la investigación, innovación y desarrollo pasando por el uso clínico, el mantenimiento, cuando aplica, y la disposición final del mismo.

Investigación y desarrollo e Innovación

La investigación y el desarrollo experimental se definen como el trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible (OCDE, 2015).

La innovación, se define como el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que permiten: introducir nuevos o mejorados productos en el mercado nacional o extranjero, introducir nuevos o mejorados servicios e implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos (Escobar, 2000). La innovación puede tener tres partes: i) la generación, desarrollo y adaptación de una invención, ii) la realización o materialización y iii) la implementación de dicha invención (OCDE, 2018).

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como se encuentran definidas anteriormente, no solo aumentan el volumen del conocimiento si no que amplían la gama de opciones diagnósticas y terapéuticas con nuevos o mejorados DM que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas cuando se logra la implementación de éstos en el país, adicionalmente, se convierte en una herramienta de competitividad nacional en materia de esta tecnología en salud.

En desarrollo de los lineamientos internacionales, específicamente sobre la fase de investigación y desarrollo de la OMS (OMS, 2012), y de la política de soberanía en la producción para la seguridad sanitaria (Resolución 1411 de 2022), el país actualmente cuenta con la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y Producción de Tecnologías Estratégicas en Salud (Decreto 1099 de 2022) con lo cual el país busca estimular la cooperación para la producción local de tecnologías estratégicas.

De otro lado, cabe mencionar que la Política de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) aporta de igual manera a las iniciativas I+D a través de grupos de investigación y universidades, con énfasis sobre el balance de los factores ambientales, sociales y económicos asociados a la producción de tecnologías en salud.

Evaluación de tecnologías en salud (ETES)

La OMS a través de la Resolución WHA CSP28.R9 insta a los países miembros a que (i) "promuevan la creación de procesos decisorios para la incorporación de tecnologías sanitarias basadas en la ETES, lo que puede incluir la seguridad, la eficacia, el costo y otros criterios pertinentes"; y a que (ii) "promuevan el uso de la ETES a fin de fundamentar las políticas de salud pública, incluidas las decisiones sobe la cobertura de los sistemas públicos de salud y la elaboración de guías y protocolos clínicos para las nuevas tecnologías" (OPS, 2012).

La ETES es el proceso sistemático de valorización de las propiedades, los efectos y los impactos de la tecnología sanitaria; debe contemplar las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas y tiene como principal objetivo aportar información para que sea aplicada a la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Estas evaluaciones se enfocan en aspectos cómo nivel de beneficios y eficacia, seguridad clínica y técnica, y relación costo-efectividad (OPS y OMS, 2021).

Regulación de precios

Ahora bien, dentro de los mecanismos de intervención del mercado, las políticas de precios farmacéuticos se definen como un "conjunto de principios o requisitos escritos para administrar los precios de productos farmacéuticos, acordados o adoptados por una institución pública (por ejemplo, un gobierno), un grupo de organizaciones compradoras o servicios de salud individuales" (OMS, 2020), concepto aplicable también para DM.

Los objetivos generales de las políticas de precios deben centrarse explícitamente en lograr un acceso asequible y equitativo a productos de calidad para consumidores y sistemas de salud, que deben garantizar una relación calidad-precio basada en mejores resultados de salud a nivel poblacional, además de mantener la seguridad del suministro de productos de alta calidad (OMS, 2020), concepto aplicable también para DM.

La OMS incluye como políticas de intervenciones de precios para las tecnologías en salud: 1) Precio de referencia externo; 2) Precios de referencia internos; 3) Precios basados en el valor; 4) Regulación de márgenes en toda la cadena de suministro y distribución farmacéutica; 5) Promoción de la

transparencia de precios; 6) Licitación y negociación; 7) Promoción del uso de medicamentos genéricos y biosimilares de calidad garantizada; 8) Adquisiciones mancomunadas; 9) Fijación de precios de costo-plus para fijar el precio de los productos farmacéuticos; 10) Exenciones o reducciones de impuestos para productos farmacéuticos. (OMS, 2020), muchas de estas de aplicación para DM.

Calidad y seguridad

Ya se han mencionado conceptos claves relacionados con la gobernanza, la información, la investigación, el acceso, los precios, pero todo esto debe ir ligado con la calidad, sin embargo, frente a este concepto diferentes autores, entre ellos Voury y De Geyndt, aluden lo complejo de la definición de calidad y reconocen que, al existir ambigüedades sobre este concepto, ésta es percibida y definida de formas diferentes (Voury y De Geyndt, 2008).

Vanormelingen por ejemplo, expresa que la calidad es la satisfacción de las necesidades de los usuarios, con soluciones técnicamente óptimas, mientras que Zeithmal define la calidad de un servicio como la discrepancia entre las expectativas y las percepciones de los usuarios (Suplemento, 2008).

La calidad, desde otro punto de vista, puede significar o estar relacionada con la durabilidad de un producto, el precio correcto, servicio oportuno, disponibilidad del servicio, buena aceptación, cumplimiento de estándares altos, satisfacción de las necesidades (Suplemento, 2008).

Este concepto ha evolucionado y se define en la ISO 8402 como la totalidad de características de una entidad que influyen en su capacidad para satisfacer necesidades expresadas e implícitas (ISO, 1995). También se ha ampliado el concepto a la calidad total, siendo esta filosofía la que le permitió a Japón lograr sus niveles actuales de competitividad (Fernandez, 1998).

En el sector salud, algunas definiciones como la de Gilmore y Novaes consideran la calidad como concepto clave para este sector y la definen incluyendo cinco aspectos: (i) un alto nivel de excelencia profesional, (ii) uso eficiente de los recursos, (iii) un mínimo de riesgo para el paciente, (iv) un alto grado de satisfacción por parte del paciente y (v) impacto final en la salud (Gilmore. C., 1996), (Burmester, 1997).

Se entiende entonces por calidad en los DM a las características que satisfacen las necesidades de los usuarios exhibiendo especificaciones que dan cumplimiento a estándares, que prestan mayores beneficios y mitiga los riesgos para la población.

Otro concepto que presenta múltiples interpretaciones y disparidad es "seguridad", en común se asocia a algo seguro el cual está libre y exento de riesgo u ofrece confianza (RAE, 2021). El término asociado a las tecnologías en salud se encuentra en la literatura definiciones como el "*juicio sobre la aceptabilidad del riesgo (medida de la probabilidad de un resultado adverso y su gravedad) asociado al uso de una tecnología en una situación concreta*" (IETS, 2014).

Por lo tanto, la seguridad de los DM en este contexto puede definirse como lo hace el Decreto 4725 de 2005 estableciéndola como la característica de un DM que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. (Decreto 4725 de 2005).

Vigilancia Postmercado

El sistema de vigilancia postmercado de los DM actualmente es gestionado operativamente por el INVIMA y a nivel departamental y distrital por las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud. El mencionado sistema se aterriza a través de los programas de Tecnovigilancia (Resolución 4816 de 2008) y Reactivovigilancia (Resolución 2013038979 de 2013 modificada en 2020 por la Resolución número 2020007532 expedidas ambas por el INVIMA) que tienen como objetivo identificar, recolectar, evaluar, gestionar y divulgar tanto los riesgos como los efectos y eventos serios o indeseados desconocidos que son producidos por el uso de los DM+RDIV (Minsalud, 2021).

Los agentes del sistema de vigilancia postmercadeo en sus dos programas, se encuentran clasificados por niveles así:

El Nivel Nacional integrado por el MSPS y el INVIMA.

El Nivel Departamental y Distrital, integrado por las diferentes Secretarías Departamentales y Distritales de Salud; en Reactivovigilancia se incluyen además las municipales.

El Nivel Local, integrado por los fabricantes e importadores de DM, RDIV y prestadores de servicios de salud e incluye también los usuarios de DM o cualquier persona que tenga conocimiento de un evento o incidente adverso. En Reactivovigilancia se incluyen además los bancos de sangre, bancos de componentes anatómicos, laboratorios de salud pública, los de referencia, los especializados y de docencia.

Gestión de Tecnologías

La gestión de tecnologías en salud (GTS) es definida por Vilcahuamán y Rivas como "un abordaje sistemático y cuantificable para asegurar que la relación costo/efectividad, eficiencia, seguridad y tecnología disponible sea lo apropiado para cubrir con calidad la demanda por el cuidado de los pacientes" (Rivas, 2006). La GTS se enfoca en los DM y la OMS menciona que aborda aspectos que van desde la evaluación de las necesidades hasta su uso seguro. (OMS, 2012).

Según la OMS, la GTS comprende la planificación, la evaluación de las necesidades, la selección, la adquisición, donaciones, inventario, instalación y mantenimiento de equipos médicos, formación para un uso seguro y disposición final (OMS, 2017). Se menciona también que cada uno de estos ítems abarca una amplia una gama de actividades, que incluyen "proporcionar asesoramiento técnico, planificación y cálculo de costos, seguimiento de contratos, cadena de suministro, disposición final, gestión del personal, gestión de inventario, control de stock de repuestos, consumibles, manejo de residuos e implementación de protocolos de seguridad" (Kaur M et al., 2005).

DIAGNÓSTICO

Contexto nacional de los DM.

En Colombia, la regulación de los DM se encuentra a cargo del MSPS a través de la DMTS, que tiene la competencia de "formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica, de medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología biomédica, y establecer y desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de los mismos" (Decreto 4107 de 2011). Esta regulación del sector de Dispositivos Médicos en los últimos años ha mostrado avances importantes frente a la política de precios y en la definición del estándar semántico, entre otros.

De acuerdo con la información de la base general de establecimientos que reposa en el INVIMA con corte a 31 de diciembre de 2022, en cuanto a establecimientos de DM, así como de RDIV se evidencia que el 80% corresponden a fabricantes internacionales y el 20% a fabricantes nacionales.

El crecimiento de establecimientos en el periodo 2014 a 2022 para los fabricantes de DM nacionales fue del 220% y para los importadores del 172% con un promedio de crecimiento general de 523 establecimientos. Los establecimientos de RDIV por su lado, tuvieron un incremento del 127% para los importadores y un 140% para los nacionales en el mismo periodo de tiempo, con un promedio de crecimiento general de 28 establecimientos.

Ahora bien, la balanza comercial del sector de los DM en Colombia entre enero de 2007 a diciembre de 2021 es negativa, puesto que, el valor de las importaciones supera el de las exportaciones. En cuanto a las cifras reportadas en el año 2021 de productos importados fue por valor de 1.629.897 millones de dólares, mientras que para los productos exportados representaron únicamente 107.515 millones de dólares.

Gráfico 1. Balanza Comercial (Ene 2007 – Dic 2021) sector de los Dispositivos Médicos en Colombia

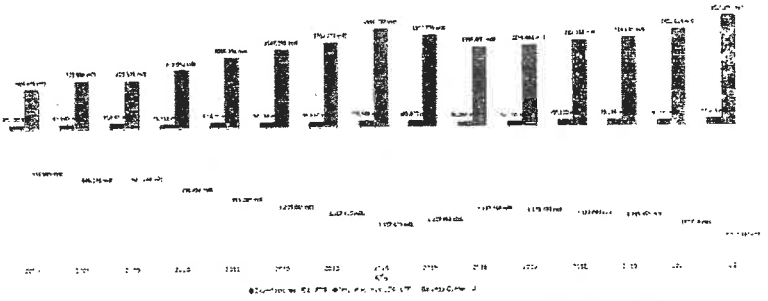

Fuente. CVN – Centro Virtual de Negocios. Tomado de Libro Comercio. Cámara dispositivos Médicos - ANDI

La comercialización de DM y RDIV en Colombia, se realiza bajo registros sanitarios (RS) o permisos de comercialización (PC) otorgados por el INVIMA los cuales, según el riesgo, pueden ser automáticos o con control previo y pueden amparar varios productos siempre y cuando, estos tengan características similares.

Según la base de datos del INVIMA, al 31 de diciembre de 2021, había unos 16.172 registros sanitarios (RS) asociados a DM y equipos biomédicos (EB). De estos, 460 RS estaban vencidos, 86

Continuación del Resolución *"Por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos"*

RS suspendidos, 1.031 RS cancelados y 15.172 RS vigentes. El 91,09% de los RS vigentes correspondía a DM importados y el 8,91% a DM de fabricación nacional. Esto indica que el mercado de DM en Colombia es predominantemente importado.

Gráfico 2. Comparación porcentual del estado de los registros sanitarios de DM y RDIV

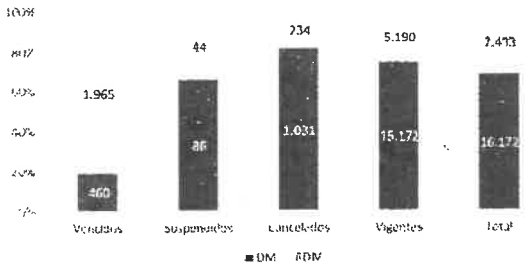

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Invima.

De igual forma, había unos 7.433 RS asociados a reactivos de diagnóstico in vitro (RDIV). De estos, 1.965 RS estaban vencidos, 44 RS suspendidos, 234 RS cancelados y 5190 RS vigentes. El 96,33% de los RS vigentes correspondia a RDIV importados y el 3,67% a RDIV de fabricación nacional. Esto muestra que el mercado de RDIV en Colombia también es mayoritariamente importado.

Gráfico 3. Comparación de RS nacionales e importados de DM y RDIV

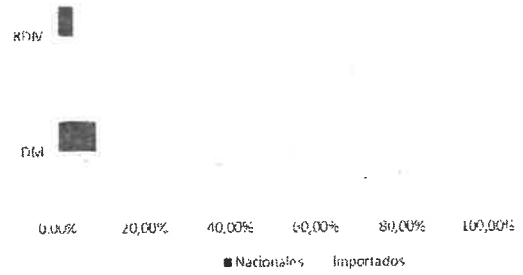

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Invima.

En cuanto al riesgo de los DM y EB con RS vigente, se observa que para los DM el 24,66% de los RS tienen clasificación I y el 43,38% de los RS tienen clasificación IIA. Esto indica que en su mayoría hay RS de riesgo IIA de DM y EB.

En cuanto a la categoría de los RDIV con RS vigente, se observa que para los RDIV el 5,47% de los RS tienen categoría I, y el 48,36%. de los RS tienen categoría II 2510. Esto indica que en su mayoría hay RS de categoría II de RDIV.

Gráfico 4. Clasificación de riesgo de los RS de DM y RDIV

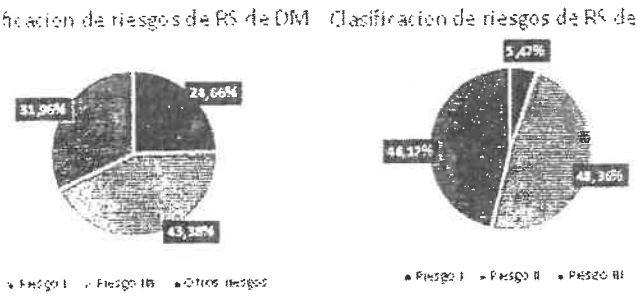

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Invima.

Al realizar una revisión solamente a la fabricación nacional de DM, se tiene que, de los 1.352 RS vigentes, el 7,79% son de riesgo I y IIA, respectivamente.

Referente a la fabricación nacional de RDIV, se tiene que, de los 115 RS vigentes, el 82,6% son de categoría I y II.

Debido a la falta de estandarización de la base, es difícil identificar las clases de DM que se fabrican en el país, sin embargo, al realizar una clasificación uno a uno de los 1352 RS de fabricación nacional asociando por tipologías, se puede identificar que el 98,6% son DM de tipología consumible y el 1,04% corresponde a la tipología de los equipos biomédicos de tecnología controlada.

En cuanto a la frecuencia de expedición de los RS, se evidencia una línea de tendencia al aumento desde el año 2.005; en los últimos 5 años el promedio anual es de 169,25 RS nuevos expedidos de DM y 8 RS nuevos expedidos de RDIV de fabricación nacional.

De la información correspondiente a los RS expedidos por el INVIMA anteriormente expuesta, se concluye que en Colombia se fabrican DM de bajo y moderado riesgo (I y IIA) y de RDIV de bajo y mediano riesgo (I y II), en su mayoría de tipología consumibles y que en promedio se expiden 169,25 nuevos RS de DM y 8 RS nuevos de RDIV anuales de fabricación nacional.

Ahora bien, otro factor para tener en cuenta corresponde al ciclo de vida de los DM que comprende las fases desde la concepción y desarrollo de una idea, hasta la fabricación, empaquetado y etiquetado del producto final, la publicidad para su comercialización, su utilización y eliminación del servicio clínico.

Como se menciona en el documento de Árbol de problemas en el marco del Análisis de Impacto Normativo (AIN) de Investigación Clínica con Dispositivos Médicos (DM) y Reactivos de Diagnóstico In Vitro (RDIV), desarrollado por el MSPS en conjunto con Invima, la investigación clínica hace parte importante del proceso de desarrollo de nuevos dispositivos médicos puesto que permite la obtención de alternativas terapéuticas para el tratamiento de patologías de alto impacto en salud pública. "El objetivo principal de los estudios clínicos es demostrar la seguridad y eficacia de estas potenciales tecnologías sanitarias, siendo el primer eslabón en la cadena productiva de los Dispositivos Médicos" (Minsalud, 2023b).

La adopción de las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) dentro de la normativa nacional en el año 2005, visibilizó la investigación clínica colombiana a nivel internacional. También promovió el crecimiento en el número de centros de investigación certificados en el país, llegando en la actualidad a existir 141 centros de investigación clínica y 77 comités de ética certificados por el Invima en medicamentos con corte a agosto de 2022 (Minsalud, 2023b).

En Colombia, según el Decreto 4725 de 2005, la fabricación, empaquetado y etiquetado del producto final y su publicidad están a cargo del fabricante o del importador, bajo la inspección, vigilancia y control (IVC) del INVIMA. El uso y la disposición final es realizada por los prestadores de servicios de salud, definidos en la Resolución 3100 de 2019.

Por otro lado, con relación al talento humano se observa que, en el año 2007, la OMS en la Resolución WHA 60.29 insta a los países miembros a que formulen estrategias de *"evaluación, planificación, adquisición y gestión de las tecnologías sanitarias, en particular de los dispositivos médicos, en colaboración con personal dedicado a la evaluación de las tecnologías sanitarias y la ingeniería biomédica"*. En este sentido, dado que el desarrollo del ciclo de vida de los DM depende de las acciones acertadas y oportunas de talento humano, se requiere contar con profesionales de las diferentes disciplinas del área de la salud en las fases de evaluación, planificación, regulación, adquisición y gestión de las tecnologías sanitarias, para el uso adecuado y disposición final.

Teniendo en cuenta la diversidad de tecnologías existentes en el mercado, también debe integrarse profesionales de otras disciplinas tales como de las ciencias básicas – física e ingenierías, específicamente provenientes de programa en ingeniería biomédica, bioingenierías y físicos médicos, con el fin de impulsar la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en el país, además, para el apoyo en la gestión durante del ciclo de vida. Estas disciplinas pese a la necesidad en el SGSSS y el mercado de los DM no han tenido una inclusión en sus procesos.

De la búsqueda realizada, se identifica que existen 23 programas de ingeniería biomédica en 18 instituciones de educación superior en diferentes partes del país, los graduados en esta profesión se registran ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), en cumplimiento a la Ley 842 de 2003 (Ley 842 de 2003). Al consultar esta entidad se evidencia que desde el año 2000 se han registrado más de 3.800 profesionales para ejercer la ingeniería biomédica, con un crecimiento exponencial a lo largo de los años.

Problema identificado

El problema de la situación de los DM se concreta en:

"Dificultades en el acceso equitativo de la población colombiana a los DM y desintegración de los factores que inciden en la disponibilidad, calidad, continuidad, uso seguro y adecuado en la salud

individual y colectiva para contribuir con los resultados en salud que se dan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Causas

1. Carencia de un sistema de información de DM que integre las herramientas existentes e identifique las que se requieran para responder a las necesidades de toma de decisiones en el sector.

La política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022) anteriormente denominada Gobierno en Línea, tuvo como logro el salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Esta estrategia fue adoptada por el MSPS dando como resultado el Sistema Integral de Información de la Protección Social en Colombia - SISPRO, que permite a todos los actores del SGSSS, al Gobierno Nacional y a la ciudadanía en general acceder a la información epidemiológica y estadística, y a herramientas de análisis, para facilitar y focalizar la gestión y la toma de decisiones en salud.

En este sentido, y en el marco del SISPRO, el MSPS viene desarrollando sistemas de información para cada tecnología, que busca satisfacer las necesidades específicas del SGSSS y facilitar el monitoreo, seguimiento, evaluación y el mejoramiento de la vigilancia y el control, optimizando la toma de decisiones y el logro de resultados en salud.

Por otra parte, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), mediante diagnóstico realizado en 2019, encontró que el sector de DM no cuenta con un sistema de información oficial público que reúna las características de información *"periódica, confiable, oportuna, eficiente, disponible, comparable, histórica y completa"* que permita la toma de decisiones informadas al conjunto de actores y agentes del SGSSS. (IETS, 2019)

Inicialmente, el denominado estándar semántico y codificación de DM reglamentado por la Resolución 1405 de 2022 y reiterado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, tiene como finalidad la identificación, denominación y clasificación de estas tecnologías facilitando su uso, trazabilidad y el intercambio de información entre actores y agentes involucrados en la comercialización, distribución, inspección vigilancia y control durante el ciclo de vida y en los diferentes eslabones de la cadena.

También el estándar semántico y codificación de DM permitirá el uso de datos confiables para estudios epidemiológicos, promoción de DM costo-efectivos y prioritarios, investigación, innovación y desarrollo.

Los objetivos son:(i) garantizar la trazabilidad de los DM a lo largo de toda la cadena de comercialización, incluida la investigación, promoción, uso y disposición final, (ii) facilitar el manejo, suministro, adquisición y uso en los procesos de prestación de servicios de salud, actividades de promoción y prevención y el inventario y mantenimiento de los equipos biomédicos, (iii) mejorar la gestión relacionada con el gasto del SGSSS, (iv) facilitar los procesos de regulación y vigilancia de precios y consumo, (v) facilitar el intercambio de información entre las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y control sanitario y (vi) facilitar la identificación y clasificación según estándares internacionales.

En este punto, se requiere avanzar en la implementación de la Resolución 1405 de 2022, que estableció un horizonte de tiempo de cuatro años, para que el SGSSS cuente con el estándar semántico operando y establezca mecanismos para la ciberseguridad de la información.

1.1. Difusos requerimientos para el diseño del sistema de información de DM.

Según el IETS, en su diagnóstico de 2019, las perspectivas de las necesidades y requerimientos del sistema de información para DM son diversas según los actores.

Desde la perspectiva de las sociedades científicas participantes, mencionan que "el sistema de información debe garantizar la disponibilidad de información, que incluya información sobre calidad, estrategias de uso y costo-beneficio" (IETS, 2019). Por parte de las entidades territoriales, se menciona que el sistema de información podría estar incluido en SISPRO para facilitar el acceso en diferentes niveles, que apoye las funciones de inspección, vigilancia y control de estos actores, conociendo tanto "la base instalada de tecnologías de alto riesgo por número de habitantes en el país" (IETS, 2019) como las características técnicas, de calidad de las mismas, de manera que el sistema permita realizar "consulta de registros sanitarios y permiso de comercialización tan solo con la información de lote y/o serie de un dispositivo, páginas web para consulta de proveedores e importadores autorizados" (IETS, 2019).

Los prestadores de servicios de salud, desde su perspectiva consideran que el sistema de información debe ser de "fácil uso, acceso abierto, codificado bajo estándares internacionales y que a su vez

permitan hacer analítica" (IETS, 2019) ya que para estos actores es significativo realizar sinergia con otras instituciones en salud. Precisan también que sea importante "que contenga datos actualizados y estandarice la información nacional de la documentación de los dispositivos médicos disponibles" (IETS, 2019).

Por su parte las agremiaciones industriales, perciben que "el sistema de información debe considerar las características de cada sub-segmento del mercado de los DM para mejorar su entorno" (IETS, 2019).

De esta forma es importante caracterizar las fuentes existentes y consolidar los requerimientos del sistema de información para DM.

1.2. Débil análisis de la información recolectada actualmente sobre dispositivos médicos para aportar en la toma de decisiones de los actores.

Según el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, en el diagnóstico realizado en el año 2019, se puede identificar la poca comunicación en temas de DM, hay *"falta de información y difusión hacia los actores involucrados"* (IETS, 2019), incluyendo en esta parte, la importancia de *"comunicar resultados de las evaluaciones de desempeño, así como proporcionar esta información a toda la cadena de actores involucrados"* (IETS, 2019).

De otro lado, se cuenta actualmente con información almacenada y gestionada en diferentes fuentes tales como:

- En el SISPRO del MSPS se encuentra alojado el SISDIS en cual permite reportar precios por parte de fabricantes (incluye importadores), intermediarios y prestadores de servicios de salud.
- El INVIMA cuenta con bases de datos independientes para registros sanitarios, condiciones técnico-sanitarias de fabricantes nacionales, certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de importadores y las de los programas postmercado de tecnovigilancia y reactivovigilancia. Estas bases también están en www.datos.gov.co (datos abiertos).

Externamente al sector de los DM se encuentran fuentes de información que pueden aportar datos de DM tales como la DIAN, la Supersalud, las entidades territoriales de salud y prestadores de servicios de salud.

Sin embargo, son pocos los análisis que se realizan sobre la información que se recolecta y escasa la difusión que se realiza de estos, la cual puede aportar a la toma de decisiones de los actores en los diferentes puntos del ciclo de vida de los DM.

2. Insuficientes lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la práctica clínica en materia de DM.

2.1. Escasos espacios de discusión sobre la investigación y desarrollo (I+D) con los actores involucrados de DM.

Dentro del diagnóstico realizado por el IETS, uno de los principales problemas identificados es "la ausencia de redes de gestión para compartir el conocimiento, donde los proyectos e innovaciones se visibilicen y puedan generar un interés en un promotor patrocinador" (IETS, 2019) ya que, si bien existen desde la academia algunas redes , es escaso aún el enlace con patrocinadores y alianzas público privadas que fortalezcan la I+D+i con relaciones basadas en la confianza del triángulo Estado-academia-industria.

Dentro de los actores que identifica el IETS en su documento para la articulación y ampliación del mencionado triangulo están la academia, los prestadores de servicios de salud, los entes reguladores, el sector industrial y el gobierno.

Por lo que se requiere la creación de espacios de discusión sobre la investigación y desarrollo (I+D) con los actores involucrados de DM.

2.2. Deficientes lineamientos sobre investigación y desarrollo (I+D) así como de práctica clínica en DM.

La investigación en Colombia si bien se encuentra regulada y cuenta con organismos que la impulsan, ha tenido mayores avances en sectores diferentes a la salud, no obstante, el sector farmacéutico con presencia de industria nacional viene produciendo medicamentos de síntesis química y anti-veneno, y se proyecta a futuro en la producción de radiofármacos, en consonancia impulsa y desarrolla investigación clínica (Molina, Botero, & Giraldo, 2016).

Algunas universidades y grupos de investigación en coordinación con Minciencias, adelantan proyectos de investigación de DM de carácter incremental, como es el caso de lo sucedido en el marco de la pandemia por el COVID-19, donde se presentaron iniciativas de fabricación, por ejemplo de ventiladores, en donde algunas universidades trabajando en conjunto con hospitales presentaron prototipos nacionales, los cuales por la falta de lineamientos claros sobre los requisitos que deben cumplir en el momento de someter los protocolos de investigación al Invima para el desarrollo de investigación clínica con DM, no llegaron a finalizar el proceso. Los estudios clínicos sobre DM pueden ser utilizados por quienes hagan investigación o desarrollo de DM en innovación incremental o *de novo*.

En el sector de los DM colombiano además, se tienen identificados algunos problemas como: "*ausencia de recursos financieros para hacer investigación y desarrollo local de tecnologías y dispositivos médicos*" (IETS, 2019), la falta de gestión de los recursos existentes (IETS, 2019) y un factor importante que la investigación no responde a necesidades del perfil epidemiológico (IETS, 2019), lo que retrasa aún más el desarrollo y producción de tecnologías nacionales, razón que conduce a la idea de buscar la adecuación de un ecosistema que permita el desarrollo de investigaciones clínicas con DM de alta calidad en coordinación con actores y agentes del SGSSS.

Colombia en cuanto a tecnologías sanitarias, contaba a 2016 con un registro de 927 estudios clínicos, aunque el dominio del mercado mundial de estudios clínicos seguirá liderado por los países de altos ingresos (Molina, Botero, & Giraldo, 2016).

En los últimos años, se ha encontrado un aumento en el interés de desarrollar ensayos clínicos en el país (Minsalud 2023b). Este interés se ha visto incrementado de manera proporcional con el número de sometimientos de protocolos con esta tecnología sanitaria ante el INVIMA, por lo que se cuenta con información incipiente, por esta razón se hace vital la adecuación de un ecosistema que permita el desarrollo de investigaciones clínicas con DM de alta calidad (Minsalud 2023b).

Como se muestra en el gráfico siguiente, la solicitud de estudios clónicos que se allegan a la sala especializada de DM y RDIV del INVIMA ha incrementado en un 56,5% desde el año 2022 hasta el mes de septiembre de 2023.

Gráfico 5. Total. trámites vs estudios clínicos, conceptuados por la sala especializada de DM y RDIV en el periodo 2018 - 2023 (septiembre).

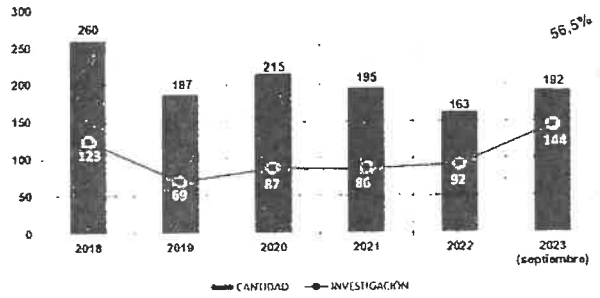

Fuente: Datos suministrados por Invima

En el caso de Colombia, la regulación vigente para el desarrollo de investigación en salud con seres humanos está definida por la Resolución 8430 de 1993 *"Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud*, que dicta los lineamientos generales para realizar investigación con seres humanos incluyendo nuevos recursos profilácticos, de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, señalando algunos requisitos éticos, técnicos y legales transversales (Minsalud 2023b).

Así mismo, la Resolución 2378 de 2008, define los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Clínicas a las instituciones en salud que estén interesadas en desarrollar investigación clínica con medicamentos (Minsalud 2023b).

No obstante, a pesar de que estas normas han permitido definir un marco general para el desarrollo de investigaciones con seres humanos, han ido quedando desactualizadas, debido principalmente a los avances de la investigación, el desarrollo de nuevos diseños de ensayos clínicos, y la introducción de las tecnologías de la información (Minsalud 2023b).

Se evidencia la necesidad de contar con una agenda regulatoria sobre investigación y desarrollo (I+D) y práctica clínica en DM, basados en normas nacionales y armonizadas con las normas internacionales existentes, para asegurar la solidez científica y ética de la investigación.

3. Debilidades en la rectoría y gobernanza sobre los DM con escazas capacidades técnicas en los actores.

Dentro del diagnóstico realizado por el IETS, los encuestados mencionaron que "deben estar articulados todos los actores intersectorialmente y que se tenga mayor presencia del Ministerio de Salud y Protección Social" (IETS, 2019).

Según el IETS, con el panorama actual de la gobernanza en el nuevo orden global, se hace evidente que quien regula no posee el monopolio del conocimiento, de la experiencia y de los recursos necesarios para resolver los problemas, por lo tanto, debe ingeniar y reinventar nuevas formas para generar entre todos, las políticas públicas, en compañía de otros actores estratégicos, como la ciudadanía (IETS, 2019).

De otro lado, se observa baja capacidad en las entidades territoriales relacionada con su estructura tanto técnica como de talento humano, que limita el desarrollar una efectiva IVC. Téngase en cuenta por ejemplo, el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005, en donde establece que estas entidades en coordinación con Invima ejercerán las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones. En este sentido se requiere estrategias que fortalezcan el rol de las entidades territoriales de salud para la fiscalización sanitaria de los DM.

Finalmente, el IETS en el resumen ejecutivo aborda un aspecto que va en línea directa con la gobernanza, como es la rectoría en salud, con la afirmación "*La regulación de los DM se encuentra a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Dirección de medicamentos y tecnologías en salud, quienes tienen responsabilidad de "formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica, de medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología biomédica, y establecer y desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de los mismos".*

Teniendo en cuenta que la gobernanza en el SGSSS es transversal y permea las estrategias contenidas en las políticas de salud, su abordaje determina la concreción de los elementos de legitimidad, estabilidad y sostenibilidad, los cuales son necesarios para que los objetivos de estas políticas sean realizables, así como, definir los roles de los agentes responsables de su implementación y ejecución, y establecer los mecanismos para promover el mejoramiento continuo a través de una eficaz gestión de los DM.

La rectoría y gobernanza regulatoria tendrán en cuenta las obligaciones y compromisos internacionales suscritos y que tienen fuerza vinculante para Colombia.

4. Escasas estrategias para fortalecer la disponibilidad y la asequibilidad de DM priorizados, que respondan al perfil epidemiológico de la población colombiana.

4.1. Escaso desarrollo del componente de disponibilidad de los dispositivos médicos.

El IETS en su documento menciona que el abastecimiento puede verse impactado algunas veces por *"los procesos engorrosos de importación"* (IETS, 2019). Así mismo, al relacionar disponibilidad con el uso, se menciona que *"la utilización de los DM está ligada a la disponibilidad en el mercado, que es reducida o controlada para todos los niveles de atención en salud y en los diferentes territorios".*

En cuanto a las dificultades de abastecimiento de DM se encuentra que el país vivió este fenómeno en tiempo de pandemia y algunos rezagos posteriores debido a la baja disponibilidad de DM y la escaza fabricación nacional. Esto fue posiblemente causado porque los países fabricantes reservaron su producción para consumo propio (Union Medical, s.f.), al igual, que el apoyo y fomento de empresas locales era deficiente y no existía suficiencia de materias primas a nivel mundial. Según lo informado por la ANDI, este fenómeno responde a variables internacionales como la relocalización de las plantas de producción, lo cual no es un tema exclusivo para nuestro país.

Si bien el país ha presentado riesgo de escases no ha llegado al desabastecimiento de DM que significaría fallas en el acceso para la atención, sumado a lo anterior cabe reconocer que hacen falta herramientas de identificación de estas tecnologías prioritarias que den respuesta al perfil epidemiológico del país, así como el fomento de producción nacional para el auto abastecimiento.

Cabe destacar finalmente, que el SGSSS requiere que todas las tecnologías sanitarias, en especial los DM cuenten con evaluación para el uso seguro, que sea de calidad, requerido pór el SGSSS, disponible en el mercado local y a precios asequibles.

De esta forma se requiere una herramienta de monitoreo del estado del abastecimiento de DM que permita aumentar y gestionar la disponibilidad de estos, además de planteamiento de estrategias con los actores para evitar el riesgo de escasez de DM en Colombia.

Continuación del Resolución *"Por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos"*

4.2. Incipientes avances en la evaluación de tecnologías (ETES) en dispositivos médicos.

Colombia cuenta con el IETS, que desde 2012 ha desarrollado más de 1.000 productos relacionados con la revisión de la evidencia, la economía, la analítica, la actuaría, los métodos cualitativos y la investigación social en salud, entre los cuales se encuentran evaluaciones de DM, muchos de estos hoy contemplados en el Plan de Beneficios, contribuyendo así al acceso a la población de tecnologías seguras y con evidencia científica.

En la encuesta realizada por el IETS, los participantes señalaron que no existe suficiente divulgación sobre los resultados de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias -ETES de DM, ni apropiación de las metodologías existentes (IETS, 2019). En este punto, enfatizaron que no se conocen los lineamientos o pautas para estas ETES, no existen guías para hacerlas a nivel micro ni procesos de capacitación para una adecuada interpretación de resultados de las ETES de DM (IETS, 2019). Es pertinente indicar que el IETS tiene un manual metodológico para la elaboración de evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud (IETS, 2014), que probablemente no ha tenido una buena difusión para el sector de DM.

En la encuesta realizada también se encontró que se asocia el concepto de ETES con vigilancia y tecnovigilancia, evidenciando una confusión en la población general en la terminología, además explica la *"necesidad de articular los procesos, es decir, garantizar que la información obtenida desde la tecnovigilancia sirva para el desarrollo de evaluaciones sobre DM"* (IETS, 2019).

De igual forma, los participantes en la encuesta expresan que los "procesos de evaluación deben servir para tomar decisiones informadas y adoptar recomendaciones basadas en evidencia" (IETS, 2019). En este punto, se señaló como un problema reiterativo "la inexistencia o debilidad de los comités institucionales para evaluación de tecnologías; los que existen, además, solo se enfocan en criterios de costos, dejando de lado la necesidad de garantizar la integralidad y la calidad en la atención en salud" (IETS, 2019).

Por otra parte, los participantes mencionaron que, "la evaluación se concentra en los aspectos farmacéuticos primordialmente, y no consideran la necesidad de tener evaluaciones de nuevas tecnologías, o evaluaciones de nuevas aplicaciones de las tecnologías existentes" (IETS, 2019), consideran entonces que, en el marco de las ETES se deja a un lado los DM.

Es importante resaltar de la encuesta realizada por IETS, que el 29% de las Aseguradoras y el 23% de los prestadores encuestados no cuentan con comité de evaluación de DM, y una pequeña proporción el 14% de Aseguradores y el 6% de prestadores manifestaron no reunirse, como se puede ver en el gráfico 6. Dado esto es importante implementar estrategias que impulsen e incentiven a las organizaciones a la realización de comités de ETES teniendo en cuenta su importancia para la toma de decisiones en salud (IETS, 2019).

De manera similar a lo manifestado durante la encuesta, en el espacio participativo realizado por el IETS en el marco de la realización del diagnóstico hecho en 2019, se llamó la atención a que tampoco *"existe análisis multi-criterio que incorpore usos inadecuados, afectación de los pacientes y no solo recursos"* (IETS, 2019) y que, por ejemplo, el escaneo de horizonte se realiza solo en casos aislados para invertir. Así mismo en las ETES realizadas *"tampoco se incorporan los aspectos de seguridad del paciente"* (IETS, 2019), el proceso se realiza de manera empírica y es incipiente, y también se denota poco interés por aprender (IETS, 2019).

Gráfico 6. Periodicidad de reunión del comité de ETES

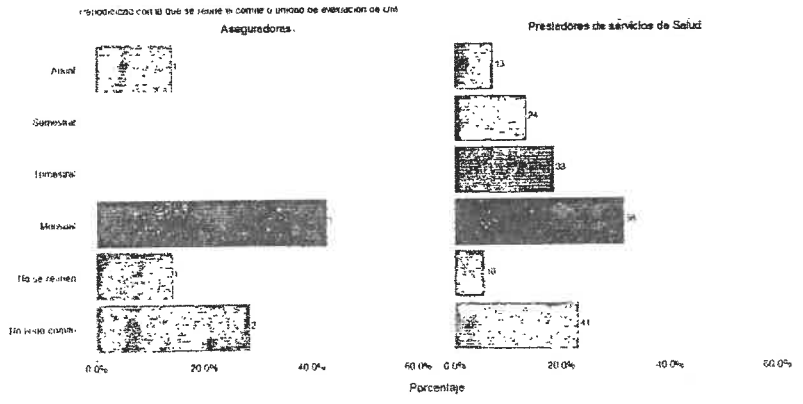

Fuente: Diagnostico del sector de DM (IETS, 2019)

4.3. Escaso desarrollo de la política de precios para DM.

Respecto a la asequibilidad, el IETS menciona que se debe buscar transformar el cuidado a partir de la medicina basada en la evidencia y la economía de la salud, buscando apoyar las compras de DM por resultados, más no por precio y que en el país no hay criterios de costo efectividad sino de ahorro de costos (IETS, 2019). También destacan que hay altos costos de la tecnología y algunos actores consideran importante regular el costo, tal como están regulados los medicamentos (IETS, 2019). Así mismo refieren que aún hay escaso fomento para que el país cuente con tecnología a buenos precios que facilite la atención a los pacientes con alta tecnología (IETS, 2019).

En cuanto al reporte de precios, en el gráfico 7 se observa la percepción de los participantes en la encuesta con respuestas muy heterogéneas, de donde llama la atención que el 46% de los encuestados consideran necesario incluir todos los DM en el control de precios; el 29% consideran que se pueden priorizar, el 21% no conocen sobre este tema y el 4% mencionan que no se debe reportar precios de DM.

Teniendo en cuenta que los actores mencionaron un elevado costo de algunos de los DM (sobre todo, en las regiones más apartadas del país), se identifica la necesidad de incluir en el componente de regulación de precios de los DM variables como la accesibilidad por cuestiones geográficas en el contexto del mercado colombiano de DM a efecto de que sea una herramienta para incentivar la libre competencia y disminuya las asimetrías de información al momento de realizar los procesos de adquisición (IETS, 2019).

El diagnóstico del IETS refiere que la regulación de precios debe ser un proceso consensuado, *pues se tiende a dejar de producir y comercializar* cuando es impuesto; en otras palabras, *debe existir la regulación de precios, pero de manera estructurada conociendo lo que se tiene y con un adecuado estándar semántico* e indican que los precios deben estar establecidos por referenciación de precios internacionales en países con sistemas maduros en salud (IETS, 2019).

Gráfico 7. Percepción sobre reporte de precios

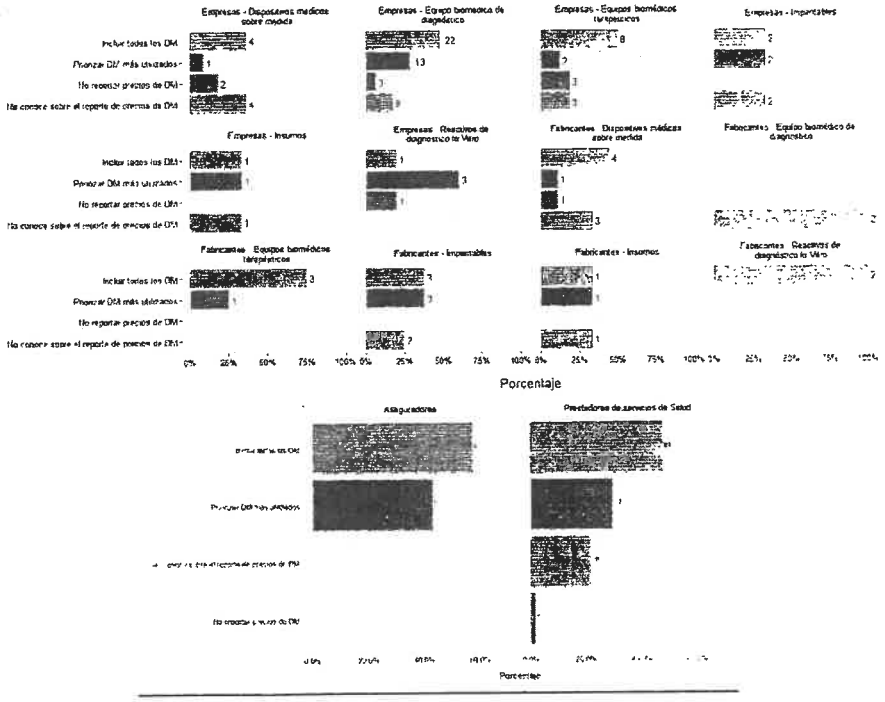

Fuente: Diagnostico del sector de DM (IETS, 2019).

Finalmente, como resultado de la política de precios para DM, actualmente se tienen seis mercados relevantes en régimen de libertad vigilada (únicamente reporta el precio de comercialización): DM endovasculares coronarios, anticonceptivos, implantables auditivos de conducción ósea, implante para córnea, implante coclear, DM implantables para terapia cardiaca de alto voltaje (desfibriladores y cardio-resincronizadores) y tan solo un DM, estent coronario medicado, en control directo de precios (establece un precio máximo de venta).

4.4. Escasa producción local de DM.

En el marco de la implementación de la política de soberanía en la producción para la seguridad sanitaria, el país conformó la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y Producción de Tecnologías Estratégicas en Salud (Decreto 1099 de 2022) con la que se busca estimular la cooperación entre actores para la producción local de tecnologías estratégicas.

Como ejemplo de esto se encuentra la participación público-privada en la estrategia para la producción local de vacunas y la cooperación con organismos internacionales para establecer la viabilidad de producción local de radiofármacos con el Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA.

El panorama de DM muestra que este sector en el país, fabrica DM de algunas tipologías de los riesgos alto y medio, y con mayor proporción de bajo riesgo, con lo cual no auto abastece las necesidades de atención en salud, llevando a que aproximadamente el 97% de los DM sean importados. Más aún, en concordancia a este panorama la investigación clínica no ha tenido desarrollo.

Otro factor que determina la baja producción nacional según la industria de RDIV, son los altos costos de las materias primas y de los "Gold estándar", es un estándar o patrón de oro para validación de sus pruebas, asociado a los escasos laboratorios certificados en el país (Minsalud, 2021).

Como se indicó en el contexto nacional, solo el 38% del volumen total de fabricantes de DM presentes en el mercado colombiano, son nacionales y se centra en los DM de menor riesgo sin desconocer que hay fabricación de DM en los otros niveles de riesgo (IIa, IIb y III) (Minsalud, 2019) como se muestra en la tabla 2. En RDIV el 43% son nacionales y producen generalmente riesgo I y II (Minsalud, 2021).

Tabla 1. DM de producción nacional

Riesgo I	Riesgo IIA	Riesgo IIB	Riesgo III
Venda de algodón o elástica	Set de infusión de liquidos	Sistemas de implantes osteosíntesis	Suturas absorbibles y sintéticas
Esparadrapo	Desinfectantes	Suturas de diferentes materiales no absorbible	Matriz extracelular
Campos médicos	Sondas de alimentación incluyendo la radiopaca	Implante dental	Membrana de colágeno para regeneración tisular

Fuente: Elaboración propia Grupo Dispositivos Médicos 2018

Por otra parte, desde el año 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra trabajando en la Política de Reindustrialización para transitar de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible (Mincit, 2023. Los objetivos de esta política se concentrarán en cerrar brechas de productividad, fortalecer los encadenamientos productivos y la inversión, diversificar y sofisticar la oferta interna y exportable, y profundizar la integración con América Latina y el Caribe (Mincit, 2023).

Dentro de esta política se encuentra la apuesta estratégica sobre la reindustrialización en el sector salud, donde se menciona que Colombia *"generará capacidad de producción local de excipientes activos, medicamentos, vacunas, dispositivos y partes para dispositivos médicos"* (Mincit, 2023), por lo que las acciones intersectoriales que se presenten en este marco serán definitivas para el sector y para la producción local de DM basados en altos estándares teniendo en cuenta las obligaciones y compromisos internacionales suscritos y que tienen fuerza vinculante para el país.

5. Débiles lineamientos postmercado, regulación y reglamentación técnica que hagan énfasis en la promoción de la calidad y seguridad de los DM.

La calidad y seguridad como se menciona en el marco teórico, son características de los DM que impactan de manera positiva la atención de los pacientes, por lo tanto, a continuación, se mencionarán

los temas del sistema de vigilancia postmercado, así como de regulación y reglamentación técnica de los DM.

5.1. Debilidades en la capacidad técnica de los agentes del sistema de vigilancia postmercado de los Dispositivos Médicos.

A pesar de los esfuerzos del INVIMA en el fortalecimiento de los programas de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, aún se evidencian debilidades en la capacidad técnica de los actores del sistema de vigilancia postmercado de los DM, tales como la continua rotación de los referentes territoriales de salud que no permite el trabajo continuo y el desarrollo de experticia en el manejo de los reportes lo cual conlleva a la improvisación, bajo registros y la deficiente retroalimentación.

Según el IETS, se debe facilitar la retroalimentación a los interesados en los programas de vigilancia postmercado, así como, evitar el temor a los reportes de eventos adversos, informando a los usuarios que los programas cuentan con política de confidencialidad (IETS, 2019).

Frente a los eventos e incidentes adversos asociados a los DM, el **Programa Nacional de Tecnovigilancia** del INVIMA, informa que en el periodo comprendido entre 2015 y 2019, se notificaron 53.391 reportes, de los cuales 18.168 corresponden a problemas de fabricación que provocaron 4.609 eventos adversos y 13.559 incidentes.

Por su parte, al **Programa de Reactivovigilancia** se notificaron en el mismo periodo 1.552 reportes, de los cuales 159 están asociados a la fabricación, que produjeron 141 incidentes adversos, 6 eventos adversos y 12 sin clasificar.

La evolución de Programa Nacional de Tecnovigilancia no se ha limitado a vigilar los eventos reportados mediante la estrategia de reporte espontáneo (**Vigilancia Pasiva**), exige fomentar el desarrollo de un Sistema Integral de Tecnovigilancia, que considere la **vigilancia proactiva** (Enfoque de Riesgo) y establecer estrategias para desarrollar la **vigilancia activa/intensiva e investigación específica de los dispositivos médicos**. (Garcia-Vega, 2015).

De igual forma a nivel internacional, el IMDRF cuenta con el documento "IMDRF terminologies for categorized Adverse Event Reporting (AER): terms, terminology structure and codes" desde el año 2020.

Adicionalmente, el MSPS con el fin de fortalecer la Inspección, Vigilancia y Control -IVC, de los productos de uso y consumo humano expidió la Resolución 1229 de 2013, por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano, que conmina a que para las tecnologías en salud se diseñe un modelo de IVC sanitario que permita operativizar las acciones en el territorio nacional, con el concurso de las entidades de orden nacional y territorial encargadas.

5.2. Debilidad en la regulación y la reglamentación técnica de los DM entorno a la calidad y seguridad de estos.

La regulación es el conjunto de instrumentos normativos por medio de los cuales los gobiernos establecen requisitos a los ciudadanos y las empresas, y sobre los cuales se espera un cumplimiento por parte de los actores regulados (Presidencia de la República, 2019). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la regulación *"abarca una variedad de instrumentos mediante los cuales los gobiernos establecen requerimientos para empresas y personas"* (OCDE, 2012).

En el año 2014, la OCDE hizo un estudio sobre la política normativa en Colombia e identificó que la producción normativa en el país es excesiva, genera costos adicionales y barreras para los ciudadanos y al Estado (DNP, 2019).

A partir de dicho diagnóstico, recomendó desarrollar un conjunto común y obligatorio de estándares y requisitos administrativos para diseñar mejores regulaciones por lo que se establece el CONPES 3816 de 2014 sobre "Mejora Normativa: Análisis de Impacto", cuyo objetivo es generar las capacidades institucionales en el uso de las herramientas y buenas prácticas (DNP, 2019). Posteriormente en 2019, la Política de Mejora Normativa se incluyó en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), haciéndola obligatoria en todas las instituciones públicas.

Para esto se utiliza el ciclo de gobernanza regulatoria con el fin de brindar una lectura integral de cada una de las fases, actores, herramientas e instituciones que intervienen en el proceso de diseño de una nueva norma o la modificación de una existente (DNP, 2019) y que se muestra en el gráfico.

Gráfico 8. Ciclo de gobernanza regulatoria

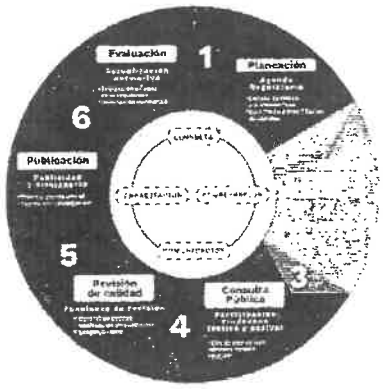

Fuente: (DNP, 2019)

Dentro de este ciclo, se encuentra el punto 2 sobre diseño de la regulación el cual contiene los análisis de impacto normativo, tanto *ex ante* como *ex post*, reglamentados por el Decreto 1595 de 2015 y 1468 de 2020, los cuales solo son obligatorios para los reglamentos técnicos en Colombia.

El reglamento técnico se define como el documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionadas, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

De esta forma, el MSPS se encuentra obligado a establecer análisis de impacto normativo, tanto *ex ante* como *ex post*, para aquellos reglamentos que sean aplicables a los DM como los de buenas prácticas de manufactura (BPM) y etiquetado, entre otros. A la fecha se encuentra publicado el análisis *ex post* de los Decreto 4725 de 2005 y 3770 de 2004(Minsalud, 2023) y la problemática respecto a las BPM de DM.

Del primero se puede destacar que en torno al régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria tanto para los DM como para los reactivos de diagnóstico in vitro, se reconoce que, si bien se mantienen las problemáticas originales que dieron lugar a las intervenciones regulatorias de los Decretos 3770 de 2004 y 4725 de 2005, las condiciones del sector han cambiado a lo largo del tiempo, por lo que estos decretos no son suficientes para responder a la problemática actual, por lo que se recomendó realizar los ajustes a esta regulación, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora identificadas en la evaluación (Minsalud, 2023).

Alineados con este proceso, la actualización del régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria debe también responder al artículo 161 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) que establece que se debe realizar el "fortalecimiento para agilizar las autorizaciones de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos y dispositivos y tecnologías en salud".

Ahora bien, las Buenas Prácticas de Manufactura de DM (BPM), a las que se hace mención en los Decretos 4725 de 2005 y 3770 de 2004 y la cual actualmente se está reglamentando, comprenden los procedimientos y métodos utilizados para asegurar la calidad durante la manufactura, empaque, almacenamiento e instalación de los DM, así como, la estructura organizacional, responsabilidades, procesos y recursos para implementar los requisitos de calidad asociados con estos.

El reconocimiento de normas internacionales como la ISO:13485 sobre sistemas de gestión de calidad para la fabricación de DM (ISO 13485:2018), así como la normalización con respecto a calidad de materias primas o elementos de fabricación de los DM (IETS, 2019) no está definida. A pesar de contar con estándares como la ISO 14971:2019 ("Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD) — Aplicación de la gestión del riesgo a los DM"), la IEC 60601-1 ("Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial"), la ISO 15223-1 ("Productos sanitarios. Símbolos para utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar. Parte 1: Requisitos generales"), la ISO14155 ("Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Buenas prácticas clínicas"), la ISO 14971 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios"), y la UNE-EN 62353:2015 ("Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédicos"), a la fecha no se encuentran armonizados con la reglamentación colombiana.

Actualmente, derivado de los mencionados decretos el INVIMA expide un concepto técnico de condiciones sanitarias, que adolece de los requisitos planteados a nivel internacional, por lo que no es reconocido para el comercio exterior (Minsalud, 2019).

En otros temas regulatorios se encuentra que, en cuanto al mantenimiento, a la fecha no se cuenta con ningún estándar internacional con el que Colombia este alineado a pesar de que en el mundo se encuentran algunos como el AAMI EQ-56 que son las prácticas recomendadas para un programa de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos (AAMI - Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 2013).

Por su parte, respecto a metrología para DM, el Decreto 1595 de 2015 y sus actos reglamentarios, se define que la calibración de los DM considerados instrumentos de medición se realiza de acuerdo con los reglamentos técnicos metrológicos y mientras se expidan estos, se hace de acuerdo con las indicaciones y periodicidad que establezca el fabricante. Menciona también que para este tipo de DM la calibración debe realizarse en un laboratorio acreditado en la norma ISO 17025, que es un estándar internacional con los requisitos generales para las competencias de los laboratorios de prueba y calibración. Para estos DM en específico existe ya una armonización con la norma internacional.

Sin embargo, para los demás equipos biomédicos a la fecha se deberán hacer las actividades de soporte técnico (mantenimiento y calibración) de acuerdo con las indicaciones del fabricante, según el Decreto 4725 de 2005. En cuanto a lineamientos de calibración el IETS menciona que es preciso desarrollar más el cómo se debe hacer la metrología, considerando los estándares internacionales.

Se evidencia entonces que se requiere fortalecer tanto la regulación como la reglamentación técnica para los DM en Colombia.

6. Escasos lineamientos para la gestión, así como para el uso adecuado de DM.

6.1. Difusos lineamientos para la gestión de dispositivos médicos, especialmente de equipos biomédicos.

Como se mencionó en el marco conceptual, la gestión de tecnologías en salud (GTS) comprende la planificación, la evaluación de las necesidades, la selección, la adquisición, donaciones, inventario, instalación y mantenimiento de equipos médicos, formación para un uso seguro y disposición final (OMS, 2017).

En el diagnóstico realizado por el IETS una de las problemáticas identificadas está relacionada con las dificultades y barreras en la adquisición de los DM, Colombia al igual que otros países del mundo carece de un marco regulatorio sobre la gestión de los DM que permita la toma de decisiones ajustadas al perfil epidemiológico, costos, nivel complejidad, y la estructura de los servicios de salud (IETS, 2019).

Actualmente la normatividad nacional de DM contempla que el fabricante, titular e importador cuenta con obligaciones y responsabilidades relacionadas a la producción, procesamiento, envase. empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento (Decreto 4725 de 2005), sin embargo, carece de otros requisitos y responsabilidades específicamente definidas en temas de adquisición, venta y lo específico para posventa y mantenimiento es escaso.

En relación con el talento humano para realizar el mantenimiento, el IETS menciona que éste debe contar con los conocimientos teóricos y prácticos en diferentes tipos de DM que les permita ostentar experiencia suficiente para intervenirlos adecuadamente en búsqueda de la seguridad del paciente y del mismo operador (IETS, 2019).

Por otro lado, en cuanto a donaciones, el IETS menciona la necesidad de contar con una *Política para donaciones* y puntualizó en la importancia de garantizar la donación de tecnología segura y de esta manera evitar riesgos con donaciones a poblaciones lejanas o de bajo acceso a tecnología, acorde a condiciones locales que protejan la salud de los colombianos (IETS, 2019).

Finalmente, el IETS se refiere a la urgencia de contar con reglas de juego claras para el reúso de los DM que cumplan las condiciones para este efecto (IETS, 2019).

Durante los últimos años, el MSPS como ente rector, ha realizado múltiples esfuerzos por reglamentar acciones asociadas a la gestión de DM, teniendo en cuenta el ciclo de vida en la cadena de comercialización de estas tecnologías en el país (IETS, 2019), resumida así:

- En lo relativo a la planificación y la evaluación de las necesidades, no se encuentran requisitos normativos específicos para ambas etapas.

- En relación con la selección y adquisición, la Resolución 3100 de 2019 establece que se debe contar con información documentada de estos procesos para los DM dentro del estándar de "medicamentos, dispositivos médicos e insumos" (Resolución 3100 de 2019).
- En cuanto a donaciones, el Decreto 218 de 2019 regula los requisitos, el procedimiento para el ingreso y salida del territorio aduanero nacional, y las autorizaciones expedidas por el INVIMA relacionadas con donaciones internacionales con fines sociales y humanitarios de DM entre otras tecnologías (Decreto 218 de 2019). Así mismo, en Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se expidió el Decreto 697 de 2021 que a la fecha esta derogado. Sin embargo, aún no se tiene reglamentación respecto a las donaciones nacionales.
- Referente al inventario, no se encontró información más allá de los requisitos de reporte del Sistema de Información Hospitalaria – SIHO donde se solicita información de algunos equipos biomédicos considerados DM según lo establece el Decreto 2193 de 2004 compilado en el Decreto 780 de 2016.

Respecto a la instalación y mantenimiento de equipos biomédicos, la Resolución 3100 de 2019 establece que todos los prestadores de servicios de salud en Colombia deben contar con un programa de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, así como con las hojas de vida donde se tengan los registros de estas actividades. Menciona también que el mantenimiento debe ser ejecutado por talento humano profesional tecnólogo o técnico en áreas relacionadas (Resolución 3100 de 2019). También el Decreto 1769 de 1994 regula la asignación y utilización de los recursos financieros del 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos, y en los privados que tengan más del 30% de sus ingresos totales provenientes de los contratos con la Nación (Decreto 1769 de 1994).

6.2. Escasos lineamientos en el uso adecuado y seguro de DM

Si bien hay algunos lineamientos sobre uso adecuado y seguro, aun se observa inadecuado uso de los DM en la prestación de los servicios de salud, por lo que es importante afianzar los conocimientos técnicos y fortalecer el rol consciente del personal de salud sobre el uso determinado por el fabricante, pero también, el de comunicar información privilegiada sobre riesgos potenciales, prohibiciones y contraindicaciones, que en muchas ocasiones no se evidencian por razones exclusivamente comerciales.

De igual manera, la información y capacitación sobre el uso adecuado debe estar alineada con las recomendaciones del fabricante, dado que algunos problemas de calidad pueden estar relacionados a fallas en las capacidades de los usuarios y la desinformación sobre los DM. Así mismo el IETS manifiesta que algunas veces el usuario final (paciente o cuidador) no sabe usar los DM (IETS, 2019).

Al tratar el tema de formación para un uso seguro, se encuentra que la Resolución 3100 de 2019 menciona que es indispensable contar con un programa de capacitación en el uso de DM cuando éstos lo requieran (Resolución 3100 de 2019).

Dado la diversidad de DM para el hogar y atención en domicilio, la comunidad también debe ser informada y concientizada sobre el uso adecuado, los riesgos potenciales y contraindicaciones, situación que no se ha abordado por parte de los fabricantes, importadores y distribuidores.

OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer el acceso equitativo de la población colombiana a los DM integrando los factores que inciden en su disponibilidad, calidad, continuidad, uso seguro y adecuado en la salud individual y colectiva para contribuir con los resultados en salud que se dan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Objetivos específicos

OE1. Diseñar un sistema de información de DM que integre las herramientas existentes e identifique las que se requieran para responder a las necesidades de toma de decisiones en el sector.

OE2. Establecer los lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la práctica clínica en materia de DM.

OE3. Robustecer la rectoría y gobernanza sobre los DM desarrollando capacidades técnicas en los actores.

OE4. Implementar estrategias para aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de DM priorizados, que respondan al perfil epidemiológico de la población colombiana.

OE5. Fortalecer lineamientos postmercado, la regulación y la reglamentación técnica con énfasis en la promoción de la calidad y seguridad de los DM.

OE6. Desarrollar lineamientos para la gestión, así como para el uso adecuado de DM.

PLAN DE ACCIÓN

1. OE1. Diseñar un sistema de información de DM que integre las herramientas existentes e identifique las que se requieran para responder a las necesidades de toma de decisiones en el sector.

   1.1. Línea de acción: Consolidar los requerimientos para el diseño del sistema de información de dispositivos médicos.

   1.1.1. Entre el año 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con los actores adelantará un inventario de las fuentes de información que existen durante el ciclo de vida de los DM en el país, donde se identifique el estado, los parámetros y el nivel de madurez de sistemas de información existentes.

   1.1.2. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social implementará el estándar semántico y codificación de los DM.

   1.1.3. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social diseñará el sistema de información que, de forma escalonada y cibersegura, integre las herramientas existentes en el sector salud identificadas en el inventario, cree las que se requieran y que permita comparar de forma nacional e internacional la información de DM, alineados con las políticas de Gobierno Digital y el SISPRO.

   1.2. Línea de acción: Analizar la información que se recolecta actualmente sobre DM.

   1.2.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará el soporte técnico y mantenimiento de los softwares asociados a DM que se alojen en esta entidad, según requerimientos y atendiendo los lineamientos de Gobierno Digital y de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC.

   1.2.2. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el INVIMA, realizará análisis de la información sobre DM que se genere con los sistemas de información existentes en la actualidad, con el fin de que esta sea de conocimiento público y que apoye la toma de decisiones.

2. **OE2. Establecer los lineamientos que contribuyan al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la práctica clínica en materia de dispositivos médicos.**

   2.1. Línea de acción: Promover la I+D+i de DM en escenarios y con los actores involucrados en las políticas de I+D+i.

   2.1.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores involucrados en las políticas de I+D+i promoverá espacios de discusión sobre la investigación y desarrollo de DM.

   2.2. Línea de acción: Establecer lineamientos sobre investigación, desarrollo y práctica clínica en DM.

   2.2.1. Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con los actores establecerá lineamientos para la investigación en salud con DM.

   2.2.2. Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el INVIMA y otros actores involucrados, adecuarán los requisitos sanitarios para facilitar la importación de materia primas consideradas DM, así como los equipos para uso en investigación e innovación de DM.

Continuación del Resolución *"Por la cual se adopta la Política de Dispositivos Médicos"*

3. **OE3. Robustecer la rectoría y gobernanza sobre los DM desarrollando capacidades técnicas en los actores.**

3.1. ***Línea de acción: Reforzar el conocimiento sobre gestión, evaluación y vigilancia durante el ciclo de vida de los DM, en las entidades del sector salud de carácter público a nivel nacional y territorial.***

3.1.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social elaborará, realizará y evaluará un programa de capacitación para reforzar el conocimiento sobre gestión, evaluación y vigilancia durante el ciclo de vida de los DM en las entidades públicas del nivel central, así como en las entidades territoriales de salud.

4. **OE4. Implementar estrategias para fortalecer la disponibilidad y la asequibilidad de DM priorizados, que respondan al perfil epidemiológico de la población colombiana.**

4.1. Línea de acción: Mejorar la disponibilidad de los DM en el mercado.

4.1.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá una herramienta de monitoreo del estado de abastecimiento interoperable y de consulta pública para los actores, así como, el régimen de vigilancia al reporte que permita aumentar y gestionar la disponibilidad de DM estratégicos en el mercado del país.

4.1.2. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el INVIMA y con participación de los actores, definirá estrategias con el fin de evitar el riesgo de escasez manteniendo la calidad, seguridad, funcionamiento y desempeño de estos en los rangos que mitiguen los riesgos en salud pública.

4.2. Línea de acción: Divulgar metodologías de evaluación de tecnologías en salud según necesidades del sector.

4.2.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el IETS y los actores, establecerá, capacitará y divulgará los conceptos, metodologías, lineamientos y guías para realizar Evaluaciones de Tecnologías en Salud para DM priorizados en diferentes actores de acuerdo con el perfil epidemiológico colombiano.

4.3. Línea de acción: Contribuir al desarrollo de la política de precios de los DM.

4.3.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, basados en la metodología para la identificación de los DM, los priorizará e incluirá, de manera progresiva, en los regímenes de la política nacional de precios.

4.4. Línea de acción: Impulsar la producción local de DM.

4.4.1. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará las acciones en torno a la implementación de la política de soberanía en la producción para la seguridad sanitaria, específicamente aquellas definidas en la comisión intersectorial para el desarrollo y producción de tecnologías estratégicas en salud (CIDPTES).

4.4.2. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con los involucrados, articulará las acciones definidas en la Política de Reindustrialización relacionadas con las capacidades de producción local de los DM.

5. **OE5. Fortalecer lineamientos postmercado, la regulación y la reglamentación técnica con énfasis en la promoción de la calidad y seguridad de los estos.**

5.1. Línea de acción: Optimizar los lineamientos del sistema de vigilancia postmercado de los DM.

5.1.1 Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el INVIMA, las entidades territoriales de salud y actores definirá lineamientos para promover la vigilancia proactiva, activa e intensiva dentro de los programas de vigilancia postmercado.

5.1.2. Entre el año 2024 y 2026, el INVIMA en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales de salud y actores establecerá lineamientos para mejorar los canales de comunicación, retroalimentación y tiempos de respuesta de los programas de vigilancia postmercado, teniendo en cuenta las realidades de los territorios.

5.1.3. Entre el año 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores del nivel central y territorial avanzará en el diseño del modelo de inspección, vigilancia y control sanitario definido por la Resolución 1229 de 2013 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, incluyendo DM.

5.2. Línea de acción: Robustecer la regulación y la reglamentación técnica de los DM entorno a la calidad y seguridad de estos.

5.2.1. Entre el año 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el INVIMA y la participación de los actores involucrados realizará los análisis de impacto normativo requeridos, alineados con las buenas prácticas regulatorias y las disposiciones legales aplicables vigentes.

5.2.2. Entre el año 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el INVIMA y la participación de los actores involucrados, avanzará en la reglamentación técnica de las Buenas Prácticas de Manufactura de los DM en serie.

5.2.3. Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores, establecerá una propuesta de lineamientos para el mantenimiento y el uso de la metrología de equipos biomédicos articulada con el Subsistema Nacional de Calidad, donde se incluya revisión de los lineamientos internacionales existentes en el tema.

5.2.4. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores actualizará el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de DM para uso humano.

6. OE6. Desarrollar lineamientos para la gestión, así como para el uso adecuado de DM.

6.1. Línea de acción: Establecer lineamientos para la gestión de dispositivos médicos, especialmente de equipos biomédicos.

6.1.1. Entre el año 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores y agentes, definirá lineamientos para la gestión de DM.

6.1.2. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social con participación de las entidades territoriales de salud, los prestadores de servicios de salud y otros actores e involucrados, crearán estrategias para la divulgación de los conocimientos en mejores prácticas de gestión de DM a nivel hospitalario.

6.1.3. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores, definirán e implementarán lineamientos para la reprocesamiento de dispositivos y elementos reutilizables (DMER) en los prestadores de servicios de salud (PSS) y avanzarán en la construcción de lineamientos para la reprocesamiento y remanufactura de dispositivos médicos de único uso (DMUU).

6.1.4. Entre el año 2024 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores definirá lineamientos sobre disposición final tanto hospitalaria como comunitaria de los DM especialmente para DM implantables, así como para equipos biomédicos incluyendo la mitigación de los impactos en la sostenibilidad ambiental.

6.2. Línea de acción: Promover el uso adecuado de DM de acuerdo con los lineamientos del fabricante y las necesidades derivadas del perfil epidemiológico.

6.2.1. Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con los actores y agentes desarrollará estrategias para impulsar el uso adecuado e idóneo de los DM que sean priorizados, de acuerdo con los lineamientos del fabricante, en los prestadores de servicios de salud, los pacientes y los cuidadores.

6.2.2. Entre el año 2025 y 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con el INVIMA establecerá lineamientos para la publicidad de DM.

SEGUIMIENTO

La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y del Ministerio de Salud y Protección Social realizarán un seguimiento anual, en el periodo comprendido entre 2024 y 2026, a la ejecución de las acciones propuestas para el cumplimiento del objetivo de la presente política, presentando informes de avance anuales y un informe de cierre final posterior al año 2026.

El Plan de Acción y Seguimiento (PAS) establecido para la ejecución de la Política de Dispositivos Médicos será publicado por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud al igual que los informes de avances anuales y de cierre final.

FINANCIAMIENTO

Para el cumplimiento de los objetivos de esta política, las entidades del sector salud involucradas en su implementación gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias y de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los recursos para la financiación de las acciones que son propuestas.

BIBLIOGRAFÍA

AAMI - Association for the Advancement of Medical Instrumentation. (2013). AAMI EQ56 - Recommended practice for a medical equipment management program.

Aguilar, V. L. (2006). *Gobernanza y gestión Pública.* Obtenido de https://marcelagonzalezduarte.files.wordpress.com/2018/01/aguilar-villanueva-gobernanza-y-gestion-publica.pdf

Burmester, H. (1997). *Reflexiones sobre los programas hospitalarios de garantía de la calidad.* Rev Panam Salud Pública.

CEPAL. (2020). *La salud como desafío productivo y tecnológico.* Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46534/S2000782_es.pdf

CEPAL. (2021). *Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19 para los países del SICA.*

Cheng, M. (2003). *Medical Device Regulation: Global overview and guiding principles.* Geneve: World Health Organization.

Decreto 1099 de 2022. (s.f.). Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y Producción de Tecnologías Estratégicas en Salud - CIDPTES.

Decreto 1769 de 1994. (s.f.). Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984.

Decreto 218 de 2019. (s.f.). Por el cual se regula las donaciones internacionales de productos de uso humano con fines sociales y humanitarios y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3770 de 2004. (12 de Noviembre de 2004). Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%203770%20DE%202004.PDF

Decreto 4107 de 2011. (s.f.). Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

Decreto 4725 de 2005. (s.f.). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Obtenido de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18697&dt=S

Decreto 697 de 2021. (s.f.). Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que se tendrán en cuenta en la donación de medicamentos de síntesis química, biológicos. radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, *equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, y materias primas, para atender la pandemia por la COVID 19.*

DNP. (2019). Política de Mejora Normativa para Modernizar el Estado. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/ERel/GME_Polltica_Mejora_Normativa.pdf

Escobar, N. (2000). *La Innovación tecnológica.* Editorial Medisan.

Fernandez, M. D. (1998). *La calidad y la innovacion tecnologica en la biotecnologia aplicada a la salud.* Obtenido de http://revistadyo.es/index.php/dyo/article

FDA. (2023). Software as a Medical Device (SaMD). Página web https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/software-medical-device-samd consultada el 23 de agosto de 2023.

FIFARMA. (2019). Obtenido de https://fifarma.org/wp-content/uploads/2019/10/FIFARMA-Healthcare-Sustainability-Working-Document-20190903-STC-Spanish.pdf

Garcia-Vega, Oscar Armando. (2015). Presentacion "Sistema nacional de vigilancia de dispositivos médicos" en el XII Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas. Obtenido de: https://ciemto.medicinaudea.co/system/comfy/cms/files/files/000/000/260/original/8-Sistema_nacional_de_vigilancia_de_dispositivos_ biome%CC%81dicos.pdf

Gilmore. C., N. H. (1996). *Gerencia de calidad.* Washington D.C: OPS.

IETS. (2014). *Manual metodológico para la elaboración de evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud.* Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/manual-metodologico-elaboracion-de-evaluaciones-de-efectividad.pdf

IETS. (2019). *Documento técnico de diagnóstico del sector de los dispositivos médicos.* Bogota.

IMDRF. (2019) IMDRF MDCE WG/N57FINAL:2019 (formerly GHTF/SG5/N3:2010) Clinical Investigation. Obtenido de https://www.imdrf.org/sites/default/files/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-191010-mdce-n57.pdf

ISO 13485:2018. (s.f.). Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.

Kaur M et al. (2005). *How to Manage' Series for Healthcare Technology. Guide 1: How to Organize a System of Healthcare Technology Management. Ziken International (Health Partners International).*

Kirigia J, K. D. (2011). *International Archives of Medicine.* Obtenido de http://www.intarchmed.com/content/4/1/11. Consultado el 20 de febrero de 2013.)

Laudon, L. &. (2004). Obtenido de http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-Sistemas_de_informacion_gerencial_14%20edicion.pdf

Ley 1438 de 2011. (s.f.). por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Obtenido de https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680431#:~:text=Es%20obligaci%C3%B3n%20de%20la%20familia,su%20desarrollo%20arm%C3%B3nico%20e%20integral.

Ley 842 de 2003. (s.f.). Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones.

Borderline and Classification Working Group - Medical Device Coordination Group (2022). Manual on borderline and classification for medical devices under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices. Version 2

Mincit. (20 de 2 de 2023). *Página web Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.* Obtenido de https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/politica-reindustrializacion-presentacion-a-medios

Minsalud. (2015). *Mejorar la seguridad en la utilizacion de medicamentos.* Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/seguridad-en-la-utilizacion-de-medicamentos.pdf

Minsalud. (2019). *Linea base sobre estado de los dispositivos médicos en Colombia.* Bogota.

Minsalud. (2021). *Documento preliminar de AIN de BPM de DM.* Bogota.

Minsalud. (2023). Informe evaluación expost Decretos 3770 de 2004 y 4725 de 2005. Bogotá. Consultado en https://www.minsalud.gov.co/Anexos_Normatividad_Nuevo/20232400028190300004%20%281%29.pdf

Minsalud. (2023b). Árbol de problemas en el marco del Análisis de Impacto Normativo (AIN) de Investigación Clínica con Dispositivos Médicos (DM) y Reactivos de Diagnóstico In Vitro (RDIV). Bogotá

Molina, D., Botero, S., & Giraldo, G. (2016). Investigación clínica y ensayos clínicos.

Molina-Marín, A. N.-D. (2012). *Rectoría y gobernanza en salud pública.* Obtenido de https://scielosp.org/pdf/rsap/2013.v15n1/44-55/es

Monter, H. A. (2008). *¿Qué sabe usted acerca de ...eficacia y efectividad de los fármacos?* Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/579/57939108.pdf

OCDE. (2 de 11 de 2012). Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria.

OCDE. (2015). *Manual de Frascati.* Obtenido de Obtenido de Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/manual_de_frascati_web_0_1.pdf).

OCDE. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, (4th Edition ed.)*. OCDE Publishing.

OMS. (2007). *Resolución WHA 60.29*. Ginebra.

OMS. (2012). *Dispositivos médicos: la gestión de la discordancia: un resultado del proyecto sobre dispositivos médicos prioritarios. Genève: Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de https://apps.who.int/iris/handle/10665/44868

OMS. (2012). *Formulación de políticas sobre dispositivos médicos*. Obtenido de http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44832/9789243501635_spa.pdf;jsessionid=DC39707277502CF14CDB604195602044?sequence=1

OMS. (2017). *Global Atlas of medical devices*. Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789241512312

OMS. (2017). *Modelo Global de Marco Regulatorio de la OMS para Dispositivos Médicos, incluidos los dispositivos médicos para diagnóstico in vitro*. Ginebra.

OMS. (2020). Guideline on Country Pharmaceutical Pricing Policies.

OPS. (2012). *28.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA*. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3684/CSP28.R9-s.pdf?sequence=4&isAllowed=y

OPS. (2023). *Equidad en Salud*. Obtenido de https://www.paho.org/es/temas/equidad-salud

OPS, U. (2007). *LA FUNCIÓN RECTORA de la AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL*. Obtenido de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Rectoria_ASN_Lecciones_Aprendidas_Rectoria_Conduccion.pdf

OPS/OMS. (Mayo de 2021). *Evaluación de tecnologías de salud*.

Presidencia de la República. (Diciembre de 2019). Politica de Mejora Normativa. *Comité de Mejora Normativa Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 1*.

RAE. (2021). Obtenido de https://dle.rae.es/seguro?m=form

Resolucion 1411 de 2022. (s.f.). Por la cual se adopta la Politica de Soberanía en la producción para la Seguridad.

Resolución 2366 de 2023. (s.f.). Por la cual se establecen los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Resolución 3100 de 2019. (s.f.). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

Resolución 4816 de 2008. (s.f.). *Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.*

Rivas, L. V. (2006). *Ingeniería Clínica y Gestión de Tecnología en Salud: Avances y Propuestas*. Obtenido de http://its.uvm.edu/PUCP_CENGETS/LIBRO-CENGETS-NOV2006.pdf

Suplemento, O. (2008). *La calidad de la atención en salud*. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2008/oras081a.pdf)

Unión Medical. (s.f) *Escasez de dispositivos médicos por pandemia*. Obtenido de https://um.com.co/blog/escasez-de-dispositivos-medicos-por-pandemia/#proveedores

Vega-Perez et al. (2017). Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v21n1/0121-3709-rori-21-01-00064.pdf

Voury y De Geyndt. (2008). *La calidad de la atención en salud*. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2008/oras081a.pdf